




REACH SURGICAL | ENER REACH

ENER REACH Optimus

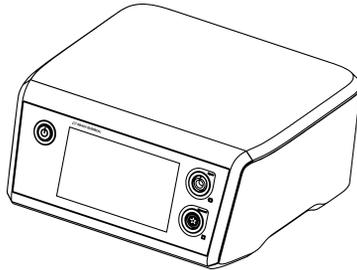

bg Електрохирургични инструменти Инструкции	it Strumenti elettrochirurgici Istruzioni
cs Elektrochirurgické nástroje Návod k použití	lt Elektrochirurginiai instrumentai Instrukcija
de Elektrochirurgische Instrumente Gebrauchsanweisung	lv Elektroķirurģijas instrumenti Instrukcijaš
el Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία Οδηγίες	nl Elektrochirurgisch instrument Instructies
es Instrumentos electroquirúrgicos Instrucciones	pl Urządzenia elektrochirurgiczne Instrukcje
et Elektrokirurgilised instrumendid Kasutusjuhend	pt Instrumentos eletrocirúrgicos Instruções
fr Instruments électrochirurgicaux Instructions	ro Instrumente electrochirurgicale Instrucțiuni
hr Elektrokirurški instrumenti Upute	sk Elektrochirurgické nástroje Návod na použitie
hu Elektrosebészeti műszerek Utasítások	sl Elektrokirurški instrumenti Navodila

Rev. A.0

REACH SURGICAL, INC.

Catalogue

BG	Електрохирургични инструменти	Инструкции2
CS	Elektrochirurgické nástroje	Návod k použití21
DE	Elektrochirurgische Instrumente	Gebrauchsanweisung39
EL	Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία	Οδηγίες57
ES	Instrumentos electroquirúrgicos	Instrucciones75
ET	Elektrokirurgicalised instrumendid	Kasutusjuhend93
FR	Instruments électrochirurgicaux	Instructions110
HR	Elektrokirurški instrumenti	Upute128
HU	Elektrosebészeti műszerek	Utasítások145
IT	Strumenti elettrochirurgici	Istruzioni163
LT	Elektrochirurginiai instrumentai	Instrukcija181
LV	Elektroķirurgijas instrumenti	Instrukcijas198
NL	Elektrochirurgisch instrument	Instructies215
PL	Urządzenia elektrochirurgiczne	Instrukcje233
PT	Instrumentos eletrocirúrgicos	Instruções251
RO	Instrumente electrochirurgicale	Instrucțiuni269
SK	Elektrochirurgické nástroje	Návod na použitie287
SL	Elektrokirurški instrumenti	Navodila305

Преглед

Моля, прочетете внимателно следната информация, преди да използвате това устройство. Тя съдържа важни инструкции относно правилната работа, потенциалните рискове и възможните повреди на продукта или на отделни лица. В случай на необичайна ситуация следвайте посочените инструкции, за да предотвратите увреждане на себе си или повреда на оборудването. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нарушаване на безопасността, работата, гаранцията или поддръжката, за което производителят не носи отговорност. Моля, прочетете и инструкциите за Преобразувател и ултразвукови ножици, преди да използвате устройството.

Този документ е предназначен да помогне при използването на това устройство. Той не е справочник за хирургически техники.

Използвани стандартни конвенции: Предупреждение, ВНИМАНИЕ и забележка

Моля, обърнете внимание на следните твърдения, категоризирани като ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ЗАБЕЛЕЖКА, които предоставят важни указания за безопасно и задълбочено изпълнение на задачите. Тези извления могат да бъдат намерени в цялата документация и трябва да бъдат прочетени, преди да се премине към следващата стъпка в дадена процедура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това извление обръща внимание на процедура, практика или условие за експлоатация или поддръжка, които, ако не се спазват стриктно, могат да доведат до телесни повреди или загуба на живот.

ВНИМАНИЕ: Това декларация предупреждава потребителя за потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания на потребителя или пациента, както и до повреда на оборудването или друго имущество. То може да служи и като предупреждение за опасни практики. Това включва необходимите предпазни мерки за безопасна и ефективна употреба на инструмента и грижите, необходими за предотвратяване на повреди, произтичащи от правилна или неправилна употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това твърдение показва работна практика или условие, което е от съществено значение за ефективното изпълнение на дадена задача.

Описание

Електрохирургичният инструмент ENER REACH (наричан по-долу "устройството") се използва в медицински операционни зали за хирургични процедури за рязане, коагулация на човешка тъкан и подвързване на съдове. Той разполага с два отделни слота: единият за ултразвукова енергия, а другият - за извеждане на радиочестотна вълна.

В радиочестотен режим Генератор осигурява различни енергийни схеми в зависимост от създания инструмент/електрохирургично устройство. Когато е свързан усъвършенстван биполярен инструмент, Генератор доставя радиочестотни вълни за запечатване на артериали и венозни съдове, лимфати и тъкани снопове с диаметър до 7 mm. Когато е свързан основен биполярен инструмент, се излъчва енергия с постоянна мощност за рязане и коагулация на меки тъкани.

В режим на извеждане на ултразвукова енергия, като се използва TRA6 Преобразувател в комбинация с Ултразвукови ножици за еднократна употреба CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, устройството реже меки тъкани, изискващи контрол на кървенето и минимално термично увреждане, и запечатва съдове с максимален диаметър до 5 mm. Когато е свързан с Еднократни ултразвукови ножици SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 и SRE45, уреждат прерязва меки тъкани, изискващи контрол на кървенето и минимални термични увреждания, и запечатва съдове с максимален диаметър до 7 mm.

Предназначение

Устройството осигурява радиочестотна енергия за задвижване на електрохирургични наконечници, които са предназначени да се използват за прерязване и запечатване на съдове и за рязане, захващане и разрязване на тъкани.

Освен това Генератор осигурява ултразвукова мощност за задвижване на ултразвукови хирургически инструменти, които са предназначени за разрези на меки тъкани, когато се изисква контрол на кървенето и минимално термично увреждане.

Показания

Устройството осигурява радиочестотна енергия за задвижване на електрохирургични наконечници, които се използват по време на отворени операции или лапароскопски операции в общата, педиатричната, гинекологичната, урологичната и гръдната хирургия за прерязване и запечатване на съдове с диаметър до 7 mm включително, както и за рязане, захващане и разрязване на тъкани.

Освен това Генератор осигурява захранване за задвижване на ултразвукови хирургически инструменти, които са предназначени за разрези на меки тъкани, когато се изисква контрол на кървенето и минимално термично увреждане. Ултразвуковите хирургически инструменти могат да се използват като допълнение или заместител на електрохирургията, лазерите и стоманените скалпели за рязане и/или коагулация на тъканите при отворени операции или лапароскопски операции в областта на общата хирургия, педиатрията, гинекологията, урологията, гръдната хирургия, както и за запечатване и пресичане на лимфни съдове.

Предназначен потребител

Устройството е предназначено за използване от медицински специалисти за хирургични приложения.

Среда на използване по предназначение

Устройството е предназначено за използване в болница.

Предвидена популация на пациентите

Това устройство е подходящо за пациенти на възраст 3 и повече години, които се нуждаят от хирургични процедури, включващи разрези на меки тъкани с контрол на кървенето и минимално термично увреждане.


Клинична полза

Устройството може да се използва безопасно и ефективно за лигиране и разделяне на съдове, тъкани снопове и лимфати.

Противопоказания

Това устройство е противопоказано за костни разрези, контрацептивно запушване на тръбите и коагулационни процедури. То също така не е предназначено за използване в неврохирургията.

Състав на системата

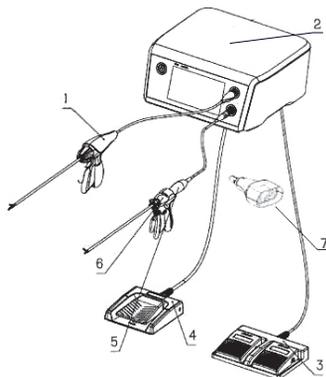

[01]Електрохирургични накрайници.	[02]OP9 Генератор
[03]Ултразвуков крачен превключател(педал)	[04]Електрохирургичен крачен превключател(педал)
[05]Преобразувател	[06]ултразвукови ножици
[07]Електрохирургичен биполярен преобразувател/генератор	

[01] Електрохирургичен наконечник

Електрохирургичният наконечник, свързан с Генератор, се управлява от хирурга по време на процедурата. Той прилага радиочестотна електрохирургична енергия към тъканта между своите Челюсти за коагулация или запечатване. Инструментът включва и острие за разделяне на тъканта. Модел: OSA23, OSA37, OSA44. За подробна информация се обърнете към инструкциите.

[02] OP9 Генератор

Генератор осигурява както електрохирургична енергия, така и енергия за ултразвукова терапия чрез отделни портове за свързване на инструменти. Той се състои от шаси, корпус, електронна платка, LCD сензорен екран, ключ за захранване и интерфейси за свързване на аксесоари.

Модел: OP9

[03] Ултразвуков крачен превключател(педал)

Използва се за управление на включването/изключването на ултразвуковата енергия с два превключателя ("MIN" и "MAX"). Модел: OP-FSD

[04] Електрохирургичен крачен превключател(педал)

Използва се за управление на включването/изключването на високочестотна енергия с един превключател.

Модел: OP-FSS

[05] Преобразувател

Модулът Преобразувател преобразува електрическата енергия от съвместим модул Генератор в механично движение на лопатките на инструмента. Това е инструмент за многократна употреба с ограничен експлоатационен живот. Инструментът Преобразувател не е стерилен и преди употреба трябва да се стерилизира съгласно инструкциите. За подробна информация вижте инструкциите за TRAB Преобразувател.

Модел: TRAB.

[06] ултразвукови ножици

ултразвукови ножици използва механичното движение на Преобразувател и доставя ултразвукова енергия за рязане на тъкани или коагулация. Трябва да се внимава, тъй като механичната вибрация не се открива и може неволно да засегне нецелевите зони. Уредите ултразвукови ножици се стерилизират с етиленов оксид. Ако срокът на годност е надвършен или опаковката за стерилизация е повредена, ултразвукови ножици не трябва да се използва и трябва да се изхвърли. За подробна информация се обърнете към инструкциите на ултразвукови ножици.

Следните модели ултразвукови ножици са съвместими с OP9 Генератор:

Серия PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Серия SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Серия SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Биполярен конектор за електрохирургия

Използва се за свързване на основния биполярен апарат Електрохирургични инструменти към Генератор за коагулация на тъкани.

Модел: OP-BPC

Генератор Преден панел

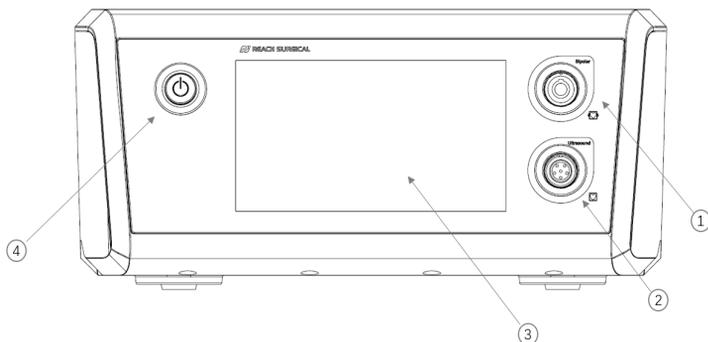

[01] Електрохирургична розетка

Използва се за свързване на усъвършенстван биполярен конектор Електрохирургични инструменти или биполярен конектор за електрохирургия.

[02] Преобразувател гнездо

Свързва устройството Преобразувател с устройството Генератор.


[03] LCD сензорен екран

Показва информация за системата и служи като интерфейс за регулиране на контролите и настройките.

[04] Бутон за превключване на захранването

Натиснете, за да включите Генератор, натиснете и задръжте, за да изключите устройството.

Генератор Заден панел

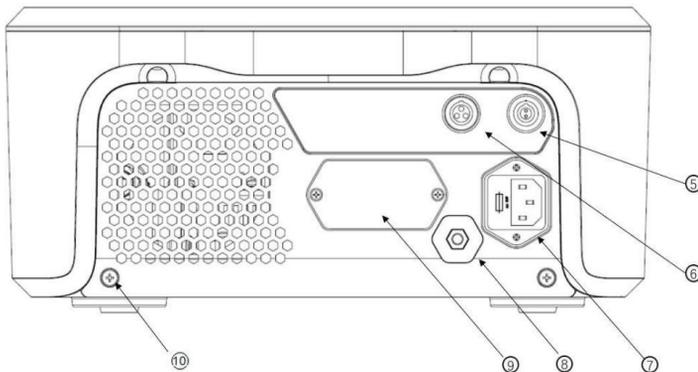

[05] Електрохирургично гнездо за крачен превключвател

Кръгло гнездо за свързване на електрохирургичния педал

[06] Разклонител за ултразвуков крачен превключвател

Кръгло гнездо за свързване на ултразвуковия крачен превключвател.

[07] Захранващ контакт

Свързва захранващия кабел към Генератор.

[08] Порт за изравняване на потенциала

Ако заземяването на електрическия контакт е несигурно, този порт позволява свързване към защитена земя.

[09] Интерфейс за разширение

Използва се за разширяване на функциите и поддръжка.

[10] Отвор за монтиране

Инструкции за употреба

Вижте предоставените указания за работната среда.

Разпаковане на

Моля, следвайте инструкциите при получаване на компонентите по-долу.

- Проверете за видими транспортни повреди. Ако откриете някакви повреди, свържете се с Reach Surgical, Inc. или с местния представител за съдействие.

Компоненти, включени в (За подробни технически спецификации и продуктови кодове вижте глава "Технически условия на системата"):

Модел	Описание	Компонент
OP9	Генератор	Генератор, Захранващ кабел, Инструкции
TRA6	Преобразувател	Преобразувател с кабел
OP-FSD	Ултразвуков крачен превключвател	/
OP-FSS	Биполярен крачен превключвател	/
OP-BPC	Основен биполярен енергиен съединител	/

Предпазни мерки за безопасност

- По време на проверката на оборудването дръжте дисталния край на инструмента далеч от други апарати, хирургически чаршафи, пациента или други предмети, за да избегнете нараняване.
- Прилагайте необходимите мерки за безопасност при наличие на изпарения, като спазвате болничните процедури и разпоредби.

Ултразвукова енергия с PD Series ултразвукови ножици

- Свържете модула Преобразувател, крачния превключвател и PD серия Ултразвукова ножица към модула Генератор.
- След като преминете тестовете Преобразувател и Ултразвукова ножица, регулирайте нивото на мощност (1-5) с помощта на иконите +/- на LCD екрана.
- Натиснете бутона "Min" на Ултразвукова ножица или педала Min на крачния превключвател, за да активирате ултразвуковата енергия на предварително зададеното ниво на мощност.
- Натиснете бутона "Max" на Ултразвукова ножица или педала "Min" на крачния превключвател, за да осигурите максимално ниво на енергия.
- Освободете ключа или крачния прекъсвач, за да спрете подаването на енергия.

Ултразвукова енергия с SRB/SRE Серия ултразвукови ножици

- След като преминете тестовете Преобразувател и Ултразвукова ножица, регулирайте нивото на мощност (1-5) с помощта на иконите +/- на LCD екрана.

- Натиснете бутона Бутон за енергия на уреда или бутона Min на педала, за да активирате ултразвуковата енергия на предваарително зададеното ниво на мощност.
- Натиснете бутона Бутон за енергия с разширена хемостаза на инструмента, за да активирате режима на разширена хемостаза.
- Освободете бутона на ултразвукови ножици или бутона на Крачен превключвател, за да спрете подаването на енергия.

Електрохирургична биполярна енергия с усъвършенствани биполярни инструменти

- На LCD дисплея се показва иконата за усъвършенстван биполярен режим и иконата за регулируемо ръчно управление.
- Издърпайте бутона Лост на инструмента или натиснете педала на крачния превключвател, за да активирате радиочестотата.
- Генератор ще спре извеждането на енергия, когато затварянето е завършено, което се показва от иконата за завършване на екрана.
- Ако лигирането е непълно, ще се чуе предупредителен тон и ще се покаже предупредителна икона.

Електрохирургична биполярна енергия с биполярен електрохирургичен инструмент

- На LCD екрана се показват стойността на мощността, регулируемите икони и лентите на нивото на мощността.
- Настройките на мощността варират от 1 до 95 вата с регулируеми стъпки.
- Изберете желаната настройка на изходната мощност: Ниска (15 вата), Средна (30 вата) или Висока (60 вата).
- Натиснете бутона на ръчния превключвател или педала за крачен превключвател, за да активирате радиочестотата.
- Освободете бутона, за да деактивирате енергийния изход.

Препоръки за настройка

Настройки на ефекта	Диапазон на настройките на мощността	Клинично приложение	Оптимизирано устройство
Нисък	1-15 вата	Като нерви/гърбначен стълб, ръце и лицева хирургия	- Устройства с по-малка повърхност - Микропинцети (0,4 - 2,2 mm)
В средата на	16-40 вата	Като коагулация по време на лечението на глава/ший, гърбначен стълб и анатомия	- Устройства със средна повърхност - Микропинцети (1,0 - 2,2 mm) - Малки лапароскопски щипки с плоска глава - Биполярни ножици
Висока	45-95 вата (стъпка от 5 вата)	Като например хирургия на главата/врата и пластична хирургия (подобно на средния ефект, но с по-бърз ефект)	- Устройства с голяма повърхност - Големи лапароскопски щипки с плоска глава

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство не е съвместимо с неутрален електрод.

ЗАБЕЛЕЖКА: Електрическият скалпел ултразвукови ножици и радиочестотният скалпел са части, които се използват в контакт с пациента.


Използване на Генератор

Включване на устройството

- Системата е готова за работа, след като бъде включена. Когато Генератор е свързан към електрическата мрежа и светне индикаторът на превключвателя за готовност, системата е готова за работа.
- След като натиснете бутона за готовност, ще се покаже следното изображение:




- Ако Преобразувател или Ултразвукова ножица не са свързани към Генератор или са свързани неправилно, ще се покаже следното изображение:

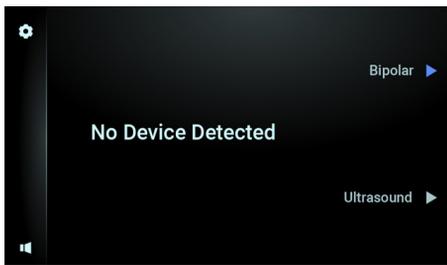


Използване на ултразвуков уред (Преобразувател и Ултразвукова ножица)


Когато се открият Преобразувател и Ултразвукова ножица, ще се покаже следното изображение.

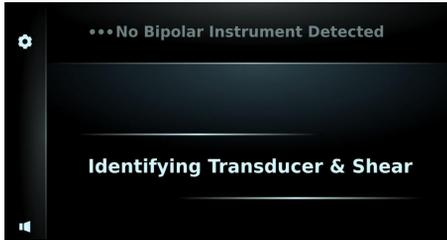


ЗАБЕЛЕЖКА: ако оставащата употреба на Преобразувател е по-малка от 10, ще се покаже следното изображение. Моля, обърнете внимание на броя на оставащите употреби, тъй като Преобразувател трябва да се замени, когато броят им стане нула.

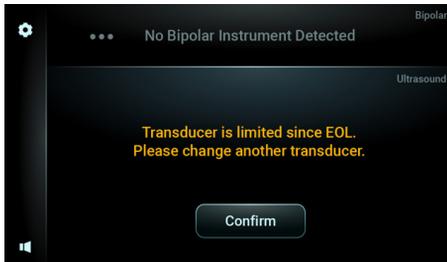


След това ще се покаже следното изображение, ще бъдете помолени да натиснете който и да е бутон на Ултразвукова ножица, за да стартирате теста Ултразвукова ножица с отворен Челюсти.

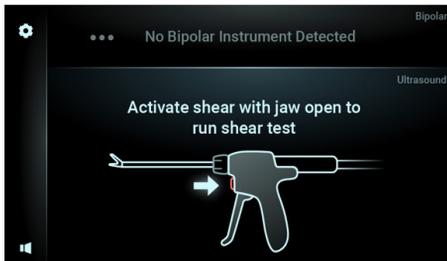

Натиснете произволен бутон и ще се покаже следното изображение.

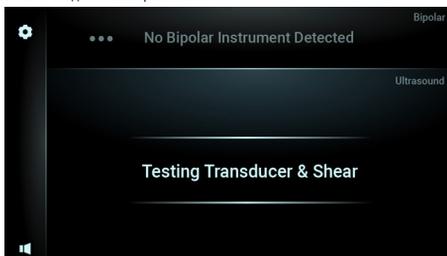


При неуспешен тест Преобразувател ще се покаже следното изображение:

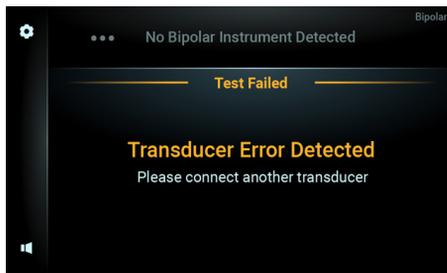

При неуспешен тест Ултразвукова ножица ще се покаже следното изображение



Когато тестът Преобразувател и Ултразвукова ножица премине успешно, ще се покаже следното изображение:



Следният работен екран ще се покаже при свързване на ултразвукови ножица без функцията Advanced Hemostasis.




Следният работен екран ще се покаже при свързване на SRE ултразвукови ножица с Advanced Hemostasis.




Режимът на изхода ще бъде подчертан, когато е активиран.

Използване на електрохирургичен инструмент


Когато се открият Преобразувател и Ултразвукова ножица, ще се покаже следното изображение.




Когато тестът на електрохирургичния инструмент премине успешно, ще се покаже следното изображение:



Следният работен екран ще бъде показан при свързване с усъвършенстван двуполуен инструмент.



Следният работен екран ще се покаже при свързване към обикновен двуполуен инструмент.




Използване на електрохирургичен инструмент и ултразвукови ножици

Моля, обърнете внимание, че когато Генератор е свързан едновременно с биполярен електрохирургичен инструмент и Ултразвукова ножица, системата работи в режим на разделен екран, за да показва текущото състояние. Устройството, което е приоритизирано, ще бъде първото, което ще активира енергията. Това състояние на разделен екран е показано по-долу:



Системни настройки


За да получите достъп до системните настройки, щракнете върху иконата за настройки, разположена в горния ляв ъгъл на екрана. Налични са следните опции за системни настройки:

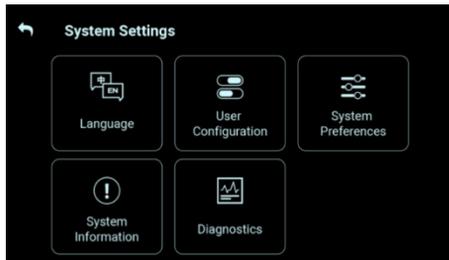


Език: Кликнете върху елемента Language (Език), за да се покаже екранът за избор на език:




Конфигурация на потребителя: Щракването върху елемента Конфигурация на потребителя ще покаже екрана за конфигурация на потребителя:

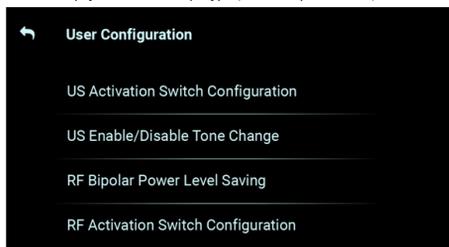


Системни предпочитания: Щракване върху елемента System Preferences (Системни предпочитания) ще покаже екрана със системни предпочитания:

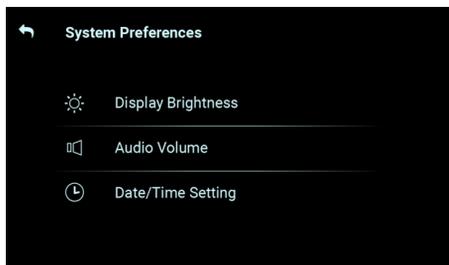

Информация за системата: Кликнете внимателно върху елемента System Info (Системна информация), за да се покаже екранът със системна информация:



Диагностика: Кликването върху елемента Диагностика ще покаже екрана за диагностика:

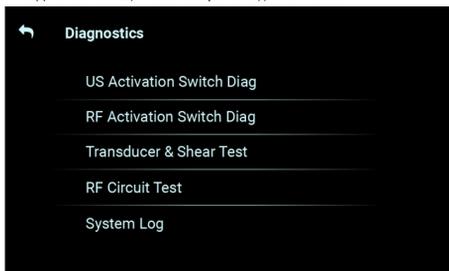

За да излезете от системните настройки и да се върнете в режим на готовност на системата, натиснете иконата "Return" (Връщане), разположена в горния ляв ъгъл на екрана.

Изключване на системата

Следвайте стъпките по-долу, за да изключите безопасно системата:

Натиснете бутона за готовност: Намерете бутона за режим на готовност на Генератор и го натиснете, за да стартирате процеса на изключване.

Изключете Преобразувател и Ултразвукова ножица: Внимателно изключете Преобразувател и Ултразвукова ножица от системата. Вижте инструкциите за експлоатация за правилното боравене с Преобразувател и Ултразвукова ножица.

Почистване: Почиствайте Генератор, крачния превключвател и Преобразувател в съответствие с посочените процедури, описани в глава "Поддръжка".

Отстраняване на неизправности

Генератор включва различни предупредителни сигнали и кодове за грешки, които помагат при идентифицирането и диагностицирането на неизправности на компонентите. Важно е да се отбележи, че тези сигнали и кодове са предназначени да подпомагат клиничната преценка и наблюдение, а не да ги заместват.

Звук сигнал

Работен статус	Тип звук	Възможна причина и действие
Статус на самопроверка	Нормален звук	/
	Необичаен звук	Открита е хардуерна грешка. Моля, свържете се с производителя за съдействие за ремонт.
Използване на ултразвуков инструмент	Максимално ниво на звука	/
	Минимално ниво на звука	/
	Необичаен звук	Уредът Ултразвукова ножица е влязъл в контакт с прекомерна тъкан. Намалете контакта на тъканта с Ултразвукова ножица. Ако продължителният звук продължава, внимателно отстранете тъканта, която може да се е натрупала около края на Ултразвукова ножица. Открита е грешка в Преобразувател и/или Ултразвукова ножица. Моля, обърнете се към производителя или се свържете с отдела за поддръжка за допълнителна помощ.
	ЗАВИСИМ звук	/
Активиране на електрохирургичен инструмент	Звук от ITS	/
	Разширен биполярен предупредителен сигнал	/
	Нормален двуполуосен звук	/
	Необичаен звук	Неуспешно рязане: Ако тъканта, с която е в контакт инструментът, не отговаря на изискванията за рязане, намалете количеството тъкан, която е в контакт с инструмента. Ако сигналът за грешка продължава, внимателно почистете тъканта, която може да се е натрупала в края на инструмента. Повреда на хардуера: Тази грешка показва потенциална повреда във веригата или конектора. В случай на неизправност или грешка се препоръчва да се консултирате с производителя или да потърсите помощ за подходящи указания и разрешаване на проблема.

Кодове за грешки

Енергийната платформа Генератор е оборудвана с цялостна система за идентифициране на неизправности, състояща се от предупреждения и системни грешки. Когато бъде открита грешка, Генератор издава предупредителен тон, извежда предупредителен сигнал на контролния панел и показва съответния код на грешката на LCD екрана. Следвайте стъпките, описани по-долу, за да отстраните проблема:

Таблица с кодове за грешки

Код за грешка	Съответстващо съобщение за неизправност
Предупреждение	Моля, свържете правилно Ултразвукова ножица с Преобразувател
Предупреждение	Уверете се, че Челюсти са отворени по време на тестването
Предупреждение	Ултразвукова ножица Открита грешка
Предупреждение	Остатъчното време на Преобразувател е нула
Предупреждение	Моля, активирайте само един бутон в даден момент
Предупреждение	Моля, намалете силата, прилагана към Ултразвукова ножица
Предупреждение	Ултразвукова ножица бутон и крачен превключвател не могат да бъдат затворени едновременно
Предупреждение	Бутонът е заседнал, моля, проверете и продължете
Предупреждение	Регулирайте Челюсти или притиснете по-малко тъкан
Предупреждение	Извадете устройството от тъканите
Системна грешка	Системна грешка
Системна грешка	Неуспешна самопроверка

Ако по време на тестването на екрана се появи грешка, извършете следните действия:



- Уверете се, че кабелът Преобразувател е напълно поставен в правилната посока.
- Проверете дали Ултразвукова ножица е затегнат правилно или дали около края на Ултразвукова ножица не се е натрупала тъкан. Регулирайте стегнатостта на Ултразвукова ножица и внимателно отстранете всички натрупани тъкани около корпуса на Ултразвукова ножица. (Ако тестът е започнат преди операцията, уверете се, че Ултразвукова ножица е насочен към въздуха. Ако се използва ултразвукови ножици, потвърдете, че притискащата челюст е отворена и не е в контакт с никакви предмети).
- Ако проблемът продължава, помислете за замяна на Преобразувател или Ултразвукова ножица.
- Преминете към работния режим на оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моделът Преобразувател може да не функционира правилно, ако температурата му надвиши посочената граница. В такива случаи незабавно използвайте друг Преобразувател за възстановяване или следвайте стъпките по-долу, за да определите причината за грешката и да проучите опционалните методи за възстановяване:

- Оставете Преобразувател да се охлади на стайна температура за минимум 45 минути. Този метод на охлаждане се прилага и ако Преобразувател се нагрее след продължителна работа с висока мощност.
- Ако прегряването не е очевидно и проблемът не е решен, свържете се с представителите на производителя за поддръжка за съдействие.
- Освен предпазителите, в Генератор няма части, които могат да се обслужват от потребителя. При необходимост от подмяна или сервизно обслужване се обърнете към сервизен персонал, обучен и оторизиран от Reach Surgical, Inc., или към вашия местен представител.

Поддръжката и модернизацията на Генератор трябва да се извършват изключително от сервизен персонал, обучен и оторизиран от Reach Surgical.

Трябва да се обмислят предпазни мерки за киберсигурност, за да се предотвратят потенциални заплахи. Следните инциденти създават рискове за киберсигурността:

- Неоторизиран достъп до продукти, които не са свързани с устройството.
- Всяка неоторизирана мрежова комуникация с устройството.
- Подобрения на фърмуера или софтуера, които не са били разрешени от Reach Surgical.

В случай на някой от горепосочените инциденти, моля, свържете се с търговския представител на Reach Surgical, Inc. или директно се свържете с Reach Surgical, Inc. на Reachquality@reachsurgical.com.

Поддръжка

Почистване и дезинфекция на Генератор и основния биполярен енергиен конектор

Почистване

Почистете LCD екрана Генератор и основния двуполусен конектор в съответствие с болничните процедури и разпоредби. Преди почистване се уверете, че основното захранване на Генератор е изключено и захранващият кабел е изваден от изходния модул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процедурите за почистване трябва да се изпълняват внимателно, за да не се повреди Генератор, да не се предизвика токов удар или опасност от пожар. Не разливайте и не пръскайте течности върху или в Генератор, нито го потапяйте в течност.

Следвайте следните стъпки за почистване:

- Пригответе детергент с неутрално pH или ензимен детергент с неутрално pH, както е посочено от производителя на детергента.
- С помощта на чиста, мека кърпа, напоена с малко количество почистващ разтвор, избършете ръчно всички повърхности, включително екрана Генератор.
- Избършете всички повърхности с чиста, мека кърпа, напоена с топла чешмяна вода.
- Накрая избършете всички повърхности с чиста, мека кърпа, за да се уверите, че са сухи.

Дезинфекция

- Ако Генератор се замърси с кръв или телесни течности, трябва да се дезинфекцира преди повторното му използване. Следните химически

- дезинфектанти са валидирани за употреба върху Генератор: 70% изопропилов алкохол, 6% натриев хипохлорит, 10% водороден пероксид.
- Спазвайте препоръките на производителя за правилна употреба, концентрация и време на контакт с дезинфектантите.
- Уверете се, че дезинфекторите са конфигурирани и се използват съгласно инструкциите на производителя.

Почистване на крачния превключвател

Почиствайте крачния превключвател и кабела след всяка употреба, като използвате следната процедура:

- Изключете крачния превключвател от Генератор.
- Пригответе ензимен детергент с неутрално pH, както е указано от производителя.
- Свържете здраво кабела с крачния превключвател и ги потопете в почистващия разтвор за 2 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че кабелът на крачния превключвател, използван за свързване на Генератор, е напълно сух, за да се предотврати случайно активиране.

- След потопяне ръчно почистете крачния превключвател и кабела с четка с мек косъм в почистващия разтвор.
- Изплакнете добре крачния превключвател и кабела с топла вода от чешмата в продължение на поне 1 минута.

ВНИМАНИЕ: Дръжте кабела и крачния превключвател здраво свързани по време на изплакването.

- Избършете всички повърхности с чиста, мека кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте ултразвукова машина за почистване на крачния превключвател.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включвайте захранването на Генератор, преди да свържете захранващия кабел. Уверете се, че всички връзки са сухи преди монтажа.

Почистване и дезинфекция на Преобразувател

Преобразувател се доставят стерилни и изискват щателно почистване и стерилизация преди всяка употреба.

Почистване:

Почистете Трансдюзера напълно според следните стъпки:

- Изплакнете Трансдюсера с винтовата страна нагоре и почистете с мека четка с пречистена вода, докато по повърхността не останат петна;
- Трансдюзертъ се накува в неутрален по pH ензимен детергент (основни съставки: протеаза, липаза, амилаза, целулаза, пектиназа и други биологични ензими, екологично чисти повърхностоактивни вещества, фактор за предотвратяване на ръждата и стабилизатор) за период до 10 минути при подходяща температура 15 °C ~ 65 °C. Съотношението на детергента и пречистената вода е 1:400.
- Изплакнете Трансдюсера с винтовата страна нагоре с пречистена вода за 2 минути;
- Почистете Свързващия винт, Повърхността за монтиране на скалел и Конектор с алкохолна кърпичка.
- Накиснете Трансдюсера в 75% медицински спирт, задръжте го и го разклатете 30 пъти;
- Изплакнете Трансдюсера с винтовата страна нагоре с пречистена вода за 2 минути.

Забележка: Използването на ултразвукови почистващи препарати не се препоръчва за Трансдюсера.

Изушаване:

Температура на сушене: 50 ~ 70 °C, време за сушене: 30 мин.

Стерилизация на Трансдюсера:

След стъпките за почистване и подсушаване по-горе, Трансдюзертъ трябва да се стерилизира по един от методите, изброени по-долу.

Стерилизация с пара (121 °C)

- Обвивката трябва да се постави преди стерилизация. Трансдюзертъ трябва да бъде увит по време на стерилизацията. Поставете Трансдюсера в съд за стерилизация с високотемпературна пара за стерилизация, с температура 121 °C и продължителност 30 мин.
- Температура на сушене: 50 ~ 70 °C, време за сушене: 30 мин.

Стерилизация с пара (134 °C)

- Обвивката трябва да се постави преди стерилизация. Трансдюзертъ трябва да бъде увит по време на стерилизацията. Поставете Трансдюсера в съд за стерилизация с високотемпературна пара за стерилизация, с температура 134 °C и продължителност 10 мин.
- Температура на сушене: 50 ~ 70 °C, време за сушене: 30 мин.

Тестове за безопасност и функционални тестове

Осигурете провеждането на тестове за безопасност и функционални тестове за устройствата Преобразувател, Генератор и крачен превключвател в съответствие с болничните процедури и разпоредби. За тестове за безопасност и функционалност на други компоненти, използвани от множество пациенти, се обърнете към инструкциите за експлоатация, специфични за всеки компонент.

Тест за безопасност

Генератор: Сертифицирани болнични техници трябва да извършат тест за ток на утечка.

Крачен превключвател: Проверете педала, кабелния съединител и кабела за пукнатини или повреди. Заменете всички повредени компоненти.

Други компоненти: Проверете всички останали компоненти, както е указано в съответните им инструкции за експлоатация.

Функционален тест

Ултразвуков режим

- Подгответе пълния комплект PD Ултразвукова ножица и свържете Преобразувател, като следвате инструкциите, дадени в Глава II - Монтаж и експлоатация на оборудването.
- Проверете дали е възможно да влезете в работно състояние. Различните ултразвукови ножици могат да имат различни интерфейси за влизане. За подробни инструкции вижте част 1, раздел 3 от глава 2.
- Потвърдете показването на MIN power Level 3 и MAX power Level 5.
- Натиснете бутоните за увеличаване и намаляване на мощността, за да се уверите, че нивото на мощност MIN може да се регулира от ниво 1 до 5.
- Включете захранването на Генератор и го превключете на ултразвуков режим на работа. Проверете правилното свързване на Преобразувател и Ултразвукова ножица.
- При отворена челюст натиснете бутона "MAX" на крачния превключвател. На LCD екрана трябва да се покаже нивото на мощност MAX "5" и да прозвучи звуков сигнал за активиране.
- При отворена челюст натиснете бутона "MIN" на крачния превключвател. На LCD екрана трябва да се покаже нивото на мощност MIN и да се чуе звуков сигнал за активиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да задействате системата, уверете се, че челюстта е далеч от тъкани, други инструменти или други предмети, за да предотвратите нараняване на потребителя.

Биполярен електрохирургичен режим

- Свържете съвършенствания биполярен електрохирургичен инструмент/основния биполярен инструмент съгласно инструкциите.
- Проверете дали системата може да влезе в работния интерфейс. В основен биполярен режим трябва да се показва иконата "30 ниво на мощност", а в разширен биполярен режим - иконата "разширен биполярен".
- Леко докоснете клавишите за увеличаване и намаляване на мощността в основния двуполусен режим, за да потвърдите, че нивото на мощността може да се регулира между 1 и 95. Докоснете бутоните Low (Ниско), Medium (Средно) и High (Високо), за да превключите директно между 15, 30 и 60.
- Изключете захранването на Генератор и изчакайте 5 секунди. След това включете захранването на Генератор и изчакайте 10 секунди. Проверете дали основният двуполусен режим показва интерфейса за 30 ниво на мощност, а разширеният двуполусен режим показва интерфейса "разширен двуполусен". Проверете дали устройството Генератор е активирано в съответствие с предварително определените изисквания.

- Свържете разширения и основния двуполусен модул Електрохирургични инструменти и натиснете единичния крачен превключвател. Проверете за мигачи индикации за нивото на мощност на контролния панел и се вслушайте в звука за активиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да активирате системата, е строго забранено да допускате какъвто и да е контакт на Ултразвукова ножица с тъкани, други инструменти или каквито и да е други предмети, за да предотвратите нараняване на потребителя.

Предупреждения и предпазни мерки

Свързани със системата

- Прочетете инструкциите преди употреба и следвайте болничните указания за клинична практика за ултразвукова хирургия, електрохирургия, гинекология и лапароскопия.
- Минимално инвазивните устройства могат да се различават при различните производители. Ако в една операция се използват едновременно минимално инвазивни инструменти и аксесоари от различни производители, проверете съвместимостта на инструментите и аксесоарите преди операцията и проверете дали аксесоарите, които се поставят в човешкото тяло, имат грапава повърхност, остър ръб или издатина, които могат да причинят рискове за безопасността.
- Това устройство е предназначено за използване само от обучени и лицензирани хирурзи. Не използвайте електрохирургични устройства, освен ако не сте били надлежно обучени за използването им за конкретната процедура, която ще трябва да извършите. Необучената употреба на това устройство може да доведе до непреднамерено сериозно нараняване на пациента, включително перфорация на червата и безсъзнателна и непоравима некроза на тъканите.
- Не отваряйте корпуса Генератор без разрешение, за да избегнете възможна опасност от токов удар. Всички ремонти и подобрения на инструмента трябва да се извършват от сервизно лице, обучено и оторизирано от Reach Surgical, Inc. Не използвайте този инструмент за цели, различни от медицинска хирургия.
- Задълбоченото разбиране на принципите и техниките, свързани с лазерните, електрохирургичните и ултразвуковите процедури, е от съществено значение за предотвратяване на опасността от удар и изгаряне на пациента и медицинския персонал, както и за предотвратяване на повреди на това устройство или на други медицински устройства. Не трябва да се нарушава електрическата изолация или заземяването. Не потапяйте електрохирургичните устройства в течности, освен ако конструкцията не го изисква и на етикета не е посочено, че те трябва да бъдат потапяни.
- Безопасната и ефективна ултразвукова хирургия и електрохирургия зависят не само от конструкцията на оборудването, но и в голяма степен от много фактори, контролирани от оператора. За да подобрите безопасността и ефективността, прочетете, разберете и спазвайте инструкциите за употреба, предоставени с устройството.
- Както при всички енергийни източници (електрохирургични, лазерни или ултразвукови), трябва да се вземат предвид канцерогенните и инфекциозните рискове, които могат да представляват много странични продукти от тъканите, като дим и аерозоли. Както при отворените, така и при ендоскопските процедури трябва да се спазват подходящи предпазни мерки, като предпазни очила, филтриращи маски и ефективно оборудване за евакуация на дима.
- След като отстраните устройството, проверете тъканта за хемостаза. Ако липсва хемостаза, трябва да се използват подходящи методи за постигане на хемостаза.
- Продукти, произведени или разпространявани от компании, които не са оторизирани от Reach Surgical, Inc., може да не са съвместими с устройството. Използването на такива продукти може да доведе до неочаквани резултати и да нарани потребителя или пациента.
- За да се намали рискът от смущения, устройството и корпусът трябва да бъдат свързани към независима електрическа верига.
- Оборудването не е подходящо за използване в присъствието на запалима анестетична смес с въздух или с кислород или азотен оксид. Възможност за искрене поради сблъсък с други металини устройства. Искрите могат да възпламяват запалими газове, като например полевени газове.
- Той трябва да работи в необходимия температурен диапазон на околната среда.
- Напрежението на изходния контакт трябва да отговаря на изискванията на Генератор (глава "Технически условия на системата"). Ако захранването не е свързано правилно, това може да доведе до повреда на Генератор и до опасност от токов удар или пожар.
- Не използвайте удължители, за да избегнете опасност от пожар.
- Не намалявайте звука за активиране до ниво, което не се чува. Тоноветте за активиране могат да бъдат забелязани от персонала на хирургичния екип, докато Генератор доставя енергия.
- Доказано е, че димът, генериран по време на електрохирургията, е потенциално опасен за пациентите или персонала на хирургичния екип. Предложете адекватна вентилация с помощта на хирургичен димоотвод или други средства.
- Някои компоненти на ултразвуковия хирургичен комплекс Генератор се доставят стерилни (напр. Преобразувател). Стерилизирайте продукта, както е необходимо, преди да започнете инсталирането на системата. За инструкции за почистване и стерилизация се обърнете към всяка съответна инструкция.
- За да се избегнат наранявания на потребители или пациенти, Ултразвукова ножица трябва да избягва други устройства, хирургичски чаршафи, пациенти или други предмети преди натискане на бутона за изпитване и по време на проверката на системата. Мерките за безопасност в случай на аерозол (съгласно болничните разпоредби) трябва да бъдат приложени в метода за проверка и изпитване на системата.
- Не оказвайте прекалено силен натиск върху челната, за да не възпрепятствате подаването на ултразвукова енергия.
- За да се избегне нараняване на потребителя, острието трябва да избягва контакт с тъкани, други устройства или други предмети, преди да активира системата.
- Ако върху или в Генератор се разпръсне или излее течност, или Генератор се разлее или излее в течност, това може да повреди Генератор и да причини токов удар или опасност от пожар.
- Искренето и нагриването, свързани с техниките за затваряне на съдовете, могат да послужат като източници на запалване. Марлята и гъбата трябва да останат влажни. Дръжте електрохирургичните електроди далеч от запалими материали и богата на кислород (O₂) среда.
- Когато има значителни повреди по Преобразувател или ако някои части показват признаци на повреда след почистване и дезинфекция, ги извършете. Повредените части са ясно обозначени, за да се избегне неправилна употреба преди последваща обработка.
- Отпадъците за еднократна употреба и електронните отпадъци се извършват в съответствие с разпоредбите на болницата и не се извършват по собствено желание, за да се избегне замърсяване на околната среда.
- Избягвайте да използвате Генератор в близост до друго оборудване или поставен върху него. Ако е необходимо използване в близост или поддръждане, наблюдавайте Генератор и другото оборудване, за да осигурите правилното им функциониране.
- Устройството не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани от оператора. За сервизно обслужване се обърнете към търговския представител на Reach Surgical или към сервизния персонал.
- Проверете всички устройства, свързани към системата, и връзките преди употреба. Проверете дали устройството работи по предназначение. Неправилното свързване може да доведе до образуване на електрическа дъга, искрене, неправилно функциониране на устройството или непредвидени хирургични резултати.
- За да се избегне рискът от токов удар, това оборудване трябва да се свързва само към захранване със защитно заземяване.
- Спазвайте възможно най-голямо разстояние между устройството Генератор и други електронни устройства (напр. монитори). Не пресичайте и не свързвайте електрически проводници с електронни устройства. Моделът Генератор може да предизвика смущения в работата на други електронни устройства.
- Системата трябва да се използва с повишено внимание при наличие на вътрешни и външни пейсмейкери. Смущенията, причинени от използването на Електрохирургични инструменти, могат да доведат до преминаване на пейсмейкъра в асинхронно състояние или напълно да попречат на функционирането му. Когато устройствата за електрохирургия или запечатване на тъкани са предназначени за използване при пациенти със сърдечни пейсмейкери, свържете се с производителя на пейсмейкъра или с кардиологичния отдел на болницата за

допълнителна информация.

- Бъдете внимателни, ако подреждате инструменти върху Генератор или поставяте Генератор върху електрически инструменти. Това е нестабилна конфигурация и не осигурява адекватно охлаждане.
- Ако Генератор се повреди, това може да доведе до прекъсване на операцията. Трябва да е налична резервна система.
- Ако се изисква от местните разпоредби, Генератор трябва да се свърже към еквипотенциалния конектор на болницата с помощта на еквипотенциален кабел.
- Когато системата и оборудването за физиологично наблюдение се използват едновременно при един и същ пациент, всеки електрод за наблюдение трябва да бъде поставен възможно най-далеч от инструмента.
- В основния биполярен режим изберете най-ниската възможна изходна мощност за желания ефект.
- Повредата на високочестотния хирургично оборудване може да доведе до неочаквано увеличаване на изходната мощност.
- В конектора Генератор и основния биполярен електрохирургичен конектор могат да попаднат вода или частици. В процеса на употреба и почистване е необходимо да се избягва навлизането на вода или частици.
- Когато системата се използва в комбинация с ендоскоп, тя може да увеличи тока на утечка върху тялото на пациента. Обърнете внимание по време на процедурата.
- Уведомление до потребителя и/или пациента, че всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да бъде докладван на Reach Surgical, Inc. чрез Reachquality@reachsurgical.com. и на компетентния орган на държавата-членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Свързани с инструмента

По време на хирургични процедури е важно да се знае, че крайната част на инструментите Ултразвукова ножица, ултразвукови ножици и Val може да има повишена температура, когато ултразвукът или биполярният електрокаутер се прилагат към тъканта за продължителни периоди от време. За да се гарантира безопасността, от решаващо значение е да се избягва всякакъв случаен контакт между тези компоненти на инструментата и тъканите, хирургическите чаршафи, хирургическите престилки или други несвързани с тях области по време на процедурата.

Освен това е изключително важно да се внимава при позиционирането на биполярния инструмент. По-конкретно, той не трябва да се поставя в близост до или в контакт с горими материали, като марля или хирургически чаршафи. Биполярните инструменти, използвани в този контекст, могат да генерират топлина по време на употреба, което потенциално може да доведе до опасност от пожар. Когато биполярният електрохирургичен инструмент Генератор не се използва, той трябва да се съхранява правилно в защитния ръкав или да се държи на безопасно разстояние от пациента, членовете на хирургичния екип и всякакви горими материали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте съответните инструкции за употреба за допълнителни предупреждения и предпазни мерки.

Информация за EMC

Продуктът е преминал успешно теста за електромагнитна съвместимост, който отговаря на изискванията за ограничения на стандарта IEC60601-1-2 за медицинско оборудване. Тези ограничения осигуряват разумна защита срещу вредни смущения при нормални медицински инсталации.

Състав на продукта

Сериен номер	Име на частта	Номер на модела/версията	Забележки
1	Електрохирургичен инструмент	OP9	/
2	Преобразувател на ултразвуково хирургично оборудване	TRA6	Съвместима употреба
3	Ултразвукова ножица Система за еднократна употреба Ултразвукова ножица	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Съвместима употреба
4	Ултразвуков високочестотен хирургичен апарат за еднократна употреба Уплътнител за тъкани	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ултразвуков крачен превключвател (педал)	OP-FSD	/
6	Електрохирургичен крачен превключвател (педал)	OP-FSS	/
7	Биполярен конектор за електрохирургия	OP-BPC	/

Кабел на продукта

Сериен номер	Име на кабела	Дължина (m)	Екраниран
1	Кабел за крачен контрол	3	Да
2	Захранващ кабел	5	Не
3	Биполярен електрохирургичен кабел	3	Не
4	Кабелът на Преобразувател	2.9	Да

Производителност на EMC

Това оборудване може да бъде обект на радиочестотни смущения, причинени от друго медицинско оборудване и радиокомуникации. За да се предотвратят такива смущения, този продукт е тестван в съответствие с IEC 60601-1-2 и отговаря на неговите изисквания. Въпреки това Reach Surgical, Inc. не гарантира, че няма да има абсолютно никакви смущения в индивидуалните условия на инсталиране.

Ако се установи, че устройството се смущава (което може да се определи чрез включване и изключване на устройството), потребителят (или персоналот по поддръжката, одобрен от Reach Surgical, Inc.) трябва да се опита да предприеме една или повече от следните мерки за решаване на проблема със смущенията:

Регулиране на посоката или позицията на устройството, което го засяга.

Увеличете разстоянието между това устройство и изпращащото устройство.

Използвайте други източници на захранване (а не захранването, използвано за въздействие върху оборудването) за захранване на това оборудване.

Консултирайте се с доставчика или сервизния представител за други предложения.

Производителят не носи отговорност за каквито и да било смущения, причинени от следните ситуации: използване на други свързващи кабели, различни от препоръчаните; промяна или модификация на това оборудване без разрешение. Неразрешените промени или модификации могат да доведат до загуба на ефикасност на оборудването.

Всички видове електронно оборудване могат да причинят електромагнитни смущения на друго оборудване чрез въздуха или други кабели, свързани с него. Не използвайте в близост до това устройство устройства, които могат да излъчват радиочестотни сигнали, като например мобилни телефони, радиоприемници или продукти за радиуправление, тъй като това може да доведе до несъответствие на работата на това устройство с посочените спецификации. Когато такива устройства са в близост до това устройство, изключете захранването на тези устройства. Медицинският персонал, отговарящ за това устройство, трябва да инструктира техниците, пациентите и другия персонал, който може да се намира в близост до това устройство, да спазват изцяло горните изисквания.

За да се постигнат напълно определени характеристики на EMC, потребителят трябва да инсталира продукта правилно в съответствие със

стъпките, описани в ръководството. Ако възникнат проблеми, свързани с EMC, моля, свържете се с персонала по поддръжката, одобрен от Reach Surgical, Inc.

Моделите Преобразувател (с кабел) и ултразвукови ножици се определят като приложна част на цялата система.

Предпазни мерки за инсталиране на продукта

Оборудването може да се използва в болнична среда, но не включва помещения за радиочестотно екраниране около активно радиочестотно хирургично оборудване или там, където е поставено оборудване за магнитно-резонансно въздействие, тъй като интензитетът на електромагнитните смущения на тези места е висок.

Разстояние и въздействие на стационарно радиокомуникационно оборудване: интензивността на магнитното поле, генерирано от стационарни предаватели, като базови станции на безжични (клетъчни/безжични) телефони, наземни мобилни радиоприемници, любителски радиоприемници, AM и FM радиопредавания и телевизионни предавания Генератори и т.н., не може да бъде точно измерена теоретично. За да се оцени електромагнитната среда, генерирана от стационарни радиочестотни предаватели, трябва да се помисли за измерване на електромагнитното поле. Ако измерената стойност на напрежението на магнитното поле в мястото на устройството надвишава съответното ниво на радиочестота, посочено в "Декларацията за защита от смущения", устройството трябва да се провери, за да се гарантира, че може да работи нормално. Ако се установят необичайни условия на работа, трябва да се обмислят допълнителни измервания, като например преинсталиране или преместване на оборудването или използване на помещието за борба с радиочестотите.

1) Използвайте захранващи кабел, предоставен или посочен от Reach Surgical, Inc. Продуктите, оборудвани със захранващ щепсел, трябва да се включват към стационарен електрически контакт със защитно заземяване. Не използвайте какъвто и да е тип адаптер или конектор за свързване на захранващия щепсел.

2) Дръжте това устройство възможно най-далеч от други електронни устройства.

3) Следете стъпките за свързване на устройството.

Общи бележки

(1) Спецификацията на кабела.

Използването на кабели, предоставени от Reach Surgical, Inc, няма да наруши характеристиките на този продукт по отношение на EMC. Ако се използват неуточнени кабели, характеристиките на EMC на това оборудване могат да бъдат значително намалени.

(2) Предпазни мерки за неотризиранни модификации

Потребителят не трябва да модифицира този продукт, в противен случай характеристиките на този продукт по отношение на електромагнитната съвместимост могат да намалееат.

Модификацията на продукта включва следните промени:

a. Кабел (дължина, материал, окабеляване и др.).

b. Инсталиране/разположение на оборудването.

c. Конфигурация/компоненти на оборудването.

d. Части за защита на оборудването (части за отваряне/затваряне на капака и части за закрепване на капака).

(3) При работа с оборудването всички защитни капаци трябва да бъдат затворени.

Очаква се този продукт да се използва в електромагнитната среда, посочена по-долу, и купувачът и потребителят на този продукт трябва да гарантират, че той се използва в тази електромагнитна среда.

Основно представяне

1. За усъвършенствана висококачествена радиоенергия системата трябва да гарантира, че отклонението на номиналната изходна мощност не надвишава 20% от стандартната стойност.

2. За основната висококачествена радиоенергия системата трябва да гарантира, че отклонението на номиналната изходна мощност не надвишава 20% от стандартната стойност.

Ръководство и декларация на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЕМИСИИ		
Устройството е предназначено за използване в електромагнитна среда, определена, както следва. Клиентът или потребителят на устройството трябва да се увери, че той се използва в такава среда.		
Тест за емисии	Съответствие	Електромагнитна среда - насоки
Радиочестотни емисии CISPR 11	Група1	устройството използва радиочестотна енергия само за вътрешната си функция. Поради това неговите радиочестотни емисии са много ниски и няма вероятност да предизвикат смущения в близкоелектронно оборудване.
Радиочестотни емисии	Клас А	ЕМИСИИТЕ на това оборудване го правят подходящо за използване в промишлени зони и болници.
Хармоничен ток IEC 61000-3-2	Клас А	
Промени в напрежението/колебания на напрежението/трептене IEC 61000-3-3	Съответства на	

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост

Устройството е предназначено за използване в електромагнитна среда, определена както следва.

Клиентът или потребителят на устройството трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.

Тест за ИМУНИТЕТ	IEC 60601 ниво на изпитване	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда - насоки
Електростатичен разряд (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV контакт ± 2,4,8,15kV въздух	± 8 kV контакт ± 2,4,8,15kV въздух	Подовите трябва да са от дърво, бетон или керамични плочки. Ако подовите са покрити със синтетични материали, Относителната влажност на въздуха трябва да бъде най-малко 30%.
Електрически бърз преход/избухване IEC 61000-4-4	± 2 kV за захранващи линии ± 1 kV за входни/изходни линии	± 2 kV за захранващи линии ± 1 kV за входни/изходни линии	Качеството на захранващата мрежа трябва да отговаря на това на типична търговска или болнична среда.
Пренапрежение IEC 61000-4-5	± 1 kV линия(и) до линия(и) ± 2 kV линия(и) към земята	± 1 kV линия(и) до линия(и) ± 2 kV линия (s) към земя	Качеството на захранващата мрежа трябва да отговаря на това на типична търговска или болнична среда.
Спад на напрежението, ксис прекъсвания на входните линии на захранването IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 цикъла при 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% UT; 1 цикъл и 70% UT; 25/30 цикъла Еднофазно: при 0° 0% UT; цикъл 250/300	0% UT; 0,5 цикъла При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315° 0% UT; 1 цикъл и 70% UT; 25/30 цикъла Еднофазно: при 0° 0% UT; цикъл 250/300	Качеството на захранващата мрежа трябва да отговаря на това на типична търговска или болнична среда. Ако потребителят на ултразвуковия хирургичен Оборудването изисква продължителна работа при прекъсване на електрозахранването, се препоръчва ултразвуковата хирургична Оборудването да се захранва от непрекъсваемо електрозахранване или от батерия.

Честота на захранване (50/60 Hz) Магнитно поле IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Магнитна честота на захранване полетата трябва да са с характерно ниво. На типично място в типична търговска или болнична среда.
--------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост

Устройството е предназначено за приложение в електромагнитна среда, определена, както следва.
Клиентът или потребителят на устройството трябва да се увери, че то се използва в такава среда.

ИМУНИТЕТ тест IEC 60601 тест ниво Съответствие ниво Електромагнитна среда - насоки

Проведени радиочестоти IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz до 80 MHz 6 V в ISM ленти между 0,15 MHz и 80 MHz 3V/m 80 MHz до 2,7 GHz 80 % AM при 1 kHz	3V 3V/m	Преносими и мобилни радиочестотни комуникации Оборудването не трябва да се използва по-близо до която и да е част на устройството , включително кабелите, от препоръчителното разстояние на разделяне, изчислено от уравнението за честотата на предавателя. Препоръчително разстояние на разделяне $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ 80MHz до 800MHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ 800MHz до 2,7GHz където P е максималната номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя, а d е препоръчителното разстояние на разделяне в метри (m). Силата на полето от стационарни радиочестотни предаватели, определена чрез електромагнитно изследване на мястото на работа.З трябва да бъде по-малка от нивото на съответствие във всеки честотен диапазон. Възможно е да възникнат смущения в близост до оборудване, обозначено със следния символ:  Присъщието на ME EQUIPMENT и ME SYSTEMS се изпитва, както е посочено в таблица 9 от IEC 60601-1-2, като се използват методите за изпитване, посочени в IEC 61000-4-3.
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Препоръчителни разстояния между преносимото и мобилното радиочестотно комуникационно оборудване и устройствата.

Ултразвуково хирургично оборудване е насочен към приложение в електромагнитна среда, в която се контролират излъчваните радиочестотни смущения. Клиентът или потребителят на устройството може да помогне за предотвратяването на електромагнитни смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предаватели) и устройството, както е препоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална изходна мощност на предавателя (w)	Разстояние на разделяне в зависимост от честотата на предавателя /m 150 kHz до 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz до 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz до 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщане и отразяване от структури, предмети и хора.

Технически условия

Компоненти, необходими за работата на системата: Електрохирургичен инструмент, Преобразувател, Ултразвуков крачен превключател(педал), Електрохирургичен крачен превключател(педал), Ултразвукова ножница или Електрохирургични накрайници., Електрохирургичен биполярен конектор Биполярен инструмент.

Вижте описанието на продукта за този компонент.


Степен на защита от токов удар	Ултразвук:  Тип CF приложна част; биполярна електрохирургична  дефибрилационноустойчива Тип CF приложна част
Степен на защита срещу електрически удар	Клас I
Генератор до вредни инфузии	Нормално оборудване
Степен на защита срещу вредно проникване на вода	Превключвател за краката: IP68
Категория Управление	Клас IIb
Изисквания за параметрите на ултразвуковия режим:	
Входяща мощност	Захранващо напрежение: 100-240V Честота на захранване: 50Hz/60Hz Входяща мощност: 400VA
Изисквания за параметрите на ултразвуковия режим:	
Честота на възбуждане	54 kHz - 57 kHz
Вибрационно отклонение на първичния накрайник	25 μm ~ 110 μm

Ултразвукова ножица накрайник основна акустична изходна повърхност Продукт:	1,53-2,75 mm2
Вторично кръстосано свързване Акустично при накрайник ултразвукови ножици Изходна зона:	19,32~35,88 mm2
Произведен изходен звук при Ултразвукова ножица накрайник при референтен накрайник Първична амплитуда Мощност	< 30W
Вид на честотния контрол на системата	Независимо от натоварването, честотата на възбудяне се регулира автоматично и непрекъснато.
Индекс на резерва на мощността	Не по-малко от 2,5
Изисквания за електрехирургичните параметри:	
Работна честота	400KHz ± 5%
Максимално изходно напрежение	≤ 250V
Разширен биполярен режим Максимален изходен ток	≤ 5.5A
Основен биполярен режим Максимален изходен ток	≤ 2.2A
Максимално изходно напрежение от пик до пик	≤ 500Vpk
Пиков фактор	1.6 ± 0.4
Номинална мощност	Усъвършенствана биполярна радиочестота: 270 W Радиочестота Основен биполярен: 95W
Номинално натоварване	Усъвършенствана биполярна радиочестота: 30Ω Радиочестота Основен биполярен: 200Ω

Условия на работната среда	Температура: 10 °C до 30 °C
	Относителна влажност: ≤ 70%
Условия за транспортиране и съхранение	Обхват на атмосферното налягане: 800 hPa до 1060 hPa
	Температура: от -30 °C до +55 °C (Генератор, крачен превключвател, адаптер) Температура: от -10 °C до +55 °C (Ултразвукова ножица)
	Влажност: ≤ 80%
	Обхват на атмосферното налягане: 800 hPa до 1060 hPa
Дата на производство	Датата на производство може да се определи по серийния номер на задния панел на Генератор.
Захранващ кабел	Съответствие с изискванията за сертифициране на CCC
	Текуща оценка: 10A
Степен на устойчивост	Определя се с помощта на наконечник Преобразувател и Ултразвукова ножица. За информация относно степента на устойчивост вижте приложимите ултразвукови ножици и Преобразувател Инструкции за накрайника или Глава 7 - Предупреждения и предпазни мерки.
Предпазител	€5 * 20 T8AH250V
Тегло (без опаковка)	Генератор: номинална стойност 8 kg
Общ обем	OP9 Генератор: (дължина * ширина * височина): 34 см-34 см-16 см
Разпореджване	Някои вътрешни компоненти на Генератор, превключвателя за крака и кабела за превключвателя за крака съдържат олово. В съответствие с местните Изисквания и разпоредби за изхвърляне. Изхвърляйте батериите в съответствие с подходящите практики за изхвърляне на отпадъци.
Класификация AP/APG	Не е оборудване AP/APG.
Срок на експлоатация:	Срок на експлоатация: 7 години
Версия на софтуерната версия	V01.01

Биполярна изходна форма на вълната


Усъвършенствана биполярна изходна крива мощност-натоварване

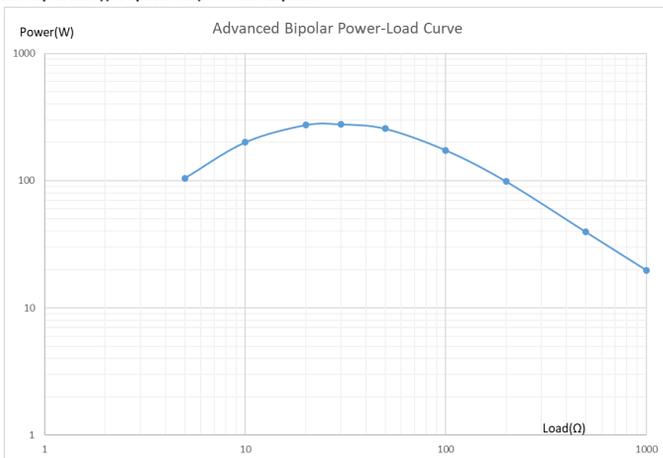

Граница на кривата на мощността Максимална мощност: 270[W]			
Натоварване (Ω)	Долна граница	Номинален	Горна граница
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Номинална крива на мощността от 270 вата при номинално натоварване в съответствие с ограничението на тока/напрежението на измервателния уред за кривата на мощността. Кривата на мощността представлява обвивката, която се променя при работно състояние.

Основна крива на биполярния изход при пълна мощност и натоварване

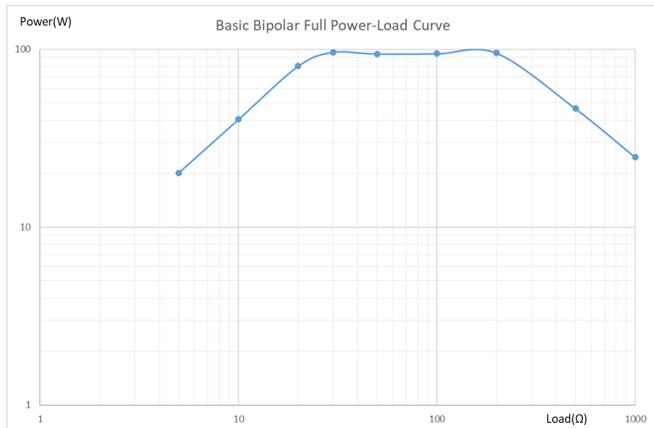


Граница на кривата на пълната мощност [W]: Максимална мощност 95 вата			
Натоварване (Ω)	Долна граница	Номинален	Горна граница
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Основна крива на половин мощност и натоварване на биполярния изход

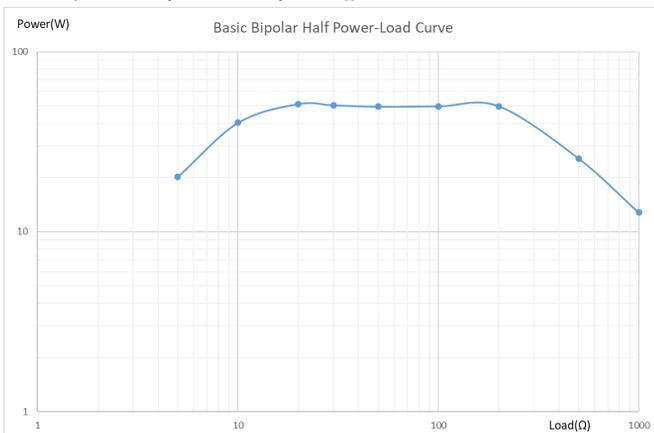

Граница на кривата на половин мощност [W]: Максимална мощност 50 вата			
Натоварване (Ω)	Долна граница	Номинален	Горна граница
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Исходна мощност в зависимост от настройките на мощността за мощност в нормален двуполюсен режим

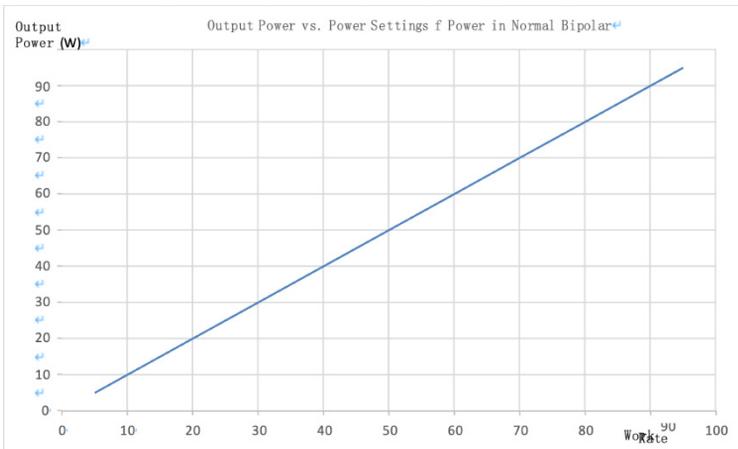

Исходна мощност в зависимост от зададената стойност на мощността за нормален двуполюсен режим [W]; натоварване: 200Ω			
Зададена мощност (W)	Долна граница на изходната мощност (W)	Номинална мощност (W)	Горна граница на изходната мощност (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Обслужване и гаранция

Reach Surgical, Inc. гарантира, че този продукт е без дефекти в материала и изработката при нормална употреба и превантивна поддръжка за гаранционния период, посочен по-долу. Задължението на Reach Surgical по тази гаранция се ограничава до ремонт или замяна, по неин избор, на всеки дефектен продукт или част, който е върнат на Reach Surgical, Inc. или на нейния оторизиран дистрибутор в рамките на приложимия гаранционен период и за който е установено, че е дефектен по удовлетворителен за Reach Surgical начин. Тази гаранция не се прилага за продукти или части, които са били:

- Неблагоприятно въздействие поради употреба с неразрешени устройства, произведени или разпространявани от страни, които не са оторизирани от Reach Surgical, Inc.
- Ремонтирани или променени извън фабриката на Reach Surgical, ако това се отразява на стабилността или надеждността на устройството, както е определено от Reach Surgical.
- Подложен на неправилна употреба, небрежност или злоупотреба.
- Използва се по начин, несъответстващ на дизайна, параметрите на употреба, инструкциите и указанията за продукта или на приетите в индустрията функционални, експлоатационни или екологични стандарти за подобни продукти.

Гаранционни срокове

Основен bipolarен енергиен съединител (OP-BPC): 1 година за компоненти и труд.

Генератор (OP9): 1 година за компоненти и труд.

Крачен превключвател/захранващ кабел: 1 година за компоненти и труд.

Тази гаранция е изключителното средство за защита на първоначалния купувач и замяна всички други гаранции, и изрични или подразбиращи се, включително гаранциите за продаваемост и годност за определена цел. Reach Surgical, Inc. не носи отговорност за каквито и да било специални, случайни или последващи щети, включително щети, произтичащи от загуба на употреба, печалби, бизнес или добра репутация, освен ако това не е изрично предвидено от приложимото законодателство.

Reach Surgical, Inc. не упълномощава никое лице да поема допълнителна отговорност във връзка с продажбата или използването на нейните продукти. Не съществуват гаранции, които да надхвърлят посочените тук условия.
Reach Surgical, Inc. си запазва правото да прави промени в своите продукти, без да поема задължение да прилага тези промени със задна дата към вече продадени или произведени продукти.

Přehled

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte následující informace. Obsahuje důležité pokyny týkající se správné obsluhy, možných rizik a možného poškození výrobku nebo osob. V případě jakékoliv nestandardní situace postupujte podle uvedených pokynů, abyste zabránili vlastnímu poškození nebo poškození zařízení. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ohrožení bezpečnosti, výkonu, záruky nebo údržby, za které výrobce nemůže nést odpovědnost. Před použitím zařízení si přečtěte také návod k obsluze zařízení Převodník a Ultrazvukové nůžky. Tento dokument je určen jako pomůcka při používání tohoto zařízení. Nejedná se o odkaz na chirurgické techniky.

Použití standardní konvence: Upozornění, VAROVÁNÍ a poznámky

Vezměte na vědomí následující pokyny, které jsou klasifikovány jako UPOZORNĚNÍ, VAROVÁNÍ nebo POZNÁMKA a které poskytují základní pokyny pro bezpečné a důkladné provedení úkolů. Tato prohlášení najdete v celé dokumentaci a měli byste si je přečíst, než přejdete k dalšímu kroku postupu.

UPOZORNĚNÍ: Toto prohlášení upozorňuje na provozní nebo údržbový postup, praxi nebo stav, který by při jeho nedůsledném dodržování mohl vést ke zranění osob nebo ztrátě života.

VAROVÁNÍ: Toto upozornění upozorňuje uživatele na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele nebo pacienta a k poškození zařízení nebo jiného majetku. Může také sloužit jako varování před nebezpečnými postupy. Zahrnuje nezbytná opatření pro bezpečné a účinné používání přístroje a péči nutnou k zabránění škodám vzniklým v důsledku správného nebo nesprávného používání.

POZNÁMKA: Toto tvrzení označuje provozní postup nebo podmínku, která je nezbytná pro efektivní provedení úkolu.

Popis

Elektrochirurgický nástroj ENER REACH (dále jen "přístroj") se používá na lékařských operačních sálech při chirurgických zákrocích, při nichž se řeže, koaguluje lidská tkáň a podvazují cévy. Je vybaven dvěma oddělenými otvory: jedním pro ultrazvukovou energii a druhým pro výstup radiofrekvenčních vln.

V radiofrekvenčním režimu dodává přístroj Generátor různá energetická schémata v závislosti na připojeném přístroji/elektrochirurgickém zařízení. Pokud je připojen pokročilý bipolární nástroj, přístroj Generátor dodává radiofrekvenční vlny pro uzavírání arteriálních a venózních cév, lymfatických a tkáňových svazků o průměru až 7 mm. Po připojení základního bipolárního nástroje je vyvedena energie konstantního výkonu pro řezání a koagulaci měkkých tkání.

V režimu výstupu ultrazvukové energie při použití TRA6 Převodník v kombinaci s Jednorázový ultrazvukový skalpel CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD přístroj řeže měkké tkáně vyžadující kontrolu krvácení a minimální tepelné poškození a utěšňuje cévy do maximálního průměru 5 mm. Ve spojení s přístroji Jednorázové ultrazvukové nůžky SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 a SRE45 přístroj řeže měkké tkáně vyžadující kontrolu krvácení a minimální tepelné poškození a uzavírá cévy do maximálního průměru 7 mm.

Zamýšlené použití

Přístroj poskytuje radiofrekvenční energii pro pohon elektrochirurgických nástadů, které jsou určeny k řezání a utěšňování cév a k řezání, uchopování a pitvání tkání.

Přístroj Generátor navíc poskytuje ultrazvukový výkon pro pohon ultrazvukových chirurgických nástrojů, které jsou určeny pro řezání měkkých tkání, kdy je požadována kontrola krvácení a minimální tepelné poškození.

Indikace

Přístroj poskytuje radiofrekvenční energii k pohonu elektrochirurgických nástadů, které se používají při otevřených operacích nebo laparoskopických operacích ve všeobecné, dětské, gynekologické, urologické a hrudní chirurgii k řezání a utěšňování cév do 7 mm včetně a k řezání, uchopování a pitvání tkání.

Přístroj Generátor navíc poskytuje energii pro pohon ultrazvukových chirurgických nástrojů, které jsou určeny pro řezání měkkých tkání, kdy je požadována kontrola krvácení a minimální tepelné poškození. Ultrazvukové chirurgické nástroje lze použít jako doplněk nebo náhradu elektrochirurgie, laserů a ocelových skalpelů k řezání a/nebo koagulaci tkáně při otevřených operacích nebo laparoskopických operacích v oblasti všeobecné, dětské, gynekologické, urologické, hrudní chirurgie a k utěšňování a transekcí lymfatických cév.

Zamýšlený uživatel

Přístroj je určen pro použití zdravotnickými pracovníky pro chirurgické aplikace.

Prostředí zamýšleného použití

Zařízení je určeno k použití v nemocnici.

Zamýšlená populace pacientů

Tento přístroj je vhodný pro pacienty ve věku od 3 let, kteří vyžadují chirurgické zákroky zahrnující řezání měkkých tkání s kontrolou krvácení a minimálním tepelným poraněním.


Klinický přínos

Přístroj lze bezpečně a účinně použít k podvazování a dělení cév, tkáňových svazků a lymfatických.

Kontraindikace

Tento přístroj je kontraindikován pro kostní řezy, antikoncepční tubární okluzi a koagulační zákroky. Není rovněž určen k použití v neurochirurgii.

Složení systému

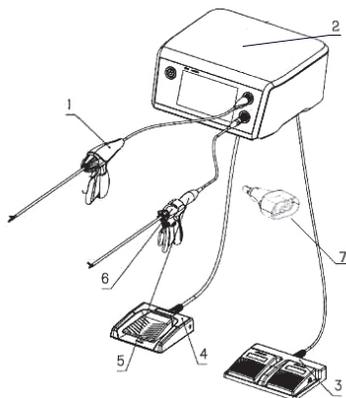

[01] Elektrochirurgické koncovky	[02] OP9 Generátor
[03] Ultrazvukový nožní spínač	[04] Elektrochirurgický nožní spínač
[05] Převodník	[06] Ultrazvukové nůžky
[07] Elektrochirurgický bipolární převodník	

[01] Elektrochirurgický násadec

Elektrochirurgický násadec připojený k přístroji Generátor obsluhuje během zákroku chirurg. Aplikuje radiofrekvenční elektrochirurgickou energii na tkáň mezi jejími Čelisti ke koagulaci nebo utěsnění. Součástí nástroje je také čepel pro dělení tkáně. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Podrobné informace naleznete v návodu k použití.

[02] OP9 Generátor

Přístroj Generátor poskytuje elektrochirurgickou energii i energii ultrazvukové terapie prostřednictvím samostatných portů pro připojení nástrojů. Skládá se z šasi, pláště, elektronické desky, dotykového LCD displeje, vypínače a rozhraní pro připojení příslušenství.

Model: OP9

[03] Ultrazvukový nožní spínač

Slouží k ovládání zapnutí/vypnutí výstupu ultrazvukové energie pomocí dvou přepínačů ("MIN" a "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrochirurgický nožní spínač

Slouží k ovládání zapnutí/vypnutí výstupu vysokofrekvenční energie pomocí jediného spínače.

Model: OP-FSS

[05] Převodník

Přístroj Převodník převádí elektrickou energii z kompatibilního přístroje Generátor na mechanický pohyb lopatek přístroje. Jedná se o opakovaně použitelný přístroj s omezenou životností. Přístroj Převodník není sterilní a před použitím musí být sterilizován podle návodu. Podrobné informace naleznete v návodu k použití TRA6 Převodník.

Model: TRA6.

[06] Ultrazvukové nůžky

Přístroj Ultrazvukové nůžky využívá mechanický pohyb z přístroje Převodník a dodává ultrazvukovou energii pro řezání nebo koagulaci tkáně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože mechanické vibrace nejsou detekovatelné a mohly by neúmyslně ovlivnit necílové oblasti. Přístroje Ultrazvukové nůžky se sterilizují ethylenoxidem. Pokud dojde k překročení doby použitelnosti nebo k poškození sterilizačního obalu, neměly by se přístroje Ultrazvukové nůžky používat a měly by být zlikvidovány. Podrobné informace naleznete v návodu k použití přípravku Ultrazvukové nůžky.

S OP9 Generátor jsou kompatibilní následující modely Ultrazvukové nůžky:

Série PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Rada SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Série SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektrochirurgický bipolární konektor

Slouží k připojení základního bipolárního přístroje Elektrochirurgické nástroje k přístroji Generátor pro koagulaci tkání.

Model: OP-BPC

Generátor Přední panel

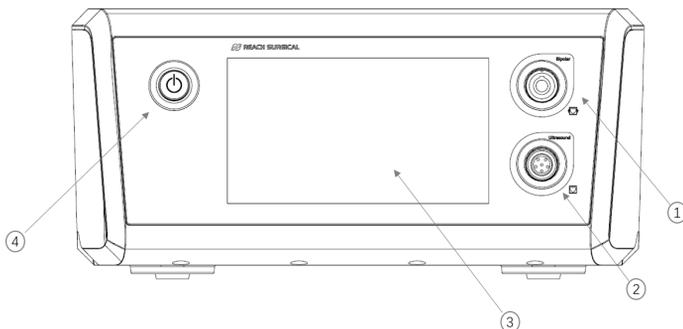

[01] Elektrochirurgická zásuvka

Slouží k připojení pokročilého bipolárního konektoru Elektrochirurgické nástroje nebo elektrochirurgického bipolárního konektoru.

[02] Převodník zásuvka

Připojuje zařízení Převodník k zařízení Generátor.


[03] Dotykový displej LCD

Zobrazuje systémové informace a slouží jako rozhraní pro úpravu ovládacích prvků a nastavení.

[04] Tlačítko vypínače

Stisknutím tlačítka zapnete přístroj Generátor; stisknutím a podržením tlačítka jej vypnete.

Generátor Zadní panel

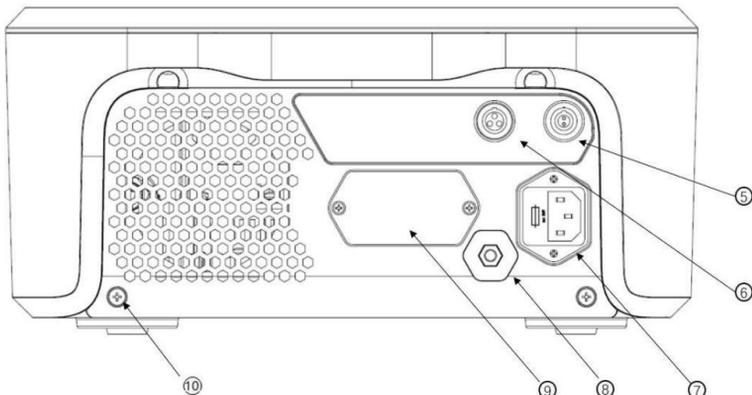

[05] Zásuvka elektrochirurgického nožního spínače

Kulatá zásuvka pro připojení elektrochirurgického nožního spínače.

[06] Zásuvka pro ultrazvukový nožní spínač

Kulatá zásuvka pro připojení ultrazvukového nožního spínače.

[07] Napájecí zásuvka

Připojuje napájecí kabel k zařízení Generátor.

[08] Vyrovňovací port potenciálů

Pokud je uzemnění zásuvky nejisté, umožňuje tento port připojení k chráněnému uzemnění.

[09] Rozšiřující rozhraní

Slouží k rozšíření funkcí a údržbě.

[10] Montážní otvor

Návod k použití

Provozní prostředí je popsáno v příložených pokynech.

Rozbalení

Po obdržení komponentů postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození při přepravě. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte společnost Reach Surgical, Inc. nebo místního zástupce a požádejte o pomoc.

Komponenty zahrnuté v (Podrobné technické specifikace a kódy výrobků naleznete v kapitole "Technické podmínky systému"):

Model	Popis	Komponenta
OP9	Generátor	Generátor, napájecí kabel, návod
TRA6	Převodník	Převodník s kabelem
OP-FSD	Ultrazvukový nožní spínač	/
OP-FSS	Bipolární nožní spínač	/
OP-BPC	Základní bipolární energetický konektor	/

Bezpečnostní opatření

- Během kontroly zařízení udržte distální konec nástroje mimo dosah jiných přístrojů, chirurgických roušek, pacienta nebo jiných předmětů, aby nedošlo k poranění.
- Provádějte nezbytná bezpečnostní opatření v přítomnosti výparů podle nemocničních postupů a předpisů.

Ultrazvuková energie s řadou PD Ultrazvukové nůžky

- Připojte Převodník, nožní spínač a PD řady Ultrazvukové nůžky k Generátor.
- Po absolvování testu Převodník a Ultrazvukové nůžky nastavte úroveň výkonu (1-5) pomocí ikon +/- na displeji LCD.
- Stisknutím tlačítka "Min" na přístroji Ultrazvukové nůžky nebo pedálu Min na nožním spínači aktivujete ultrazvukovou energii na nastavené úrovni výkonu.
- Stisknutím tlačítka "Max" na přístroji Ultrazvukové nůžky nebo pedálu Min na nožním spínači dosáhnete maximální úrovně energie.
- Uvolněním klíče nebo nožního spínače zastavíte výdej energie.

Ultrazvuková energie s SRB/SRE řady Ultrazvukové nůžky

- Po absolvování testu Převodník a Ultrazvukové nůžky nastavte úroveň výkonu (1-5) pomocí ikon +/- na displeji LCD.
- Stisknutím tlačítka Tlačítko energie na přístroji nebo tlačítka Min na nožním pedálu aktivujete ultrazvukovou energii na nastavené úrovni výkonu.
- Stisknutím tlačítka Tlačítko energie s funkcí pokročilé hemostázy na přístroji aktivujete režim pokročilé hemostázy.

- Uvolněním tlačítka na přístroji Ultrazvukové nůžky nebo tlačítka na přístroji Nožní spínač zastavíte dodávku energie.

Elektrochirurgická bipolární energie s pokročilými bipolárními nástroji

- Na LCD displeji se zobrazí ikona pokročilého bipolárního ovládání a ikona nastavitelného ručního ovládání.
- Pro aktivaci rádiové frekvence zatáhněte za tlačítko Páka na přístroji nebo stiskněte pedál nožního spínače.
- Přístroj Generátor zastaví výstup energie po dokončení uzávěru, což je indikováno ikonou dokončení na obrazovce.
- Pokud je ligace neúplná, zazní varovný tón a zobrazí se varovná ikona.

Bipolární elektrochirurgická energie s bipolárním elektrochirurgickým nástrojem

- Na displeji LCD se zobrazuje hodnota výkonu, nastavitelné ikony a sloupce úrovně výkonu.
- Nastavení výkonu se pohybuje v rozmezí 1-95 wattů s nastavitelnými přírůstky.
- Zvolte požadované nastavení výkonu: Nízký (15 wattů), střední (30 wattů) nebo vysoký (60 wattů).
- Stisknutím tlačítka na ručním spínači nebo nožním pedálu aktivujte rádiovou frekvenci.
- Uvolněním tlačítka výstup energie deaktivujete.

Doporučení pro nastavení

Nastavení efektu	Rozsah nastavení výkonu	Klinická aplikace	Optimalizované zařízení
Nízká	1-15 wattů	Například nervy/páteř, ruce a operace obličeje.	- Zařízení s menším povrchem - Kleště s mikrohrotem (0,4 - 2,2 mm)
Mid	16-40 wattů	Jako je koagulace při vyšetření hlavy/krku, páteře a anatomie.	- Zařízení se střední plochou povrchu - Kleště s mikrohrotem (1,0 - 2,2 mm) - Malé laparoskopické kleště s plochou hlavou - Bipolární nůžky
Vysoká	45-95 wattů (po 5 wattech)	Například chirurgie hlavy/krku a plastická chirurgie (podobně jako střední účinek, ale s rychlejším účinkem).	- Zařízení s velkým povrchem - Velké laparoskopické kleště s plochou hlavou

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní s neutrální elektrodou.

POZNÁMKA: Ultrazvukové nůžky a RF elektrický skalpel jsou díly, které se používají při kontaktu s pacientem.


Používání modelu Generátor

Zapnutí zařízení

- Po zapnutí je systém připraven k provozu. Když je přístroj Generátor připojen k elektrické síti a svítí kontrolka pohotovostního režimu, je systém připraven k provozu.
- Po stisknutí pohotovostního tlačítka se zobrazí následující obrázek:




- Pokud k zařízení Generátor není připojeno žádné zařízení Převodník nebo Ultrazvukové nůžky nebo jsou připojeny nesprávně, zobrazí se následující obrázek:



Použití ultrazvukového přístroje (Převodník a Ultrazvukové nůžky)

Při detekci Převodník a Ultrazvukové nůžky se zobrazí následující obrázek.

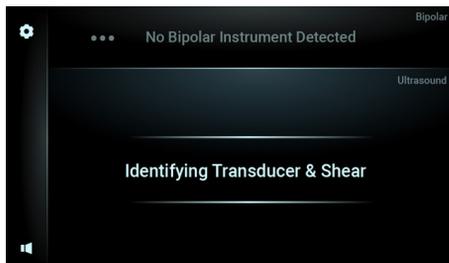


POZNÁMKA: pokud je zbývající počet použití Převodník menší než 10, zobrazí se následující obrázek. Věnujte prosím pozornost počtu zbývajících použití, protože když se počet použití stane nulovým, je třeba přístroj Převodník vyměnit.




Poté se zobrazí následující obrázek a budete vyzváni, abyste stiskli libovolné tlačítko na přístroji Ultrazvukové nůžky a spustili test Ultrazvukové nůžky s otevřeným přístrojem Čelisti.




Stiskněte libovolné tlačítko a zobrazí se následující obrázek.

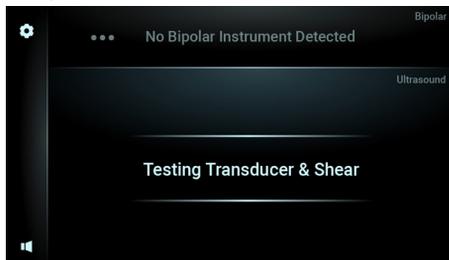


Pokud test Převodník selže, zobrazí se následující obrázek:

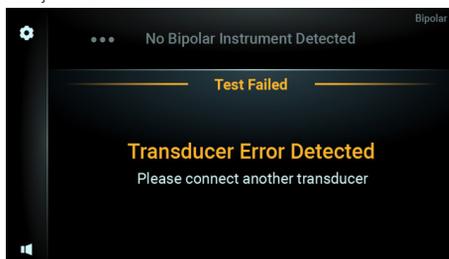


Pokud test Ultrazvukové nůžky selže, zobrazí se následující obrázek.

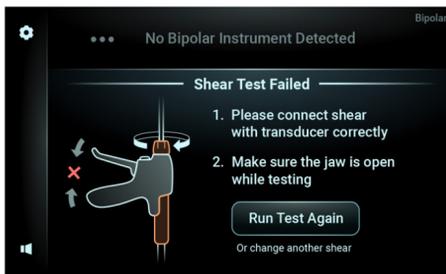

Pokud test Převodník a Ultrazvukové nůžky proběhne úspěšně, zobrazí se následující obrázek:

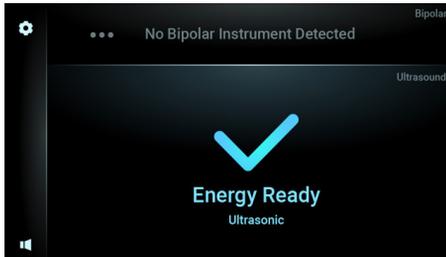

Při připojení Ultrazvukové nůžky bez funkce Advanced Hemostasis se zobrazí následující pracovní obrazovka.

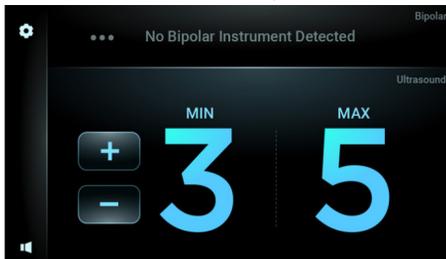


Při připojení SRE Ultrazvukové nůžky s Advanced Hemostasis se zobrazí následující pracovní obrazovka.




Režim výstupu bude zvýrazněn, když je aktivován.

Použití elektrochirurgického nástroje


Při detekci Převodník a Ultrazvukové nůžky se zobrazí následující obrázek.

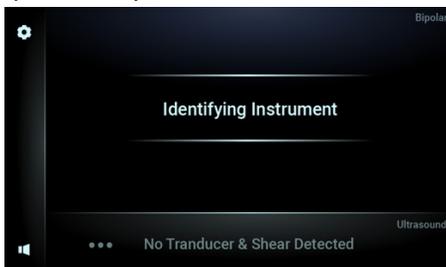


Pokud test elektrochirurgického nástroje proběhne úspěšně, zobrazí se následující obrázek:

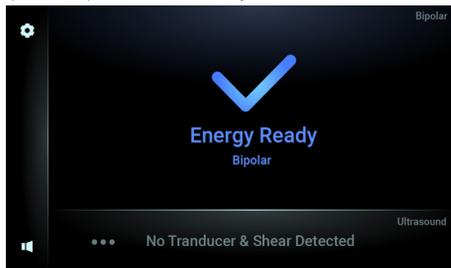

Při připojení k pokročilému bipolárnímu přístroji se zobrazí následující pracovní obrazovka.

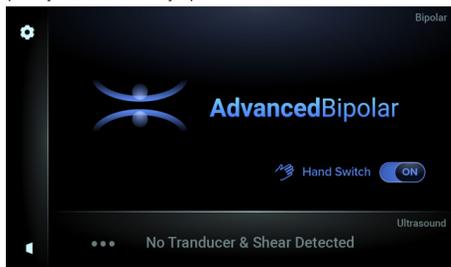


Při připojení k běžnému bipolárnímu přístroji se zobrazí následující pracovní obrazovka.

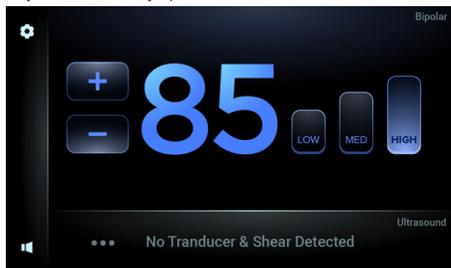


Použití elektrochirurgického nástroje a Ultrazvukové nůžky

Upozorňujeme, že pokud je přístroj Generátor připojen k bipolárnímu elektrochirurgickému přístroji i k přístroji Ultrazvukové nůžky, systém pracuje v režimu rozdělené obrazovky, na které se zobrazuje aktuální stav. Přístroj, který má prioritu, bude aktivovat energii jako první. Tento stav rozdělené obrazovky je znázorněn níže:

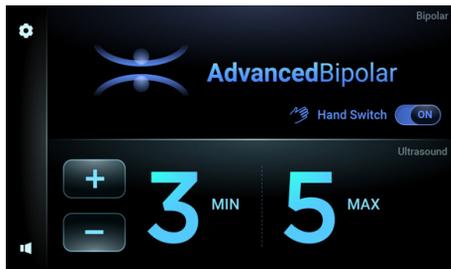

Nastavení systému


Chcete-li získat přístup k nastavení systému, klikněte na ikonu nastavení v levém horním rohu obrazovky. K dispozici jsou následující možnosti nastavení systému:

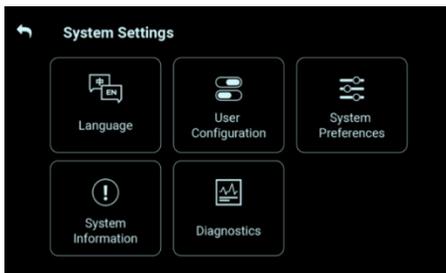


Jazyk: Kliknutím na položku Jazyk se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka:




Konfigurace uživatele: Kliknutím na položku Konfigurace uživatele se zobrazí obrazovka konfigurace uživatele:

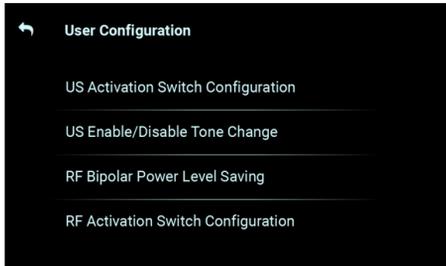


Předvolby systému: Kliknutím na položku Předvolby systému se zobrazí obrazovka s předvolbami systému:

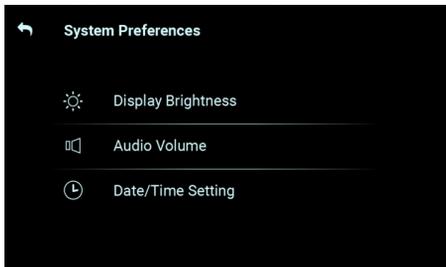

Informace o systému: Kliknutím na položku System Info zobrazíte obrazovku se systémovými informacemi:

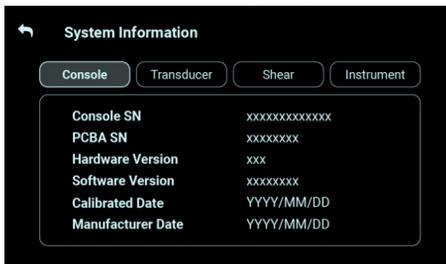

Diagnostika: Kliknutím na položku Diagnostika se zobrazí obrazovka diagnostiky:

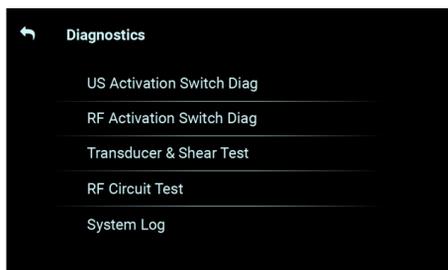

Chcete-li ukončit nastavení systému a vrátit se do pohotovostního režimu systému, stiskněte ikonu "Return" (Návrat) v levém horním rohu obrazovky.

Vypnutí systému

Pro bezpečné vypnutí systému postupujte podle následujících kroků:

Stiskněte pohotovostní tlačítko: Vyhledejte tlačítko pohotovostního režimu na přístroji Generátor a jeho stisknutím zahájíte proces vypnutí.

Odpojte Převodník a Ultrazvukové nůžky: Odpojte Převodník a Ultrazvukové nůžky opatrně od systému. Správné zacházení s přístroji Převodník a Ultrazvukové nůžky je uvedeno v návodu k obsluze.

Čištění: Čištění: Vyčistěte spínač Generátor, nožní spínač a spínač Převodník v souladu s postupy uvedenými v kapitole "Údržba".

Řešení problémů

Přístroj Generátor obsahuje různé výstražné signály a chybové kódy, které pomáhají při identifikaci a diagnostice závad součástí. Je důležité si uvědomit, že tyto signály a kódy jsou určeny spíše k podpoře klinického úsudku a pozorování, než aby je nahrazovaly.

Zvukové upozornění

Pracovní stav	Typ zvuku	Možná příčina a opatření
Samokontrola stavu	Normální zvuk	/
	Abnormální zvuk	Byla zjištěna hardwarová závada. Obratě se na výrobce a požádejte o pomoc při opravě.
Použití ultrazvukového přístroje	Maximální úroveň zvuku	/
	Minimální úroveň zvuku	/
	Abnormální zvuk	Přípravek Ultrazvukové nůžky se dostal do kontaktu s nadměrným množstvím tkáně. Snižte kontakt tkáně s přístrojem Ultrazvukové nůžky. Pokud nepřetržitý zvuk přetrvává, opatrně odstraňte veškerou tkáň, která se může hromadit kolem konce Ultrazvukové nůžky. Byla zjištěna závada na zařízení Převodník a/nebo Ultrazvukové nůžky. Obratě se na výrobce nebo na technickou podporu.
	Pokročilý zvuk	/
	Zvuk ITS	/
Aktivace elektrochirurgického nástroje	Pokročilý bipolární výstražný tón	/
	Normální bipolární zvuk	/
	Abnormální zvuk	Neúspěšné řezání: Pokud tkáň, s níž je nástroj v kontaktu, nespĺňuje požadavky na řezání, zmenšete množství tkáně, která je v kontaktu s nástrojem. Pokud chybný tón přetrvává, pečlivě odstraňte veškerou tkáň, která se může hromadit na konci nástroje. Selhání hardwaru: Tato chyba indikuje možnou poruchu v obvodu nebo konektoru. V případě jakékoli poruchy nebo chyby se doporučuje obrátit se na výrobce nebo požádat o podporu, aby vám poskytli příslušné pokyny a řešení.

Chybové kódy

Energy Platform Generátor je vybavena komplexním systémem identifikace poruch, který se skládá z výstrah a systémových chyb. Při zjištění poruchy vydá přístroj Generátor výstražný tón, zobrazí výstražný signál na ovládacím panelu a na displeji LCD zobrazí odpovídající kód poruchy. Při řešení problému postupujte podle níže uvedených kroků:

Tabulka chybových kódů

Kód chyby	Odpovídající zpráva o závadě
Varování	Propojte prosím správně Ultrazvukové nůžky s Převodník
Varování	Ujistěte se, že je při testování otevřeno Čelisti
Varování	Ultrazvukové nůžky zjištěná chyba
Varování	Zbývající čas Převodník je nula
Varování	Aktivujte prosím vždy pouze jedno tlačítko
Varování	Snižte sílu působící na zařízení Ultrazvukové nůžky
Varování	Tlačítko Ultrazvukové nůžky a nožní spínač nelze zavřít současně
Varování	Tlačítko se zaseklo, zkontrolujte a pokračujte
Varování	Upravte Čelisti nebo upněte méně tkáně
Varování	Výmnutí zařízení z tkání
Chyba systému	Chyba systému
Chyba systému	Vlastní kontrola selhala

Pokud se během testování na obrazovce objeví chyba, proveďte následující akce:



- Ujistěte se, že je kabel Převodník zcela zasunut ve správném směru.
- Zkontrolujte, zda je šňůra Ultrazvukové nůžky správně utažena nebo zda se kolem jejího konce nenahromadila tkáň. Upravte těsnost Ultrazvukové nůžky a opatrně odstraňte nahromaděnou tkáň kolem pouzdra Ultrazvukové nůžky. (Pokud je test zahájen před zahájením operace, ujistěte se, že Ultrazvukové nůžky směřují do vzduchu. Pokud se používá Ultrazvukové nůžky, ujistěte se, že je upínací celist otevřená a není v kontaktu s žádnými předměty).
- Pokud problém přetrvává, zvažte výměnu jednotky Převodník nebo Ultrazvukové nůžky.
- Přejděte do pracovního režimu zařízení.

POZNÁMKA: Pokud teplota Převodník překročí stanovenou mez, nemusí správně fungovat. V takových případech použijte k obnově okamžitě jiný přístroj Převodník nebo podle níže uvedených kroků zjistěte příčinu chyby a prozkoumejte volitelné metody obnovení:

- Nechte Převodník vychladnout při pokojové teplotě minimálně 45 minut. Tento způsob chlazení platí i v případě, že se přístroj Převodník zahřeje po delším provozu při vysokém výkonu.
- Pokud se přehřátí Převodník neprojevuje a problém není vyřešen, obraťte se na zástupce výrobce pro údržbu.
- Kromě pojistek nejsou v přístroji Generátor žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. V případě potřeby výměny nebo servisu se obraťte na servisní pracovníky vyškolené a autorizované společností Reach Surgical, Inc. nebo na svého místního zástupce.

Údržbu a modernizaci zařízení Generátor by měl provádět výhradně servisní personál vyškolený a autorizovaný společností Reach Surgical.

Je třeba zvážit opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se předešlo potenciálním hrozbám. Rizika kybernetické bezpečnosti představují následující incidenty:

- Neoprávněný přístup k jakýmkoli nesouvisejícím produktům pro zařízení.
- Jakákoli neoprávněná síťová komunikace se zařízením.
- Firmware nebo aktualizace softwaru, které nebyly autorizovány společností Reach Surgical.

V případě některého z výše uvedených incidentů se obraťte na obchodního zástupce společnosti Reach Surgical, Inc. nebo přímo na společnost Reach Surgical, Inc. na adrese Reachquality@reachsurgical.com.

Údržba

Čištění a dezinfekce konektoru Generátor a základního bipolárního energetického konektoru

Čištění

Vyčistíte obrazovku Generátor LCD a základní bipolární konektor v souladu s nemocničními postupy a předpisy. Před čištěním se ujistěte, že je odpojeno hlavní napájení přístroje Generátor a že je z výstupní jednotky vytažen napájecí kabel.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození přístroje Generátor, úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru, je třeba postupovat při čištění opatrně. Na přístroj Generátor ani do něj nestříkejte kapaliny, ani jej neponožte do kapaliny. Při čištění postupujte podle následujících pokynů:

- Připravte mycí prostředek s neutrálním pH nebo enzymatický mycí prostředek s neutrálním pH podle údajů výrobce mycího prostředku.
- Čistým měkkým hadříkem namočeným v malém množství čistícího roztoku ručně otřete všechny povrchy včetně obrazovky Generátor.
- Otřete všechny povrchy čistým měkkým hadříkem namočeným v teplé vodovodní vodě.
- Nakonec otřete všechny povrchy čistým měkkým hadříkem, aby byly suché.

Dezinfekce

- Pokud dojde ke kontaminaci přístroje Generátor krví nebo tělesnými tekutinami, je třeba jej před opětovným použitím dezinfikovat. Pro použití na přístroj Generátor byly schváleny následující chemické dezinfekční prostředky: 70% izopropylalkohol, 6% chloran sodný, 10% peroxid vodíku.
- Dodržujte doporučení výrobce pro správné použití, koncentraci a dobu kontaktu dezinfekčních prostředků.
- Zajistěte, aby byly dezinfekční přístroje nastaveny a používány v souladu s pokyny výrobce.

Čištění nožního spínače

Po každém použití vyčistěte nožní spínač a kabel následujícím postupem:

- Odpojte nožní spínač od přístroje Generátor.
- Připravte enzymatický čistící prostředek s neutrálním pH podle pokynů výrobce.
- Pevně spojte kabel s nožním spínačem a ponořte je na 2 minuty do čistícího roztoku.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že kabel nožního spínače použité k připojení zařízení Generátor je zcela suchý, aby nedošlo k jeho náhodné aktivaci.

- Po ponoření ručně vydrhněte nožní spínač a kabel kartáčkem s měkkými štětinami v čistícím roztoku.
- Důkladně oplachujte nožní spínač a kabel teplou vodou z vodovodu po dobu alespoň 1 minuty.

UPOZORNĚNÍ: Během oplachování udržujte kabel a nožní spínač bezpečně připojené.

- Otřete všechny povrchy čistým měkkým hadříkem.

VAROVÁNÍ: K čištění nožního spínače nepoužívejte ultrazvukové čistící zařízení.

VAROVÁNÍ: Nezapínejte napájení přístroje Generátor před připojením síťového kabelu. Před montáží se ujistěte, že jsou všechny spoje suché.

Čištění a dezinfekce zařízení Převodník

Přístroje Převodník se dodávají sterilními a před každým použitím je třeba je důkladně vyčistit a sterilizovat.

Čištění:

Důkladně vyčistěte převodníky podle následujících kroků:

- Rvložte snímač šroubovou stranou nahoru a očistěte jej měkkým štětinovým kartáčkem s čistěnou vodou, dokud na povrchu nezůstane šmouhy;
- Převodník může být namočen v pH neutrálním enzymatickém detergentu (Hlavní složky: proteáza lipáza amyláza celulóza pektináza a další biologické enzymy, povrchově aktivní látka šetrná k životnímu prostředí, faktor proti rzi a stabilizátor) po dobu až 10 minut a při vhodné teplotě 15 °C – 65 °C. Poměr detergentu a čistěné vody je 1:400;
- Oplachujte snímač šroubovou stranou nahoru čistěnou vodou po dobu 2 minut;
- Vyčistěte spojovací šroub, povrch pro montáž skalpelu a konektor utěrkou s alkoholem.
- Namočte snímač do 75% lékařského alkoholu a 30krát jej podržte a protřepajte;

- Oplachujte snímač šroubovou stranou nahoru čistěnou vodou po dobu 2 minut.

Poznámka: Používání ultrazvukových čističů se pro snímač nedoporučuje.

Sušení:

Teplota sušení: 50–70°C, Doba sušení: 30 min.

Sterilizace převodníků:

Po výše uvedených krocích čištění a sušení je třeba snímač sterilizovat jednou z níže uvedených metod.

Parní sterilizace (121°C)

- Pláště by měly být instalovány před sterilizací. Snímače by měly být během sterilizace zabaleny. Vložte převodníky do vysokoteplotního parního sterilizačního hrnce pro sterilizaci při teplotě 121 °C a délce 30 minut.
- Teplota sušení: 50 ~ 70 °C, doba sušení: 30 min.

Parní sterilizace (134°C)

- Pláště by měly být instalovány před sterilizací. Snímače by měly být během sterilizace zabaleny. Vložte převodníky do vysokoteplotního parního sterilizačního hrnce pro sterilizaci při teplotě 134 °C a délce trvání 10 minut.
- Teplota sušení: 50 ~ 70 °C, doba sušení: 30 min.

Bezpečnostní a funkční testy

Zajistěte provedení bezpečnostních a funkčních testů zařízení Převodník, Generátor a nožního spínače v souladu s nemocničními postupy a předpisy. Bezpečnostní a funkční testy ostatních komponent používaných více pacienty naleznete v návodu k obsluze specifickém pro každou komponentu.

Bezpečnostní test

Generátor: Certifikovaní nemocniční technici by měli provést zkoušku unikajícího proudu.

Nožní spínač: Zkontrolujte pedál, konektor kabelu a kabel, zda nejsou prasklé nebo poškozené. Poškozené součásti vyměňte.

Další součásti: Zkontrolujte všechny ostatní součásti podle pokynů v jejich návodech k obsluze.

Funkční test

Ultrazvukový režim

- Připravte si kompletní sadu PD Ultrazvukové nůžky a připojte Převodník podle pokynů uvedených v kapitole II - Instalace a provoz zařízení.
- Ověřte, zda je možné přejít do pracovního stavu. Různá rozhraní Ultrazvukové nůžky mohou mít různá vstupní rozhraní. Podrobné pokyny naleznete v části 1, oddílu 3 kapitoly 2.
- Potvrďte zobrazení úrovně výkonu MIN 3 a úrovně výkonu MAX 5.
- Stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení výkonu zajistíte, aby bylo možné nastavit úroveň výkonu MIN od úrovně 1 do 5.
- Zapněte přístroj Generátor a přepněte jej do ultrazvukového pracovního režimu. Zkontrolujte správné zapojení přístrojů Převodník a Ultrazvukové nůžky.
- Při otevření čelisti stiskněte tlačítko "MAX" na nožním spínači. Na displeji LCD by se měla zobrazit úroveň výkonu MAX "5" a měl by zaznít aktivací tón.
- Při otevření čelisti stiskněte tlačítko "MIN" na nožním spínači. Na LCD displeji by se měla zobrazit úroveň výkonu MIN a měl by zaznít aktivací tón.

UPOZORNĚNÍ: Před aktivací systému se ujistěte, že čelist není v dosahu tkání, jiných nástrojů nebo jiných předmětů, aby nedošlo ke zranění uživatele.

Bipolární elektrochirurgický režim

- Připojte pokročilý bipolární elektrochirurgický nástroj/základní bipolární nástroj podle návodu.
- Zkontrolujte, zda systém může vstoupit do pracovního rozhraní. V základním bipolárním režimu by se měla zobrazit ikona 30 úrovně výkonu, zatímco v pokročilém bipolárním režimu by se měla zobrazit ikona "pokročilý bipolární".
- V základním bipolárním režimu se lehce dotkněte tlačítek pro zvýšení a snížení výkonu, abyste potvrdili, že úroveň výkonu lze nastavit v rozmezí 1 až 95. Dotykem tlačítek Low, Medium a High můžete přímo přepínat mezi hodnotami 15, 30 a 60.
- Vypněte zařízení Generátor a počkejte 5 sekund. Poté zapněte napájení přístroje Generátor a počkejte 10 sekund. Zkontrolujte, zda se v základním bipolárním režimu zobrazí rozhraní 30 úrovní výkonu a v pokročilém bipolárním režimu rozhraní "advanced bipolar". Zkontrolujte, zda je přístroj Generátor aktivován podle předem stanovených požadavků.
- Připojte pokročilý a základní bipolární modul Elektrochirurgické nástroje a stiskněte jednoduchý nožní spínač. Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu neblíká indikace úrovně výkonu, a poslechněte si aktivací zvuk.

VAROVÁNÍ: Před aktivací systému je přísně zakázáno umožnit jakýkoli kontakt přístroje Ultrazvukové nůžky s tkáněmi, jinými přístroji nebo jakýmkoli jinými předměty, aby nedošlo ke zranění uživatele.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Související se systémem

- Před použitím si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny nemocnice pro klinickou praxi pro ultrazvukovou chirurgii, elektrochirurgii, gynekologii a laparoskopii.
- Minimálně invazivní zařízení se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Pokud se při operaci současně používají minimálně invazivní nástroje a příslušenství od různých výrobců, zkontrolujte před operací kompatibilitu nástrojů a příslušenství a ověřte, zda příslušenství zavážené do lidského těla nemá drsný povrch, ostré hrany nebo výstupky, které by mohly způsobit bezpečnostní rizika.
- Tento přístroj je určen pouze pro vyškolené a licencované chirurgy. Nepoužívejte elektrochirurgické přístroje, pokud jste nebyli řádně vyškoleni v jejich použití pro konkrétní zákrok, který budete muset provést. Neproškolené použití tohoto přístroje může způsobit neúmyslné vážné poranění pacienta, včetně perforace střeva a odumření tkáně v bezvědomí a nenapravitelného poškození.
- Křyt Generátor neotevírejte bez povolení, abyste předešli možnému nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a modernizace přístroje musí provádět servisní pracovník vyškolený a autorizovaný společností Reach Surgical, Inc. Nepoužívejte tento přístroj k jiným účelům než k lékařským zákrokům.
- Důkladné pochopení principů a technik laserových, elektrochirurgických a poškození tohoto postupu je nezbytné, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálením pacienta i zdravotnického personálu a použití tohoto přístroje nebo jiných zdravotnických prostředků. Nesmí být porušena elektrická izolace nebo uzemnění. Elektrochirurgické přístroje neponožujte do tekutin, pokud to nevyžaduje jejich konstrukce a na označení není uvedeno, že by měly být ponořeny.
- Bezpečná a účinná ultrazvuková chirurgie a elektrochirurgie závisí nejen na konstrukci zařízení, ale také do značné míry na mnoha faktorech, které kontroluje operátor. Pro zvýšení bezpečnosti a účinnosti si přečtěte, pochopte a dodržujte návod k použití dodaný se zařízením.
- Stejně jako u všech zdrojů energie (elektrochirurgických, laserových nebo ultrazvukových) je třeba vzít v úvahu karcinogenitu a infekční rizika, která mohou představovat mnohé vedlejší tkáňové produkty, jako je kouř a aerosoly. Při otevřeních i endoskopických zákrocích je třeba dodržovat vhodná bezpečnostní opatření, jako jsou ochranné brýle, filtrační masky a účinné vybavení pro odvod kouře.
- Po vyjmutí zařízení zkontrolujte, zda je tkáň hemostázou. Pokud hemostáza chybí, je třeba použít vhodné metody k dosažení hemostázy.
- Výrobky vyráběné nebo distribuované společnostmi, které nejsou autorizovány společností Reach Surgical, Inc., nemusí být se zařízením kompatibilní. Použití takových výrobků může vést k neočekávaným výsledkům a může poškodit uživatele nebo pacienta.
- Aby se snížilo riziko rosení, musí být přístroj a plášť připojeny k nezávislému napájecímu obvodu.
- Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem nebo s kyslíkem či oxidem dusným. Možnost vzniku jisker v důsledku kolize s jinými kovovými zařízeními. Jiskry mohou zapálit hořlavé plyny, například polní plyny.
- Musí pracovat v požadovaném rozsahu okolní provozní teploty.

- Výstupní napětí zásuvky musí splňovat požadavky normy Generátor (kapitola "Technické podmínky systému"). Pokud není napájecí zdroj správně připojen, může dojít k poškození přístroje Generátor a k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Nezapínejte aktivní tón na neslyšitelnou úroveň. Aktivní tón může personál chirurgického týmu zaznamenat, když přístroj Generátor dodává energii.
- Bylo prokázáno, že kouř vznikající při elektrochirurgických zákrocích může být potenciálně škodlivý pro pacienty nebo personál chirurgického týmu. Navrhnete odpovídající ventilaci pomocí chirurgického odsávače kouře nebo jiných prostředků.
- Některé součásti ultrazvukové chirurgické integrované jednotky Generátor jsou dodávány nesterilní (např. Převodník). Před zahájením instalace systému výrobek podle potřeby sterilizujte. Pokyny k čištění a sterilizaci naleznete v každém příslušném návodu.
- Aby nedošlo ke zranění uživatele nebo pacientů, musí se přístroj Ultrazvukové nůžky před stisknutím testovacího tlačítka a během kontroly systému vyhnout jiným přístrojům, operačním roškám, pacientům nebo jiným předmětům. Při kontrole systému a zkušební metodě musí být provedena bezpečnostní opatření v případě aerosolu (podle nemocničních předpisů).
- Nevyvíjejte na čelist příliš velký tlak, abyste nezabránili přenosu ultrazvukové energie.
- Aby nedošlo ke zranění uživatele, musí se čepel před aktivací systému vyhnout kontaktu s tkání, jinými zařízeními nebo jinými předměty.
- Pokud dojde k rozstříknutí nebo nalití kapaliny na přístroj Generátor nebo do něj, případně k rozliti nebo nalití kapaliny na přístroj Generátor, může dojít k poškození přístroje Generátor a nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zdrojem vznícení může být jiskření a zahřívání spojené s technikou uzavírání nádob. Gáza a houba by měly zůstat vlhké. Elektrochirurgické elektrody uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů a prostředí bohatého na kyslík (O2).
- Pokud dojde k výraznému poškození přístroje Převodník nebo pokud některé díly vykazují známky poškození po čištění a dezinfekční údržbě, zlikvidujte je. Poškozené díly jsou před další manipulací zřetelně označeny, aby se zabránilo jejich nesprávnému použití.
- Jednorázový odpad a elektronický odpad musí být likvidován v souladu s nemocničními předpisy a nesmí být odhazován libovolně, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí.
- Nepoužívejte přístroj Generátor v blízkosti jiných zařízení nebo položený na nich. Pokud je použití vedle sebe nebo na sobě nezbytné, sledujte Generátor a ostatní zařízení, abyste zajistili jejich správnou funkci.
- Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohla obsluha opravovat. Pro servis se obraťte na svého obchodního zástupce nebo servisní pracovníky společnosti Reach Surgical.
- Před použitím zkontrolujte všechna zařízení připojená k systému a připojení. Ověřte, zda zařízení funguje, jak má. Nesprávné připojení může vést k obloku, jiskření, poruše zřídlení nebo k nechtěným výsledkům operace.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení připojeno pouze k napájení s ochrannými uzemněním.
- Udržujte co největší vzdálenost mezi přístrojem Generátor a jinými elektronickými zařízeními (např. monitory). Nekřičte ani nepřivazujte elektrické vodiče k elektronickým zařízením. Přístroj Generátor může způsobit rušení jiných elektronických zařízení.
- Systém by měl být používán s opatrností v případě přítomnosti vnitřních a vnějších kardiostimulátorů. Rušení způsobené použitím systému Elektrochirurgické nástroje může způsobit, že kardiostimulátor přejde do asynchronního stavu nebo zcela znefunkční jeho funkci. Pokud jsou elektrochirurgická zařízení nebo zařízení pro utěsnění tkání určena k použití u pacientů s kardiostimulátory, obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo na kardiologické oddělení nemocnice, kde získáte další informace.
- Při stohování přístrojů na sebe nebo při umísťování přístroje Generátor na elektrické přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Jedná se o nestabilní konfiguraci, která nezajišťuje dostatečné chlazení.
- V případě selhání přístroje Generátor může dojít k přerušení operace. Musí být k dispozici záložní systém.
- Pokud to vyžadují místní předpisy, měl by být přístroj Generátor připojen k ekvipotenciálnímu konektoru nemocnice pomocí ekvipotenciálního kabelu.
- Pokud se systém a fyziologické monitorovací zařízení používají současně u téhož pacienta, musí být každá monitorovací elektroda umístěna co nejdále od přístroje.
- V základním bipolárním režimu zvolte nejnižší možný výstupní výkon pro požadovaný efekt.
- Porucha vysokofrekvenčního chirurgického zařízení může způsobit neočekávané zvýšení výstupního výkonu.
- Do konektoru Generátor a základního bipolárního elektrochirurgického konektoru může vniknout voda nebo pevné částice. Při používání a čištění je nutné zabránit vniknutí vody nebo pevných částic.
- Při použití systému v kombinaci s endoskopem může dojít ke zvýšení unikajícího proudu na těle pacienta. Během zákroku dávejte pozor.
- Upozornění pro uživatele a/nebo pacienta, že každý závažný incident, který se vyskytl v souvislosti s přístrojem, by měl být nahlášen společnosti Reach Surgical, Inc. prostřednictvím Reachquality@reachsurgical.com, a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

Související nástroje

Během chirurgických zákroků je třeba si uvědomit, že při delším působení ultrazvuku nebo bipolárního elektrokauteru na tkáň může dojít ke zvýšení teploty koncové části nástroje Ultrazvukové nůžky, Ultrazvukové nůžky a Dříku. Pro zajištění bezpečnosti je nezbytné zabránit jakémukoli náhodnému kontaktu těchto součástí nástroje s tkání, chirurgickými roškami, chirurgickými plášti nebo jakýmkoli nesouvisejícími oblastmi v průběhu zákroku. Kromě toho je nutné dbát zvýšené opatrnosti při polohování bipolárního přístroje. Konkrétně by neměl být umístěn v blízkosti hořlavých materiálů, jako je gáza nebo chirurgické roušky, nebo v kontaktu s nimi. Bipolární nástroje používané v této souvislosti mohou při používání vytvářet teplo, které by mohlo potenciálně vést k nebezpečí požáru. Pokud se bipolární elektrochirurgický přístroj Generátor nepoužívá, měl by být řádně uložen v ochranném pouzdře nebo uchovávan v bezpečné vzdálenosti od pacienta, členů chirurgického týmu a jakýchkoli hořlavých materiálů.

POZNÁMKA: Další upozornění a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném návodu k použití.

Informace o EMC

Výrobek prošel testem elektromagnetické kompatibility, který splňuje požadavky normy IEC60601-1-2 na omezení pro zdravotnické přístroje. Tato omezení poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v běžných zdravotnických instalacích.

Složení výrobku

Sériové číslo	Název dílu	Číslo modelu/verze	Poznámky
1	Elektrochirurgický nástroj	OP9	/
2	Převodník ultrazvukového chirurgického generátoru	TRA6	Kompatibilní použití
3	Ultrazvukové nůžky Systém pro jednorázové použití Ultrazvukové nůžky	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatibilní použití
4	Jednorázová ultrazvuková vysokofrekvenční chirurgická jednotka Tkáňový tmel	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrazvukový nožní spínač	OP-FSD	/
6	Elektrochirurgický nožní spínač	OP-FSS	/
7	Elektrochirurgický bipolární konektor	OP-BPC	/

Kabel výrobku

Sériové číslo	Název kabelu	Délka (m)	Stínění
1	Kabel nožního ovládání	3	Ano
2	Napájecí kabel	5	Ne
3	Bipolární elektrochirurgický kabel	3	Ne
4	Kabel Převodník	2,9	Ano

Výkonnost EMC

Toto zařízení může být vystaveno vysokofrekvenčnímu rušení způsobenému jinými zdravotnickými zařízeními a rádiovou komunikací. Aby se takovému rušení zabránilo, byl tento výrobek testován podle normy IEC 60601-1-2 a splňuje její požadavky. Společnost Reach Surgical, Inc. však nezaručuje, že v jednotlivých prostředích instalace nebude docházet k absolutně žádnému rušení.

Pokud se zjistí, že je zařízení rušeno (což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), měl by se uživatel (nebo pracovníci údržby schválené společností Reach Surgical, Inc.) pokusit provést jedno nebo více z následujících opatření k vyřešení problému s rušením:

Upravte směr nebo polohu zařízení, které jí ovlivňuje.

Zvětšete vzdálenost mezi tímto zařízením a odesílajícím zařízením.

K napájení tohoto zařízení používejte jiné zdroje energie (než zdroje používané k ovlivnění zařízení).

Další návrhy konzultujte s dodavatelem nebo servisním zástupcem.

Výrobce neodpovídá za rušení způsobené následujícími situacemi: použitím jiných než doporučených propojovacích kabelů; změnou nebo úpravou tohoto zařízení bez povolení. Nepovolené změny nebo úpravy mohou způsobit ztrátu účinnosti zařízení.

Všechny typy elektronických zařízení mohou způsobovat elektromagnetické rušení jiných zařízení prostřednictvím vzduchu nebo jiných kabelů, které jsou k nim připojeny. V blízkosti tohoto zařízení nepoužívejte zařízení, která mohou vyzařovat rádiové signály, jako jsou mobilní telefony, rádiové vysíláče nebo výrobky pro rádiové ovládání, protože to může způsobit, že výkon tohoto zařízení nebude splňovat stanovené specifikace. Pokud se taková zařízení nacházejí v blízkosti tohoto zařízení, vypněte jejich napájení. Zdravotnický personál odpovědný za toto zařízení by měl poučit techniky, pacienty a další personál, který se může nacházet v blízkosti tohoto zařízení, aby plně dodržovali výše uvedené požadavky.

Aby bylo plně dosaženo specifikovaného výkonu EMC, měl by uživatel výrobek správně nainstalovat podle kroků popsanych v příručce. Pokud se vyskytnou problémy související s EMC, obraťte se na pracovníky údržby schválené společností Reach Surgical, Inc.

Modely Převodník (s kabelem) a Ultrazvukové nůžky jsou definovány jako použitá část celého systému.

Bezpečnostní opatření pro instalaci výrobku

Zařízení lze používat v nemocničním prostředí, ale nezahrnuje radiofrekvenční stínění místností kolem aktivních radiofrekvenčních chirurgických zařízení nebo míst, kde je umístěno zařízení pro nárazovou magnetickou rezonanci, protože intenzita elektromagnetického rušení je v těchto místech vysoká.

Oddělovací vzdálenost a vliv pevných radiokomunikačních zařízení: intenzitu magnetického pole generovaného pevnými vysíláči, jako jsou základnové stanice bezdrátových (mobilních/bezdrátových) telefonů, pozemní mobilní radiopřijímače, radioamatérské přijímače, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM, televizní vysílání Generators atd., nelze přesně teoreticky změřit. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vytvářeného pevnými RF vysíláči je třeba zvážit měření elektromagnetického pole. Pokud naměřená hodnota intenzity magnetického pole v místě zařízení překročí příslušnou úroveň rádiového kmitočtu uvedenou v "Prohlášení proti rušení", mělo by být zařízení zkontrolováno, aby se zajistilo, že může normálně fungovat. Pokud jsou zjištěny abnormální provozní podmínky, měla by se zvážit další měření, například změna orientace nebo přemístění zařízení nebo použití protiradiofrekvenční místnosti.

1) Používejte napájecí kabel dodaný nebo určený společností Reach Surgical, Inc. Výrobky vybavené napájecí zástrčkou by měly být zapojeny do pevné elektrické zásuvky s ochranným uzemněním. K připojení napájecí zástrčky nepoužívejte žádný typ adaptéru nebo konektoru.

2) Udržujte toto zařízení co nejdále od ostatních elektronických zařízení.

3) Připojte zařízení podle následujících kroků.

Obecné poznámky

(1) Specifikace kabelu.

Použití kabelů dodaných společností Reach Surgical, Inc. nepoškodí EMC vlastnosti tohoto výrobku. Při použití nespécifikovaných kabelů může dojít k výraznému snížení výkonu EMC tohoto zařízení.

(2) Opatření proti neoprávněným úpravám

Uživatel nesmí tento výrobek upravovat, jinak může dojít ke snížení jeho EMC vlastností.

Úprava produktu zahrnuje následující změny:

a. Kabel (délka, materiál, zapojení atd.).

b. Instalace/rozložení zařízení.

c. Konfigurace zařízení/komponenty.

d. ochranné díly zařízení (otevírání/zavírání krytu a upevňovací díly krytu).

(3) Všechny ochranné kryty by měly být při provozu zařízení zavřeny.

Předpokládá se, že tento výrobek bude používán v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže, a kupující a uživatel tohoto výrobku by měl zajistit, aby byl v tomto elektromagnetickém prostředí používán.

Základní výkon

1. U pokročilého vysokofrekvenčního rádiového výkonu musí systém zajistit, aby odchylka jmenovitého výkonu nepřekročila 20 % standardní hodnoty.

2. U základního vysokofrekvenčního rádiového výkonu musí systém zajistit, aby odchylka jmenovitého výkonu nepřekročila 20 % standardní hodnoty.

Pokyny a prohlášení VÝROBCE - ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE		
Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže.		
Zákazník nebo uživatel systému zařízení by měl zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.		
Emisní test	Dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí - pokyny
RF emise CISPR 11	Skupina1	zařízení využívá RF energii pouze pro své vnitřní funkce. Proto jsou jeho VF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolních elektronických zařízení.
RF emise	Třída A	EMISNÍ charakteristiky tohoto zařízení jej předurčují k použití v průmyslových oblastech a nemocnicích.
Harmonický proud IEC 61000-3-2	Třída A	
Změny napětí / kolísání napětí / blikání IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném takto.

Zákazník nebo uživatel přístroje by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.

Test IMUNITY	IEC 60601 testovací úroveň	Úroveň dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí - pokyny
Elektrostatické výboj (ESD) IEC 61000-4-2	kontakt ± 8 kV ± 2,4,8, 15kV vzduch	kontakt ± 8 kV ± 2,4,8, 15kV vzduch	Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy pokryty syntetickým materiálem, Relativní vlhkost vzduchu by měla být nejméně 30 %.
Rychlý elektrický přechod/výboj IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Přepětí IEC 61000-4-5	± 1 kV od vedení(-a) k vedení(-a) ± 2 kV vedení (vedení) k zemi	± 1 kV vedení(a) k vedení(am) ± 2 kV vedení (s) k zemi	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Poklesy napětí, zkrat přerušeni na vstupních napájecích vedeních IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°. 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů Jednofázové: při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	0 % UT; 0,5 cyklu Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°. 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů Jednofázové: při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel ultrazukového chirurgického přístroje Zařízení vyžaduje nepřetržitý provoz během přerušeni dodávky elektrické energie, doporučuje se, aby ultrazukový chirurgický přístroj Zařízení musí být napájeno z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.
Frekvence napájení (50/60 Hz) Magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Výkonová frekvence magnetická pole by měla být na úrovni charakteristiky typického umístění v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném takto.
Zákazník nebo uživatel přístroje by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí.

IMUNITA test	Zkouška podle normy IEC 60601 úroveň	Dodržování předpisů úroveň	Elektromagnetické prostředí - pokyny
Vedené rádiové vlny IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz 3 V/m	3V	Přenosné a mobilní RF komunikace Zařízení by nemělo být používáno blízce k žádné části Zařízení , včetně kabelů, než je doporučená oddělovací vzdálenost vypočtená z rovnice pro frekvenci vysílače. Doporučená odstupová vzdálenost
Vyzářené rádiové vlny IEC 61000-4-3	80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM při 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz až } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz až } 2,7\text{GHz}$ <p>kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech (m). Intenzita pole z pevně instalovaných rádiových vysílačů, stanovená na základě elektromagnetického průzkumu místa.3 by měla být v každém frekvenčním rozsahu nižší než úroveň shody. V blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem může docházet k rušení:</p>  <p>ZÁVĚSNÝ PORT ME PŘÍSTROJŮ A ME SYSTÉMŮ se zkouší podle tabulky 9 IEC 60601-1-2 za použití zkušebních metod uvedených v IEC 61000-4-3.</p>

Doporučené odstupové vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a přístroji.

Chirurgický ultrazukový přístroj je zaměřen na použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém se kontrolují vyzařované RF rušivé vlny. Zákazník nebo uživatel zařízení může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízením podle následujícího doporučení, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače (w)	Odstupová vzdálenost podle frekvence vysílače /m		
	150 kHz až 80 MHz	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3,5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3,5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

POZNÁMKA: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

Technické podmínky


Komponenty potřebné pro provoz systému: Elektrochirurgický nástroj, Převodník, Ultrazukový nožní spínač, Elektrochirurgický nožní spínač, Ultrazukové nůžky nebo Elektrochirurgické koncovky, Elektrochirurgický bipolární konektor Bipolární nástroj.

Tuto součást naleznete v popisu produktu.

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem	Ultrazvuk:  Typ CF Aplikovaná část; bipolární elektrochirurgický  Defibrilaci odolný typ CF Aplikovaná část
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I
Generátor na šoklivé infuze	Běžné vybavení
Stupeň ochrany proti šoklivému vniknutí vody	Nožní spínač: IP68
Kategorie řízení	Třída IIb
Požadavky na parametry ultrazvukového režimu:	
Vstupní výkon	Napájecí napětí: 100-240 V Napájecí frekvence: 50Hz/60Hz Příkon: 400VA
Požadavky na parametry ultrazvukového režimu:	
Budicí frekvence	54 kHz - 57 kHz
Vibrační exkurze primární špičky	25 µm ~ 110 µm
Ultrazvukové nůžky hrot hlavní akustické výstupní plochy Výrobek:	1,53-2,75 mm2
Sekundární příčná vazba Akustická na hrotu Ultrazvukové nůžky Výstupní oblast:	19,32-35,88 mm2
Odvozený výstupní zvuk při hrotu Ultrazvukové nůžky při referenčním hrotu Primární amplituda Výkon	< 30W
Typ regulace frekvence systému	Nezávisle na zatížení se budicí frekvence automaticky plynule nastavuje.
Index rezervy výkonu	Nejméně 2,5
Požadavky na elektrochirurgické parametry:	
Pracovní frekvence	400kHz ± 5%
Maximální výstupní napětí	≤ 250V
Pokročilý bipolární režim Maximální výstupní proud	≤ 5.5A
Základní bipolární režim Maximální výstupní proud	≤ 2.2A
Maximální výstupní napětí od špičky ke špičce	≤ 500Vpk
Špičkový faktor	1.6 ± 0.4
Jmenovitý výkon	Vyspělá bipolární rádiová frekvence: 270 W Rádiová frekvence Základní bipolární: 95W
Jmenovité zatížení	Vyspělá bipolární rádiová frekvence: 30Ω Rádiová frekvence Základní bipolární: 200Ω
Podmínky provozního prostředí	
	Teplota: 10 °C až 30 °C Relativní vlhkost: ≤ 70 % Rozsah atmosférického tlaku: 800 hPa až 1060 hPa
Podmínky přepravy a skladování	
	Teplota: -30 °C až +55 °C (Generátor, nožní spínač, adaptér) Teplota: -10 °C až +55 °C (Ultrazvukové nůžky) Vlhkost: ≤ 80 % Rozsah atmosférického tlaku: 800 hPa až 1060 hPa
Datum výroby	Datum výroby lze zjistit podle sériového čísla na zadním panelu přístroje Generátor.
Napájecí kabel	Splnění požadavků na certifikaci CCC Aktuální hodnocení: 10A
Míra perzistence	Určuje se podle použitého násadce Převodník a Ultrazvukové nůžky. Informace o míře perzistence naleznete v příslušných materiálech Ultrazvukové nůžky a Převodník Návod k použití ruční hlavice nebo kapitola 7 - Upozornění a bezpečnostní opatření.
Pojistka	€5 * 20 T8AH250V
Hmotnost (bez obalu)	Generátor: jmenovitá hmotnost 8 kg
Celkový objem	OP9 Generátor: (délka * šířka * výška): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispozice	Některé vnitřní součásti Generátor, nožní spínač a kabel nožního spínače obsahují olovo. Podle místních Požadavky a předpisy pro likvidaci. Baterie likvidujte v souladu s příslušnými postupy likvidace odpadu.
Klasifikace AP/APG	Nejedná se o vybavení AP/APG.
Životnost:	Životnost: 7 let
Verze verze softwaru	V01.01

Bipolární výstupní průběh

Pokročilá bipolární křivka výkon-zatžení výstupu

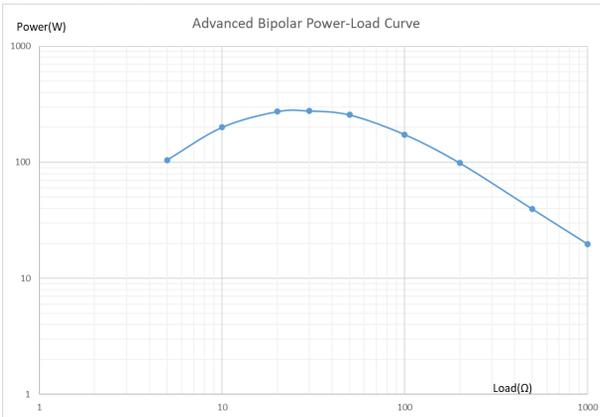


Omezení výkonové křivky Maximální výkon: 270[W]

Zatžení (Ω)	Spodní hranice	Jmenovitý	Horní hranice
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Jmenovitá výkonová křivka 270 wattů při jmenovitém zatžení v souladu s limitem proudu/napětí měříče výkonové křivky. Výkonová křivka představuje obálku, která se mění za provozních podmínek.


Základní křivka bipolárního výstupu při plném výkonu a zatžení

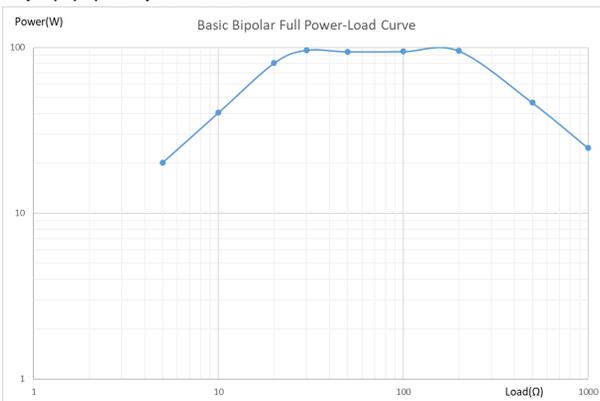

Limitní křivka plného výkonu [W]: Maximální výkon 95 W

Zatžení (Ω)	Spodní hranice	Jmenovitý	Horní hranice
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Základní křivka polovičního výkonu bipolárního výstupu a zatížení

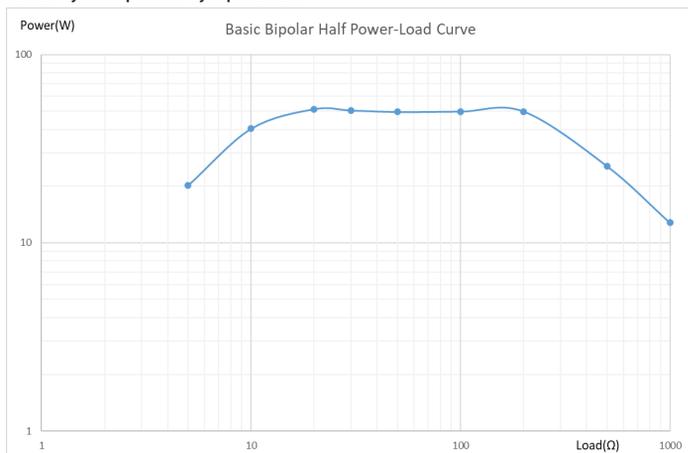

Mezní hodnota křivky polovičního výkonu [W]: Maximální výkon 50 W

Zatížení (Ω)	Spodní hranice	Jmenovitý	Horní hranice
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Výstupní výkon v závislosti na nastavení výkonu pro výkon v normálním bipolárním režimu

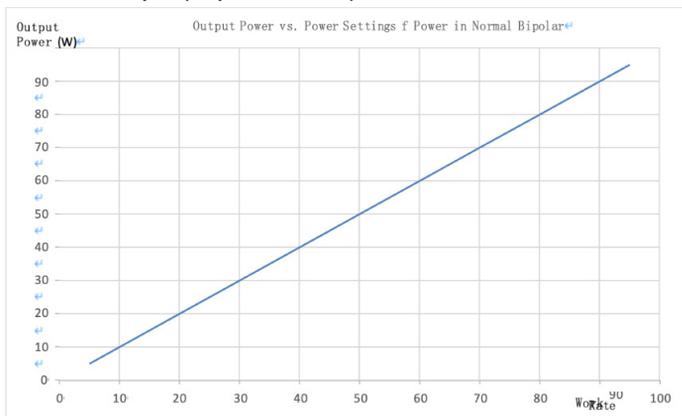

Výstupní výkon v závislosti na nastavené hodnotě výkonu pro normální bipolární [W]; zátěž: 200Ω

Nastavený výkon (W)	Dolní mez výstupního výkonu (W)	Jmenovitý výkon (W)	Horní hranice výstupního výkonu (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Servis a záruka

Společnost Reach Surgical, Inc. zaručuje, že tento výrobek nemá vady materiálu a zpracování při běžném používání a preventivní údržbě po níže uvedené záruční dobu. Povinnost společnosti Reach Surgical v rámci této záruky je omezena na opravu nebo výměnu, podle její volby, jakéhokoli vadného výrobku nebo dílu, který byl vrácen společnosti Reach Surgical, Inc. nebo jejímu autorizovanému distributorovi v rámci příslušné záruční doby a který byl shledán vadným ke spokojenosti společnosti Reach Surgical. Tato záruka se nevztahuje na výrobky nebo díly, které byly:

- Nepříznivě ovlivněno v důsledku použití s neautorizovanými zařízeními vyráběnými nebo distribuovanými stranami, které nejsou autorizovány společností Reach Surgical, Inc.
- Opravy nebo úpravy mimo výrobní závod společnosti Reach Surgical, pokud ovlivňují stabilitu nebo spolehlivost zařízení podle rozhodnutí společnosti Reach Surgical.
- Vlivem nesprávného používání, nedbalosti nebo nehody.
- Používá se způsobem, který neodpovídá konstrukci, parametrům použití, návodu a pokynům pro výrobek nebo průmyslově uznávaným funkčním, provozním nebo ekologickým normám pro podobné výrobky.

Záruční lhůty

Základní bipolární energetický konektor (OP-BPC): Na komponenty a práci je 1 rok.

Generátor (OP9): Na komponenty a práci je 1 rok.

Nožní spínač/napájecí kabel: 1 rok na komponenty a práci.

Tato záruka je výhradním opravným prostředkem pro původního kupujícího a nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Reach Surgical, Inc. nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné nebo následné škody, včetně škod vzniklých ztrátou používání, zisku, podnikání nebo dobré pověsti, s výjimkou případů výslovně stanovených platnými právními předpisy.

Společnost Reach Surgical, Inc. neopravňuje žádnou osobu k převzetí další odpovědnosti v souvislosti s prodejem nebo používáním svých výrobků. Neexistují žádné záruky, které by přesahovaly podmínky uvedené v tomto dokumentu.

Společnost Reach Surgical, Inc. si vyhrazuje právo provádět změny svých výrobků, aniž by byla povinna tyto změny zpětně aplikovat na dříve prodané nebo vyrobené výrobky.

Übersicht

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Sie enthalten wichtige Hinweise zum ordnungsgemäßen Betrieb, zu möglichen Risiken und zu möglichen Schäden am Produkt oder an Personen. Befolgen Sie im Falle einer ungewöhnlichen Situation die angegebenen Anweisungen, um sich selbst oder das Gerät vor Schäden zu bewahren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit, Leistung, Garantie oder Wartung führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Bitte lesen Sie auch die Anweisungen für den Transducer und die Ultraschallschere, bevor Sie das Gerät benutzen. Dieses Dokument soll Sie bei der Verwendung dieses Geräts unterstützen. Es ist keine Referenz für chirurgische Techniken.

Verwendete Standardkonventionen: ACHTUNG, WARNUNG und HINWEIS

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, die als VORSICHT, WARNUNG oder HINWEIS kategorisiert sind und wichtige Anleitungen für die sichere und gründliche Ausführung von Aufgaben enthalten. Diese Hinweise sind in der gesamten Dokumentation zu finden und sollten gelesen werden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt in einem Verfahren fortfahren.

WARNUNG: Dieser Hinweis weist auf ein Betriebs- oder Wartungsverfahren, eine Praxis oder eine Bedingung hin, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen kann.

ACHTUNG: Dieser Hinweis macht den Benutzer auf eine potenziell gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder Patienten sowie zu Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen führen kann. Er kann auch als Warnung vor unsicheren Praktiken dienen. Dazu gehören die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für die sichere und wirksame Verwendung des Geräts und die erforderliche Sorgfalt zur Vermeidung von Schäden, die sich aus der ordnungsgemäßen oder unsachgemäßen Verwendung ergeben.

HINWEIS: Diese Aussage bezieht sich auf eine betriebliche Praxis oder eine Bedingung, die für die effiziente Ausführung einer Aufgabe unerlässlich ist.

Beschreibung

Das elektrochirurgische Instrument ENER REACH (im Folgenden als "das Gerät" bezeichnet) wird in medizinischen Operationssälen für chirurgische Eingriffe zum Schneiden, Koagulieren von menschlichem Gewebe und Ligieren von Gefäßen verwendet. Es verfügt über zwei getrennte Steckplätze: einen für Ultraschallenergie und einen für die Ausgabe von Hochfrequenzwellenformen.

Im Hochfrequenzmodus liefert der Generator je nach angeschlossenem Instrument/Elektrochirurgiegerät unterschiedliche Energieschemata. Wenn ein fortschrittliches bipolares Instrument angeschlossen ist, liefert der Generator HF-Wellenformen zum Verschließen von arteriellen und venösen Gefäßen, Lymphgefäßen und Gewebebündeln mit einem Durchmesser von bis zu 7 mm. Wenn ein einfaches bipolares Instrument angeschlossen ist, wird Energie mit konstanter Leistung zum Schneiden und Koagulieren von Weichgewebe abgegeben.

Im Modus der Ultraschallenergieabgabe schneidet das Gerät unter Verwendung des TRA6 Transducers in Verbindung mit den Einweg-Ultraschallscheren CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD Weichgewebe, das eine Blutstillung und minimale thermische Schädigung erfordert, und versiegelt Gefäße bis zu einem maximalen Durchmesser von 5 mm. In Verbindung mit den Einweg-Ultraschallscheren SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 und SRE45 schneidet das Gerät weiches Gewebe, das eine Blutstillung und minimale thermische Schädigung erfordert, und versiegelt Gefäße bis zu einem maximalen Durchmesser von 7 mm.

Verwendungszweck

Das Gerät liefert Hochfrequenzstrom zum Antrieb elektrochirurgischer Handstücke, die zum Durchtrennen und Versiegeln von Gefäßen sowie zum Schneiden, Greifen und Sezieren von Gewebe verwendet werden sollen.

Darüber hinaus liefert der Generator Ultraschallenergie für den Antrieb von chirurgischen Ultraschallinstrumenten, die für Weichteilinzisionen geeignet sind, wenn Blutungskontrolle und minimale thermische Schädigung erwünscht sind.

Indikationen

Das Gerät liefert Hochfrequenzstrom zum Antrieb elektrochirurgischer Handstücke, die bei offenen Operationen oder laparoskopischen Eingriffen in der allgemeinen, pädiatrischen, gynäkologischen, urologischen und thorakalen Chirurgie zum Durchtrennen und Versiegeln von Gefäßen bis einschließlich 7 mm und zum Schneiden, Greifen und Sezieren von Gewebe verwendet werden.

Darüber hinaus liefert der Generator Energie für den Antrieb von chirurgischen Ultraschallinstrumenten, die für Weichteilschnitte geeignet sind, wenn Blutungskontrolle und minimale thermische Verletzung erwünscht sind. Die chirurgischen Ultraschallinstrumente können als Ergänzung oder Ersatz für Elektrochirurgie, Laser und Stahlskalpelle zum Schneiden und/oder Koagulieren von Gewebe bei offenen Operationen oder laparoskopischen Eingriffen in der Allgemeinchirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie, Urologie, Thoraxchirurgie sowie zum Abdichten und Durchtrennen von Lymphgefäßen verwendet werden.

Beabsichtigter Benutzer

Das Gerät ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal für chirurgische Anwendungen bestimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung Umgebung

Das Gerät ist für die Verwendung in einem Krankenhaus vorgesehen.

Vorgesehene Patientenpopulation

Dieses Gerät ist für Patienten ab 3 Jahren geeignet, bei denen chirurgische Eingriffe mit Weichteilschnitten mit Blutstillung und minimaler thermischer Verletzung erforderlich sind.


Klinischer Nutzen

Das Gerät kann sicher und effektiv zur Ligatur und Teilung von Gefäßen, Gewebebündeln und Lymphgefäßen eingesetzt werden.

Kontraindikationen

Dieses Gerät ist kontraindiziert für Knochenschnitte, kontrazeptive Eileiterverschlüsse und Koagulationsverfahren. Es ist auch nicht für die Verwendung in der Neurochirurgie vorgesehen.

System-Zusammensetzung

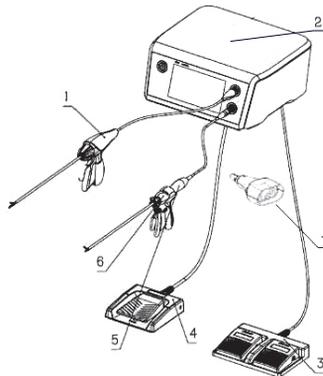

[01]Elektrochirurgisches Handstück	[02]OP9 Generator
[03]Ultraschall Fußschalter	[04]Elektrochirurgischer Fußschalter
[05]Transducer	[06]Ultraschallschere
[07]Bipolarer Anschluss für die Elektrochirurgie	

[01] Elektrochirurgisches Handstück

Das elektrochirurgische Handstück, das an einen Generator angeschlossen ist, wird während des Eingriffs vom Chirurgen bedient. Es wendet elektrochirurgische HF-Energie auf das Gewebe zwischen seinen Backen an, um es zu koagulieren oder zu versiegeln. Das Instrument enthält auch eine Klinge zur Gewebetrennung. Modell: OSA23, OSA37, OSA44. Detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

[02] OP9 Generator

Der Generator liefert sowohl elektrochirurgische Energie als auch Energie für die Ultraschalltherapie über separate Instrumentenanschlüsse. Er besteht aus einem Chassis, einem Gehäuse, einer elektronischen Platine, einem LCD-Touchscreen, einem Netzschalter und Schnittstellen für den Anschluss von Zubehör.

Modell: OP9

[03] Ultraschall Fußschalter

Dient zur Steuerung des Ein- und Ausschaltvorgangs der Ultraschallenergie mit zwei Schaltern ("MIN" und "MAX"). Modell: OP-FSD

[04] Elektrochirurgischer Fußschalter

Wird verwendet, um die Ausgabe von Hochfrequenzenergie mit einem einzigen Schalter ein- und auszuschalten.

Modell: OP-FSS

[05] Transducer

Der Transducer wandelt elektrische Energie von einem kompatiblen Generator in mechanische Bewegung für die Instrumentenblätter um. Es handelt sich um ein wiederverwendbares Instrument mit einer begrenzten Nutzungsdauer. Der Transducer ist nicht steril und muss vor dem Gebrauch gemäß den Anweisungen sterilisiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Anleitung zum TRA6 Transducer.

Modell: TRA6.

[06] Ultraschallschere

Die Ultraschallschere nutzt die mechanische Bewegung des Transducers und gibt Ultraschallenergie zum Schneiden oder Koagulieren von Gewebe ab. Seien Sie vorsichtig, denn die mechanische Vibration ist nicht nachweisbar und könnte unbeabsichtigt auch Bereiche betreffen, die nicht zur Zielgruppe gehören. Die Ultraschallschere wird mit Ethylenoxid sterilisiert. Wenn die Haltbarkeitsdauer überschritten oder die Sterilisationsverpackung beschädigt ist, darf die Ultraschallschere nicht mehr verwendet werden und muss entsorgt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Ultraschallschere.

Die folgenden Ultraschallscheren sind mit dem OP9 Generator kompatibel:

PD-Serie: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB-Serie: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE-Serie: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Bipolarer Anschluss für die Elektrochirurgie

Wird verwendet, um bipolare elektrochirurgische Instrumente an den Generator für die Gewebekoagulation anzuschließen.

Modell: OP-BPC

Frontplatte des Generators

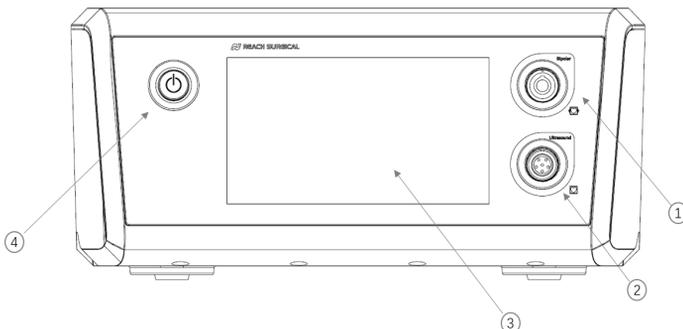

[01] Elektrochirurgische Steckdose

Dient zum Anschluss moderner bipolarer elektrochirurgischer Instrumente oder bipolarer elektrochirurgischer Anschlüsse.

[02] Transducer-Buchse

Verbindet den Transducer mit dem Generator.


[03] LCD-Touchscreen

Zeigt Systeminformationen an und dient als Schnittstelle für die Anpassung von Bedienelementen und Einstellungen.

[04] Netzschalter Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Generator einzuschalten; halten Sie sie gedrückt, um ihn auszuschalten.

Generator Rückwand

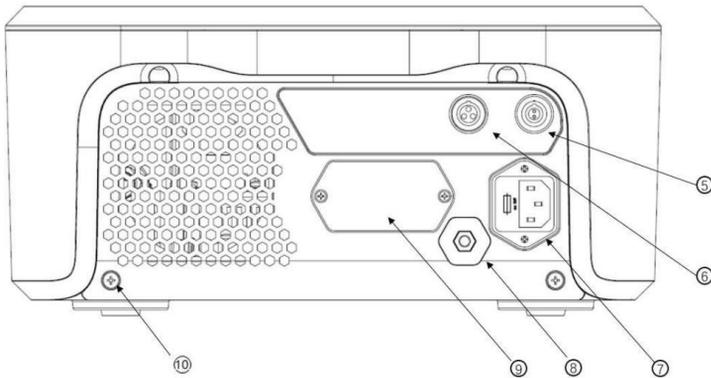

[05] Steckdose Elektrochirurgischer Fußschalter

Runder Sockel zum Anschluss des elektrochirurgischen Fußschalters.

[06] Steckdose für Fußschalter mit Ultraschall

Runde Buchse für den Anschluss des Ultraschall-Fußschalters.

[07] Steckdose

Verbindet das Netzkabel mit dem Generator.

[08] Potentialausgleichsanschluss

Wenn die Erdung der Steckdose unisoliert ist, ermöglicht dieser Anschluss eine Verbindung zur geschützten Erde.

[09] Erweiterungsschnittstelle

Dient zur Funktionserweiterung und Wartung.

[10] Montagebohrung

Gebrauchsanweisung

Beachten Sie die mitgelieferten Richtlinien für die Betriebsumgebung.

Auspacken

Bitte befolgen Sie nach Erhalt der Komponenten die unten stehenden Anweisungen.

- Prüfen Sie auf sichtbare Transportschäden. Wenn Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich bitte an Reach Surgical, Inc. oder an den örtlichen Vertreter, um Hilfe zu erhalten.

Komponenten, die im (Detaillierte technische Spezifikationen und Produktcodes finden Sie im Kapitel 'Technische Bedingungen des Systems'):

Modell	Beschreibung	Komponente
OP9	Generator	Generator, Netzkabel, Anleitung
TRA6	Transducer	Transducer mit Kabel
OP-FSD	Fußschalter mit Ultraschall	/
OP-FSS	Bipolarer Fußschalter	/
OP-BPC	Basic Bipolar Energy Anschluss	/

Sicherheitsvorkehrungen

- Halten Sie während der Inspektion des Geräts das distale Ende des Instruments von anderen Geräten, OP-Tüchern, dem Patienten oder anderen Gegenständen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Ergreifen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in Gegenwart von Dämpfen und befolgen Sie dabei die Verfahren und Vorschriften des Krankenhauses.

Ultraschallenergie mit Ultraschallschere der PD-Serie

- Schließen Sie den Transducer, den Fußschalter und die Ultraschallschere der PD-Serie an den Generator an.
- Nachdem Sie den Transducer- und Ultraschallschertest bestanden haben, stellen Sie die Leistungsstufe (1-5) mit den +/- Symbolen auf dem LCD-Bildschirm ein.
- Drücken Sie die Taste 'Min' an der Ultraschallschere oder das Min-Pedal am Fußschalter, um die Ultraschallenergie auf der voreingestellten Leistungsstufe zu aktivieren.
- Drücken Sie die 'Max'-Taste an der Ultraschallschere oder am Fußschalter, um die maximale Energiestufe zu erreichen.
- Lassen Sie die Taste oder den Fußschalter los, um die Energieausgabe zu stoppen.

Ultraschallenergie mit Ultraschallschere der SRB/SRE-Serie

- Nachdem Sie den Transducer- und Ultraschallschertest bestanden haben, stellen Sie die Leistungsstufe (1-5) mit den +/- Symbolen auf dem LCD-Bildschirm ein.

- Drücken Sie die Energietaste auf dem Gerät oder die Min-Taste auf dem Fußpedal, um die Ultraschallenergie mit der voreingestellten Leistungsstufe zu aktivieren.
- Drücken Sie die Energietaste mit erweiterter Hämostase auf dem Gerät, um den Modus Erweiterte Hämostase zu aktivieren.
- Lassen Sie die Taste an der Ultraschallschere oder die Taste am Fußschalter los, um die Energieabgabe zu stoppen.

Elektrochirurgische bipolare Energie mit fortschrittlichen bipolaren Instrumenten

- Das LCD-Display zeigt das Symbol für die erweiterte bipolare Steuerung und das Symbol für die einstellbare Handsteuerung an.
- Ziehen Sie den Hebel am Gerät oder drücken Sie das Fußschalterpedal, um die Funkfrequenz zu aktivieren.
- Der Generator stoppt die Energieabgabe, wenn die Schließung abgeschlossen ist, was durch das Symbol für die Schließung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Wenn die Ligation unvollständig ist, ertönt ein Warnton und ein Warnsymbol wird angezeigt.

Bipolare elektrochirurgische Energie mit bipolarem elektrochirurgischem Instrument

- Auf dem LCD-Bildschirm werden der Leistungswert, die einstellbaren Symbole und die Balken der Leistungsstufe angezeigt.
- Die Leistungseinstellungen reichen von 1-95 Watt, mit einstellbaren Abstufungen.
- Wählen Sie die gewünschte Leistungseinstellung: Niedrig (15 Watt), Mittel (30 Watt) oder Hoch (60 Watt).
- Drücken Sie die Taste am Handschalter oder Fußschalterpedal, um die Funkfrequenz zu aktivieren.
- Lassen Sie die Taste los, um die Energieabgabe zu deaktivieren.

Einstellung Empfehlungen

Effekt-Einstellungen	Leistungseinstellungen Bereich	Klinische Anwendung	Optimiertes Gerät
Niedrig	1-15 Watt	Zum Beispiel Nerven/Wirbelsäule, Hände und Gesichtschirurgie	- Geräte mit kleinerer Oberfläche - Mikrospitzenpinzette (0,4 - 2,2 mm)
Mitte	16-40 Watt	Wie z.B. Koagulation bei Kopf/Hals, Wirbelsäule und Anatomie	- Geräte mit mittlerer Oberfläche - Mikroskopische Pinzette (1,0 - 2,2 mm) - Kleine laparoskopische Pinzette mit flachem Kopf - Bipolare Schere
Hoch	45-95 Watt (in 5-Watt-Schritten)	Wie z.B. Kopf-/Hals- und plastische Chirurgie (ähnlich der mittleren Wirkung, aber mit schnellerer Wirkung)	- Geräte mit großer Oberfläche - Große laparoskopische Pinzette mit flachem Kopf

HINWEIS: Dieses Gerät ist nicht mit der Neutralelektrode kompatibel.

HINWEIS: Die Ultraschallschere und das RF-Elektro-Skalpell sind Teile, die mit dem Patienten in Kontakt kommen.


Verwendung des Generators

Schalten Sie das Gerät ein

- Das System ist betriebsbereit, sobald es eingeschaltet wurde. Wenn der Generator an das Stromnetz angeschlossen ist und die Leuchte des Standby-Schalters leuchtet, ist das System einsatzbereit.
- Nachdem Sie die Standby-Taste gedrückt haben, wird das folgende Bild angezeigt:




- Wenn kein Transducer oder keine Ultraschallschere an den Generator angeschlossen ist, oder wenn sie falsch angeschlossen sind, wird das folgende Bild angezeigt:




Verwendung von Ultraschallgeräten (Transducer und Ultraschallschere)


Wenn Transducer und Ultraschallschere erkannt werden, wird das folgende Bild angezeigt.

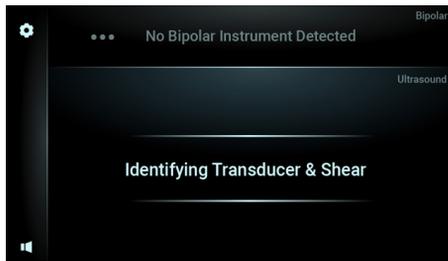


HINWEIS: Wenn die verbleibende Nutzungsdauer des Transducers weniger als 10 beträgt, wird das folgende Bild angezeigt. Achten Sie bitte auf die Anzahl der verbleibenden Verwendungen, da der Transducer ersetzt werden muss, wenn die Zahl Null erreicht ist.

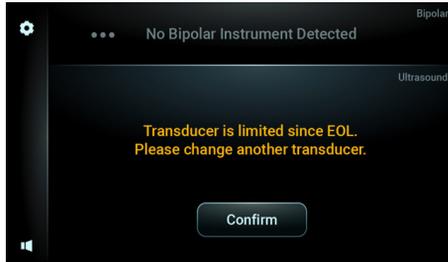


Als nächstes wird das folgende Bild angezeigt. Sie werden aufgefordert, eine beliebige Taste auf der Ultraschallschere zu drücken, um den Ultraschallschertest mit offenen Backen zu starten.

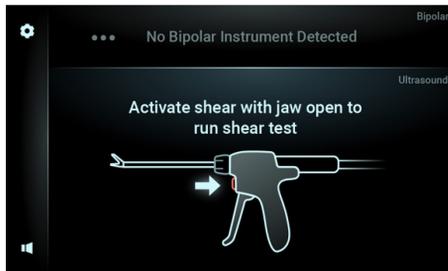

Drücken Sie eine beliebige Taste, und das folgende Bild wird angezeigt.




Wenn der Transducer-Test fehlschlägt, wird das folgende Bild angezeigt:

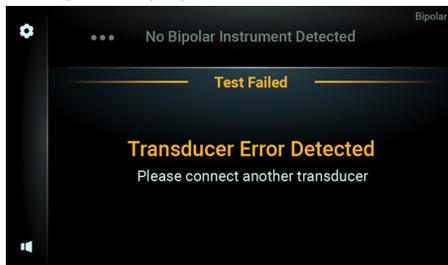

Wenn der Test der Ultraschallschere fehlschlägt, wird das folgende Bild angezeigt



Wenn der Transducer und die Ultraschallschere den Test bestanden haben, wird das folgende Bild angezeigt:

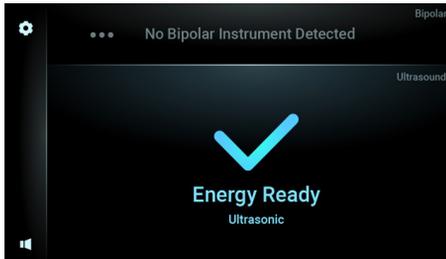

Der folgende Arbeitsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine Ultraschallschere ohne die Funktion Erweiterte Hämostase anschließen.




Der folgende Arbeitsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie die SRE Ultraschallschere mit Advanced Hemostasis verbinden.




Der Ausgabemodus wird hervorgehoben, wenn er aktiviert ist.

Verwendung elektrochirurgischer Instrumente


Wenn Transducer und Ultraschallschere erkannt werden, wird das folgende Bild angezeigt.

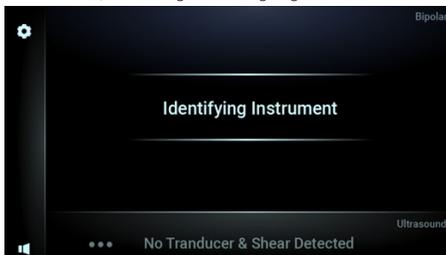


Wenn der Test der elektrochirurgischen Instrumente erfolgreich war, wird das folgende Bild angezeigt:

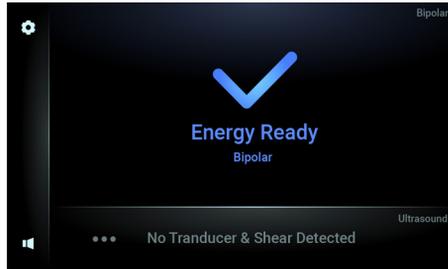

Der folgende Arbeitsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine Verbindung zu einem erweiterten bipolaren Gerät herstellen.



Der folgende Arbeitsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine Verbindung zu einem normalen bipolaren Gerät herstellen.

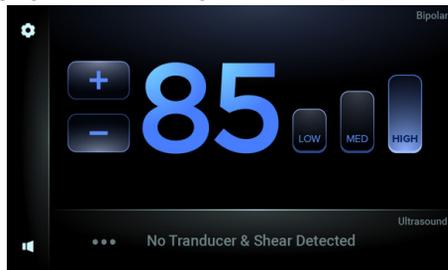


Verwendung von elektrochirurgischen Instrumenten und Ultraschallscheren

Bitte beachten Sie, dass das System, wenn der Generator sowohl an ein bipolares elektrochirurgisches Instrument als auch an eine Ultraschallschere angeschlossen ist, in einem Split-Screen-Modus arbeitet, um den aktuellen Status anzuzeigen. Das Gerät, das Vorrang hat, wird als erstes die Energie aktivieren. Dieser Status des geteilten Bildschirms ist unten dargestellt:



Systemeinstellungen


Um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Die folgenden Systemeinstellungsoptionen sind verfügbar:

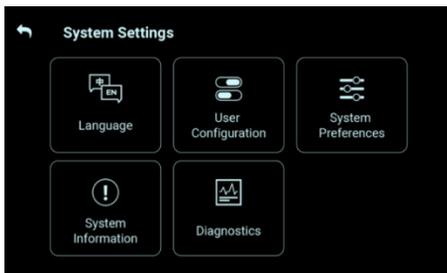


Sprache: Wenn Sie auf das Element Sprache klicken, wird der Bildschirm zur Sprachauswahl angezeigt:



Benutzerkonfiguration: Wenn Sie auf das Element Benutzerkonfiguration klicken, wird der Bildschirm Benutzerkonfiguration angezeigt:

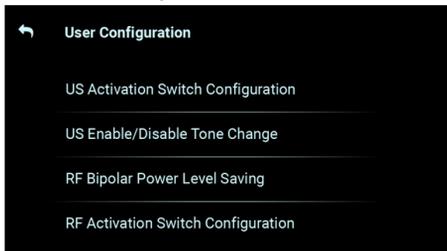

Systemeinstellungen: Wenn Sie auf den Punkt Systemeinstellungen klicken, wird der Bildschirm mit den Systemeinstellungen angezeigt:

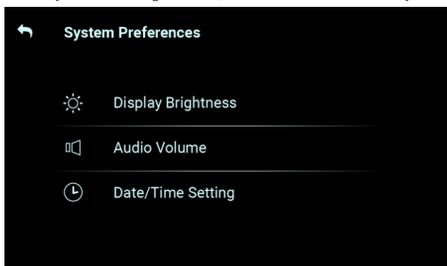

Systeminformationen: Klicken Sie vorsichtig auf das Element Systeminfo, um den Bildschirm mit den Systeminformationen anzuzeigen:



Diagnostik: Wenn Sie auf das Element Diagnostik klicken, wird der Diagnosebildschirm angezeigt:



Um die Systemeinstellungen zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie auf das Symbol "Zurück" in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Herunterfahren des Systems

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System sicher herunterzufahren:

Drücken Sie die Standby-Taste: Suchen Sie die Standby-Taste am Generator und drücken Sie sie, um den Abschaltvorgang einzuleiten.

Trennen Sie Transducer und Ultraschallschere ab: Trennen Sie den Transducer und die Ultraschallschere vorsichtig vom System. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den richtigen Umgang mit dem Transducer und der Ultraschallschere.

Reinigung: Reinigen Sie den Generator, den Fußschalter und den Transducer gemäß den in Kapitel 'Wartung' beschriebenen Verfahren.

Fehlersuche

Der Generator verfügt über verschiedene Alarmsignale und Fehlercodes, die bei der Identifizierung und Diagnose von Komponentenfehlern helfen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Signale und Codes die klinische Beurteilung und Beobachtung unterstützen, nicht aber ersetzen sollen.

Tonalarm

Arbeitsstatus	Sound Typ	Mögliche Ursache und Maßnahmen
Selbstkontrolle Status	Normaler Ton	/
	Abnormaler Ton	Es wurde ein Hardwarefehler festgestellt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um Hilfe bei der Reparatur zu erhalten.
Verwendung des Ultraschallgeräts	Max Level Ton	/
	Min Level Ton	/
	Abnormaler Ton	Die Ultraschallschere ist mit zu viel Gewebe in Berührung gekommen. Reduzieren Sie den Gewebekontakt mit der Ultraschallschere. Wenn das Geräusch weiterhin anhält, entfernen Sie vorsichtig das Gewebe, das sich um das Ende der Ultraschallschere angesammelt haben könnte. Es wurde ein Fehler beim Transducer und/oder der Ultraschallschere festgestellt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder kontaktieren Sie den Support für weitere Hilfe.
	ADVANCED Sound	/
	ITS-Sound	/
Aktivierendes elektochirurgisches Instrument	Erweiterter bipolarer Warnton	/
	Normaler bipolarer Ton	/
	Abnormaler Ton	Erfolgsloses Schneiden: Wenn das vom Instrument berührte Gewebe nicht den Schneideanforderungen entspricht, reduzieren Sie die Menge des Gewebes, das mit dem Instrument in Berührung kommt. Bleibt der Fehler bestehen, entfernen Sie vorsichtig jegliches Gewebe, das sich am Ende des Instruments angesammelt haben könnte. Hardware-Fehler: Dieser Fehler weist auf eine mögliche Störung im Schaltkreis oder im Anschluss hin. Im Falle einer Störung oder eines Fehlers wird empfohlen, den Hersteller zu konsultieren oder sich an den Support zu wenden, um eine angemessene Anleitung und Lösung zu erhalten.

Fehler-Codes

Der Energy Platform Generator ist mit einem umfassenden System zur Fehlererkennung ausgestattet, das aus Warnungen und Systemfehlern besteht. Wenn ein Fehler erkannt wird, gibt der Generator einen Warnton ab, zeigt ein Warnsignal auf dem Bedienfeld an und zeigt einen entsprechenden Fehlercode auf dem LCD-Bildschirm an. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um das Problem zu beheben:

Tabelle der Fehlercodes

Fehlercode	Entsprechende Fehlermeldung
Warnung	Bitte schließen Sie die Ultraschallschere korrekt an den Transducer an
Warnung	Stellen Sie sicher, dass die Backen während des Tests geöffnet sind
Warnung	Ultraschallschere Fehler entdeckt
Warnung	Die verbleibende Zeit des Transducers ist Null
Warnung	Bitte aktivieren Sie immer nur eine Taste auf einmal
Warnung	Bitte reduzieren Sie die auf die Ultraschallschere ausgeübte Kraft
Warnung	Ultraschallschere-Taste und Fußschalter können nicht gleichzeitig geschlossen werden
Warnung	Schaltfläche klemmt, bitte prüfen und fortfahren
Warnung	Backen anpassen oder weniger Gewebe einklemmen
Warnung	Entfernen Sie das Gerät aus den Tüchern
Systemfehler	Systemfehler
Systemfehler	Selbsttest fehlgeschlagen

Wenn während des Tests ein Fehler auf dem Bildschirm erscheint, führen Sie die folgenden Aktionen durch:



- Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Transducers vollständig und in der richtigen Richtung eingesteckt ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Ultraschallschere richtig angezeigt ist oder ob sich Gewebe um das Ende der Ultraschallschere angesammelt hat. Stellen Sie die Dichtigkeit der Ultraschallschere ein und entfernen Sie vorsichtig alle Gewebeansammlungen um das Gehäuse der Ultraschallschere. (Wenn der Test vor der Operation eingeleitet wird, vergewissern Sie sich, dass die Ultraschallschere auf die Luft gerichtet ist. Wenn Sie eine Ultraschallschere verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Klemmbacke offen ist und keine Gegenstände berührt.)
 - Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Transducer oder die Ultraschallschere austauschen.
 - Fahren Sie mit dem Arbeitsmodus des Geräts fort.
- HINWEIS:** Der Transducer funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn seine Temperatur den angegebenen Grenzwert überschreitet. Verwenden Sie in solchen Fällen sofort einen anderen Transducer zur Wiederherstellung oder befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln und optionale Wiederherstellungsmethoden zu untersuchen:
- Lassen Sie den Transducer mindestens 45 Minuten lang bei Raumtemperatur abkühlen. Diese Kühlmethode gilt auch, wenn der Transducer nach längerem Betrieb mit hoher Leistung heiß wird.
 - Wenn der Transducer nicht überhitzt ist und das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an die Wartungsabteilung des Herstellers.
 - Abgesehen von den Sicherungen gibt es im Generator keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Für jeglichen Austausch oder Servicebedarf wenden Sie sich bitte an von Reach Surgical, Inc. geschultes und autorisiertes Servicepersonal oder an Ihren örtlichen Vertreter.

Die Wartung und Aufrüstung des Generators sollte ausschließlich von durch Reach Surgical geschultem und autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Um potenziellen Bedrohungen vorzubeugen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen für die Cybersicherheit treffen. Die folgenden Vorfälle stellen ein Risiko für die Cybersicherheit dar:

- Unbefugter Zugriff auf nicht mit dem Gerät verbundene Produkte.
- Jede nicht autorisierte Netzwerkkommunikation mit dem Gerät.
- Firmware- oder Software-Updates, die nicht von Reach Surgical autorisiert wurden.

Im Falle eines der oben genannten Vorfälle wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter von Reach Surgical, Inc. oder direkt an Reach Surgical, Inc. unter Reachquality@reachsurgical.com.

Wartung

Reinigung und Desinfektion des Generators und des Basic Bipolar Energy Anschlusses

Reinigung

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm des Generators und den bipolaren Anschluss gemäß den Verfahren und Vorschriften des Krankenhauses. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Hauptstromversorgung des Generators unterbrochen und das Netzkabel von der Ausgabereinheit entfernt ist.

WARNUNG: Die Reinigungsverfahren müssen sorgfältig befolgt werden, um eine Beschädigung des Generators, einen elektrischen Schlag oder eine Brandgefahr zu vermeiden. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Generator, und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten.

Befolgen Sie diese Schritte zur Reinigung:

- Bereiten Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel oder ein pH-neutrales Enzymreinigungsmittel gemäß den Angaben des Reinigungsmittelherstellers vor.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch, das mit einer kleinen Menge Reinigungs-lösung getränkt ist, und wischen Sie alle Oberflächen, einschließlich des Bildschirms des Generators, von Hand ab.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem sauberen, weichen, in warmem Leitungswasser getränkten Tuch ab.
- Wischen Sie abschließend alle Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um sicherzustellen, dass sie trocken sind.

Desinfektion

- Wenn der Generator mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert wird, muss er vor der Wiederverwendung desinfiziert werden. Die folgenden chemischen Desinfektionsmittel wurden für die Verwendung mit dem Generator validiert: 70% Isopropylalkohol, 6% Natriumhypochlorit, 10% Wasserstoffperoxid.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers für die richtige Anwendung, Konzentration und Einwirkzeit der Desinfektionsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass die Desinfektionsgeräte gemäß den Anweisungen des Herstellers konfiguriert und verwendet werden.

Reinigung des Fußschalters

Reinigen Sie den Fußschalter und das Kabel nach jedem Gebrauch wie folgt:

- Trennen Sie den Fußschalter vom Generator.
 - Bereiten Sie ein pH-neutrales Enzymreinigungsmittel nach den Anweisungen des Herstellers zu.
 - Verbinden Sie das Kabel sicher mit dem Fußschalter und tauchen Sie es für 2 Minuten in die Reinigungslösung.
- HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Fußschalters, mit dem Sie den Generator anschließen, völlig trocken ist, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Nach dem Eintauchen schrubben Sie den Fußschalter und das Kabel manuell mit einer weichen Bürste in der Reinigungslösung.
 - Spülen Sie den Fußschalter und das Kabel mindestens 1 Minute lang gründlich mit warmem Leitungswasser ab.
 - **ACHTUNG:** Halten Sie das Kabel und den Fußschalter während des Spülvorgangs fest angeschlossen.
 - Wischen Sie alle Oberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

WARNUNG: Reinigen Sie den Fußschalter nicht mit einem Ultraschallgerät.

WARNUNG: Schalten Sie die Stromversorgung des Generators nicht ein, bevor Sie das AC-Netzkabel angeschlossen haben. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse vor dem Zusammenbau trocken sind.

Reinigung und Desinfektion des Transducers

Die Transducer werden unsteril geliefert und müssen vor jedem Gebrauch gründlich gereinigt und sterilisiert werden.

Reinigung:

Reinigen Sie die Schallköpfe gründlich gemäß der folgenden Anweisung:

- Spülen Sie den Transducer mit der Schraubenseite nach oben ab und reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste mit demineralisiertem Wasser, bis keine Flecken mehr auf der Oberfläche sind;
 - Der Transducer kann in einem pH-neutralen enzymatischen Reinigungsmittel eingeweicht werden (Hauptbestandteile: Protease, Lipase, Amylase, Cellulase, Pektinase und andere biologische Enzyme, umweltfreundliches Tensid, Rostschutzfaktor und Stabilisator) für einen Zeitraum von bis zu 10 Minuten und bei einer geeigneten Temperatur 15° C - 65°C. Das Verhältnis von Waschmittel und Wasser sollte 1 : 400 betragen;
 - Spülen Sie den Transducer mit der Schraubenseite nach oben 2 Minuten lang mit demineralisiertem Wasser ab.
 - Reinigen Sie die Verbindungsschraube, die Oberfläche der Scherenhalterung und den Anschluss mit einem Alkoholtupfer.
 - Weichen Sie den Transducer in 75 % medizinischem Alkohol ein und halten und schütteln Sie 30 Mal ab.
 - Spülen Sie den Transducer mit der Schraubenseite nach oben 2 Minuten lang mit demineralisiertem Wasser ab.
- Hinweis: Die Verwendung von Ultraschallreinigern wird für den Transducer nicht empfohlen.

Trocknen:

Trocknungstemperatur: 50-70 °C, Trocknungszeit: 30 min.

Sterilisation von Schallköpfen:

Nach den oben genannten Reinigungs- und Trocknungsschritten muss der Transducer mit einer der unten aufgeführten Methoden sterilisiert werden.

Dampfsterilisation (121 °C)

- Kappe vor der Sterilisation installieren. Der Transducer sollte vor der Sterilisation verpackt werden. Autoklavieren Sie mit einer Temperatur von 121 °C und einer Dauer von 30 Minuten.

- Trocknungstemperatur: 50-70 °C, Trocknungszeit: 30 min.

Dampfsterilisation (134 °C)

- Kappe vor der Sterilisation installieren. Der Transducer sollte vor der Sterilisation verpackt werden. Legen Sie die Transducer in einen Hochtemperatur-Dampfsterilisationscontainer zur Sterilisation bei einer Temperatur von 134 °C und einer Dauer von 10 Minuten.

- Trocknungstemperatur: 50-70 °C, Trocknungszeit: 30 min.

Sicherheits und Funktionstests

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheits- und Funktionstests für den Transducer, den Generator und den Fußschalter in Übereinstimmung mit den Verfahren und Vorschriften des Krankenhauses durchgeführt werden. Für Sicherheits- und Funktionstests anderer Komponenten, die von mehreren Patienten verwendet werden, lesen Sie bitte die für die jeweilige Komponente spezifische Gebrauchsanweisung.

Sicherheitstest

Generator: Zertifizierte Krankenhaustechniker sollten einen Ableitstromtest durchführen.

Fußschalter: Untersuchen Sie das Pedal, den Anschluss und das Kabel auf Risse oder Schäden. Ersetzen Sie alle beschädigten Komponenten.

Andere Komponenten: Überprüfen Sie alle anderen Komponenten gemäß den Anweisungen in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Funktionstest

Ultraschall-Modus

- Bereiten Sie den kompletten Satz PD Ultraschallschere vor und schließen Sie den Transducer gemäß den Anweisungen in Kapitel II - Installation und Betrieb des Geräts an.
- Prüfen Sie, ob es möglich ist, in den Arbeitszustand zu gelangen. Verschiedene Ultraschallscheren können unterschiedliche Eingabeschnittstellen haben. Detaillierte Anweisungen finden Sie in Teil 1, Abschnitt 3 von Kapitel 2.
- Bestätigen Sie die Anzeige von MIN Power Level 3 und MAX Power Level 5.
- Drücken Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Leistung, um sicherzustellen, dass die Leistungsstufe MIN von Stufe 1 bis 5 eingestellt werden kann.
- Schalten Sie den Generator ein und schalten Sie ihn in den Ultraschall-Betriebsmodus. Überprüfen Sie den korrekten Anschluss von Transducer und Ultraschallschere.
- Drücken Sie bei geöffneter Backe die Taste "MAX" auf dem Fußschalter. Auf dem LCD-Bildschirm sollte die MAX-Leistungsstufe "5" angezeigt werden, und ein Aktivierungston sollte ertönen.
- Drücken Sie bei geöffneter Backe die Taste "MIN" am Fußschalter. Auf dem LCD-Bildschirm sollte die Leistungsstufe MIN angezeigt werden, und ein Aktivierungston sollte ertönen.

WARNUNG: Achten Sie vor der Aktivierung des Systems darauf, dass die Backe von Geweben, anderen Instrumenten oder anderen Gegenständen ferngehalten wird, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

Bipolarer elektrochirurgischer Modus

- Schließen Sie das fortschrittliche bipolare elektrochirurgische Instrument/das bipolare Basisinstrument gemäß den Anweisungen an.
- Prüfen Sie, ob das System die Arbeitsoberfläche aufrufen kann. Im einfachen bipolaren Modus sollte das Symbol für die Leistungsstufe 30 angezeigt werden, während im erweiterten bipolaren Modus das Symbol "advanced bipolar" angezeigt werden sollte.
- Berühren Sie leicht die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Leistung im bipolaren Basismodus, um zu bestätigen, dass der Leistungspegel zwischen 1 und 95 eingestellt werden kann. Berühren Sie die Balken Low, Medium und High, um direkt zwischen 15, 30 und 60 zu wechseln.
- Schalten Sie den Generator aus und warten Sie 5 Sekunden lang. Schalten Sie dann die Stromversorgung des Generators ein und warten Sie 10 Sekunden lang. Prüfen Sie, ob im bipolaren Basismodus die Schnittstelle für 30 Leistungsstufen und im erweiterten bipolaren Modus die Schnittstelle für "erweiterte Bipolar" angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob der Generator gemäß den vorgegebenen Anforderungen aktiviert ist.
- Schließen Sie die bipolaren elektrochirurgischen Instrumente Advanced und Basic an und drücken Sie den Fußschalter. Achten Sie auf blinkende Leistungsanzeigen auf dem Bedienfeld und hören Sie auf ein Aktivierungsgeräusch.

WARNUNG: Vor der Aktivierung des Systems ist es strengstens untersagt, die Ultraschallschere mit Gewebe, anderen Instrumenten oder anderen Gegenständen in Berührung kommen zu lassen, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Systembezogen

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Krankenhausrichtlinien für die klinische Praxis für Ultraschallchirurgie, Elektrochirurgie, Gynäkologie und Laparoskopie.
- Minimalinvasive Geräte können sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Wenn bei einer Operation gleichzeitig minimal-invasive Instrumente und Zubehör verschiedener Hersteller verwendet werden, prüfen Sie vor der Operation die Kompatibilität der Instrumente und des Zubehörs und kontrollieren Sie, ob das in den menschlichen Körper eingeführte Zubehör eine raue Oberfläche, eine scharfe Kante oder einen Vorsprung aufweist, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung durch ausgebildete und lizenzierte Chirurgen bestimmt. Verwenden Sie elektrochirurgische Geräte nur dann, wenn Sie in ihrer Verwendung für den spezifischen Eingriff, den Sie durchführen müssen, ordnungsgemäß geschult wurden. Die ungeschulte Verwendung dieses Geräts kann zu unbeabsichtigten schweren Verletzungen des Patienten führen, einschließlich Darmperforation und unbewusster und irreparabler Gewebenekrosen.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Generators nicht ohne Erlaubnis, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Alle Reparaturen und Aufrüstungen des Geräts dürfen nur von einer von Reach Surgical, Inc. geschulten und autorisierten Serviceperson durchgeführt werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als medizinische Eingriffe.

- Ein gründliches Verständnis der Prinzipien und Techniken, die mit Laser-, elektrochirurgischen und Ultraschallverfahren verbunden sind, ist unerlässlich, um Schock- und Verbrennungsgefahren für den Patienten und das medizinische Personal sowie Schäden an diesem Gerät oder anderen medizinischen Geräten zu vermeiden. Die elektrische Isolierung oder Erdung darf nicht beeinträchtigt werden. Tauchen Sie elektrochirurgische Geräte nicht in Flüssigkeiten ein, es sei denn, die Konstruktion erfordert dies und auf dem Etikett ist angegeben, dass sie eingetaucht werden sollten.
- Eine sichere und effektive Ultraschallchirurgie und Elektrochirurgie hängt nicht nur von der Konstruktion des Geräts ab, sondern auch von vielen Faktoren, die vom Bediener kontrolliert werden. Um die Sicherheit und Effektivität zu verbessern, lesen, verstehen und befolgen Sie die mit dem Gerät gelieferte Gebrauchsanweisung.
- Wie bei allen Energiequellen (Elektrochirurgie, Laser oder Ultraschall) sollten Sie die karzinogenen und infektiösen Risiken bedenken, die von vielen Gewebesenprodukten wie Rauch und Aerosolen ausgehen können. Sowohl bei offenen als auch bei endoskopischen Eingriffen sollten geeignete Vorsichtsmaßnahmen wie Schutzbrillen, Filtermasken und eine wirksame Rauchabsaugung beachtet werden.
- Prüfen Sie nach dem Entfernen des Geräts das Gewebe auf Hämostase. Wenn keine Hämostase vorhanden ist, sollten Sie geeignete Methoden anwenden, um die Hämostase zu erreichen.
- Produkte, die von nicht von Reach Surgical, Inc. autorisierten Unternehmen hergestellt oder vertrieben werden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel. Die Verwendung solcher Produkte kann zu unerwarteten Ergebnissen führen und den Anwender oder Patienten verletzen.
- Um das Risiko von Interferenzen zu verringern, sollten das Gerät und das Gehäuse an einen unabhängigen Stromkreis angeschlossen sein.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Gegenwart eines entflammaren Anästhesiemischs mit Luft oder mit Sauerstoff oder Distickstoffoxid geeignet. Mögliche Funkenbildung durch Kollision mit anderen metallischen Geräten. Funken können brennbare Gase, wie z.B. Feldgase, entzünden.
- Das Gerät muss innerhalb des erforderlichen Umgebungstemperaturbereichs betrieben werden.
- Die Spannung der Ausgangssteckdose muss den Anforderungen des Generators entsprechen (Kapitel 'Technische Bedingungen des Systems'). Wenn die Stromversorgung nicht korrekt angeschlossen ist, kann der Generator beschädigt werden und es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie den Aktivierungston nicht auf eine unhörbare Lautstärke ein. Die Aktivierungstöne können vom OP-Personal wahrgenommen werden, während der Generator Energie liefert.
- Rauch, der bei elektrochirurgischen Eingriffen entsteht, kann nachweislich zu Verletzungen von Patienten oder des OP-Personals führen. Empfehlen Sie eine angemessene Belüftung mit einer chirurgischen Rauchabsaugung oder anderen Mitteln.
- Einige Komponenten des Ultrasonic Surgical Integrated Generator werden unsteril ausgeliefert (z.B. der Transducer). Sterilisieren Sie das Produkt wie erforderlich, bevor Sie mit der Installation des Systems beginnen. Hinweise zur Reinigung und Sterilisation finden Sie in den jeweiligen Anleitungen.
- Um Verletzungen von Anwendern oder Patienten zu vermeiden, muss die Ultraschallschere vor dem Drücken der Testtaste und während der Systemprüfung andere Geräte, OP-Tücher, Patienten oder andere Gegenstände meiden. Die Sicherheitsmaßnahmen im Falle von Aerosol (gemäß den Krankenhausvorschriften) müssen bei der Systemprüfung und der Testmethode umgesetzt werden.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Kiefer aus, um die Abgabe der Ultraschallenergie nicht zu behindern.
- Um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden, muss die Klinge vor der Aktivierung des Systems den Kontakt mit Gewebe, anderen Geräten oder anderen Gegenständen vermeiden.
- Wenn Flüssigkeit auf oder in den Generator gespritzt oder geschüttet wird, kann der Generator beschädigt werden und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.
- Funkenbildung und Erhitzung beim Verschließen von Gefäßen können beide als Zündquellen dienen. Gaze und ein Schwamm sollten feucht bleiben. Halten Sie elektrochirurgische Elektroden von brennbaren Materialien und sauerstoffreichen (O₂) Umgebungen fern.
- Wenn der Transducer erheblich beschädigt ist oder Teile nach der Reinigung und Desinfektion Anzeichen von Schäden aufweisen, entsorgen Sie sie. Beschädigte Teile sind deutlich gekennzeichnet, um Missbrauch zu vermeiden, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Einwegmüll und Elektronikschrott müssen gemäß den Vorschriften des Krankenhauses entsorgt werden und dürfen nicht einfach weggeworfen werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Generator in der Nähe von anderen Geräten oder auf anderen Geräten gestapelt zu verwenden. Wenn Sie den Generator neben oder auf anderen Geräten verwenden müssen, überwachen Sie den Generator und die anderen Geräte, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich für den Service an Ihren Reach Surgical-Vertreter oder das Servicepersonal.
- Überprüfen Sie alle an das System angeschlossenen Geräte und Verbindungen vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass das Gerät wie vorgesehen funktioniert. Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Lichtbogenbildung, Funkenbildung, Fehlfunktionen des Geräts oder unbeabsichtigten chirurgischen Ergebnissen führen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Stromversorgung mit Schutzerde angeschlossen werden.
- Halten Sie so viel Abstand wie möglich zwischen dem Generator und anderen elektronischen Geräten (z.B. Monitoren). Kreuzen oder verbinden Sie keine elektrischen Drähte mit elektronischen Geräten. Der Generator kann Störungen bei anderen elektronischen Geräten verursachen.
- Das System sollte in Gegenwart von internen und externen Herzschrittmachern mit Vorsicht verwendet werden. Durch die Verwendung von elektrochirurgischen Instrumenten verursachte Störungen können dazu führen, dass der Herzschrittmacher in einen asynchronen Zustand gerät oder die Funktion des Herzschrittmachers vollständig verhindert wird. Wenn elektrochirurgische oder gewebeversiegelnde Geräte zur Verwendung bei Patienten mit Herzschrittmachern vorgesehen sind, wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder die kardiologische Abteilung des Krankenhauses, um weitere Informationen zu erhalten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Instrumente auf dem Generator stapeln oder den Generator auf elektrische Instrumente stellen. Dies ist eine instabile Konfiguration und bietet keine ausreichende Kühlung.
- Wenn der Generator ausfällt, kann dies zu einer Unterbrechung der Operation führen. Es muss ein Backup-System vorhanden sein.
- Wenn es die örtlichen Vorschriften verlangen, sollte der Generator mit einem Äquipotentialkabel an den Anschluss des Krankenhauses angeschlossen werden.
- Wenn das System und das physiologische Überwachungsgerät gleichzeitig bei demselben Patienten verwendet werden, muss jede Überwachungselektrode so weit wie möglich vom Gerät entfernt sein.
- Wählen Sie im grundlegenden bipolaren Modus die geringstmögliche Ausgangsleistung für den gewünschten Effekt.
- Der Ausfall von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten kann einen unerwarteten Anstieg der Ausgangsleistung verursachen.
- In den Generator und den grundlegenden bipolaren elektrochirurgischen Anschluss können Wasser oder Partikel eindringen. Bei der Verwendung und Reinigung müssen Sie das Eindringen von Wasser oder Partikeln vermeiden.
- Wenn das System in Kombination mit einem Endoskop verwendet wird, kann es den Lektstrom am Körper des Patienten erhöhen. Seien Sie während des Eingriffs vorsichtig.
- Ein Hinweis an den Anwender und/oder Patienten, dass jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, an Reach Surgical, Inc. über Reachquality@reachsurgical.com, und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden sollte.

Instrumentenbezogen

Bei chirurgischen Eingriffen müssen Sie sich bewusst sein, dass der Endteil der Ultraschallschere, das Ultraschallscheren-Pad und der Schaft erhöhte Temperaturen aufweisen können, wenn Ultraschall oder bipolare Elektrokoagulation über längere Zeit auf das Gewebe einwirken. Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss jeder versehentliche Kontakt zwischen diesen Instrumentenkomponenten und Gewebe, OP-Abdeckungen, OP-Mänteln oder anderen Bereichen während des Eingriffs vermieden werden.

Darüber hinaus ist es wichtig, bei der Positionierung des bipolaren Instruments Vorsicht walten zu lassen. Insbesondere sollte es nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit brennbaren Materialien wie Gaze oder OP-Tüchern platziert werden. Die bipolaren Instrumente, die in diesem Zusammenhang verwendet werden, können während der Verwendung Hitze erzeugen, was möglicherweise zu einer Brandgefahr führen kann. Wenn der bipolare elektrochirurgische Generator nicht in Gebrauch ist, sollte er ordnungsgemäß in der Schutzhülle aufbewahrt oder in einem sicheren Abstand zum Patienten, den Mitgliedern des Operationsteams und allen brennbaren Materialien aufbewahrt werden.

HINWEIS: Weitere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

EMC-Informationen

Das Produkt hat den Test zur elektromagnetischen Verträglichkeit bestanden und erfüllt damit die Grenzwerte der Norm IEC60601-1-2 für medizinische Geräte. Diese Einschränkungen bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in normalen medizinischen Einrichtungen.

Zusammensetzung des Produkts

Seriennummer	Teil Name	Modell/Version Nr.	Bemerkungen
1	Elektrochirurgisches Instrument	OP9	/
2	Transducer für die Ultraschallchirurgie-Ausrüstung	TRA6	Kompatible Verwendung
3	Ultraschallschere System für den einmaligen Gebrauch Ultraschallschere	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatible Verwendung
4	Einweg-Ultraschall-Hochfrequenz-Chirurgiegerät Gewebeversiegler	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultraschall Fußschalter	OP-FSD	/
6	Elektrochirurgischer Fußschalter	OP-FSS	/
7	Bipolarer Anschluss für die Elektrochirurgie	OP-BPC	/

Produkt Kabel

Seriennummer	Kabel Name	Länge (m)	Abgeschirmt
1	Fußschalter Kabel	3	Ja
2	Netzkabel	5	Nein
3	Bipolares elektrochirurgisches Kabel	3	Nein
4	Das Kabel von Transducer	2.9	Ja

EMC Leistung

Dieses Gerät kann Funkstörungen ausgesetzt sein, die durch andere medizinische Geräte und Funkkommunikation verursacht werden. Um solche Störungen zu vermeiden, wurde dieses Produkt gemäß IEC 60601-1-2 getestet und erfüllt dessen Anforderungen. Reach Surgical, Inc. kann jedoch nicht garantieren, dass es in einzelnen Installationsumgebungen zu keinerlei Störungen kommt.

Wenn festgestellt wird, dass das Gerät gestört wird (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), sollte der Benutzer (oder von Reach Surgical, Inc. genehmigtes Wartungspersonal) versuchen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um das Störungsproblem zu lösen:

Passen Sie die Richtung oder Position des Geräts an, die es beeinflusst.

Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem sendenden Gerät.

Verwenden Sie für die Stromversorgung dieses Geräts andere Stromquellen (und nicht den Strom, mit dem das Gerät betrieben wird).

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Kundendienstvertreter, wenn Sie weitere Vorschläge benötigen.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen, die durch die folgenden Situationen verursacht werden: Verwendung anderer Verbindungskabel als der empfohlenen Kabel, unerlaubte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät. Unerlaubte Änderungen oder Modifikationen können dazu führen, dass das Gerät seine Wirksamkeit verliert.

Alle Arten von elektronischen Geräten können über die Luft oder andere angeschlossene Kabel elektromagnetische Störungen bei anderen Geräten verursachen. Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts keine Geräte, die Hochfrequenzsignale aussenden können, wie z.B. Mobiltelefone, Funksendempfänger oder Funksteuerungsprodukte, da dies dazu führen kann, dass die Leistung dieses Geräts nicht den angegebenen Spezifikationen entspricht. Wenn sich solche Geräte in der Nähe des Geräts befinden, schalten Sie diese Geräte aus. Das medizinische Personal, das für dieses Gerät verantwortlich ist, sollte Techniker, Patienten und anderes Personal, das sich in der Nähe dieses Geräts aufhält, anweisen, die oben genannten Anforderungen vollständig einzuhalten.

Um die angegebene EMV-Leistung vollständig zu erreichen, sollte der Benutzer das Produkt gemäß den im Handbuch beschriebenen Schritten korrekt installieren. Sollten EMV-bezogene Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an das von Reach Surgical, Inc. zugewiesene Wartungspersonal. Der Transducer (mit Kabel) und die Ultraschallschere werden als der angewandte Teil des gesamten Systems definiert.

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation des Produkts

Das Gerät kann in einer Krankenhausumgebung verwendet werden, enthält aber keine Räume zur Abschirmung von Hochfrequenzgeräten in der Nähe von aktiven Hochfrequenz-Chirurgiegeräten oder von Magnetresonananzgeräten, da die elektromagnetische Störungsintensität an diesen Orten hoch ist.

Abstand und Auswirkung von ortsfesten Funkkommunikationsgeräten: Die magnetische Feldstärke, die von ortsfesten Sendern erzeugt wird, wie z.B. Basisstationen von drahtlosen (zellularen/schnurlosen) Telefonen, mobilen Landfunkempfängern, Amateurfunkempfängern, AM- und FM-Radiosendungen und TV-Sendungen Generatoren, usw., kann theoretisch nicht genau gemessen werden. Um die von ortsfesten HF-Sendern erzeugte elektromagnetische Umgebung zu beurteilen, sollte die Messung des elektromagnetischen Feldes in Betracht gezogen werden. Wenn der gemessene Wert der magnetischen Feldstärke am Standort des Geräts den entsprechenden, in der "Erklärung zur Störungsbeseitigung" angegebenen Hochfrequenzpegel überschreitet, sollte das Gerät überprüft werden, um sicherzustellen, dass es normal betrieben werden kann. Wenn abnormale Betriebsbedingungen festgestellt werden, sollten zusätzliche Maßnahmen in Betracht gezogen werden, wie z.B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Geräts oder die Verwendung eines Anti-Funkfrequenzraums.

1) Verwenden Sie das von Reach Surgical, Inc. gelieferte oder angegebene Netzkabel. Produkte, die mit einem Netzstecker ausgestattet sind, sollten an eine feste Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden. Verwenden Sie keine Adapter oder Anschlüsse, um den Netzstecker anzuschließen.

2) Halten Sie dieses Gerät so weit wie möglich von anderen elektronischen Geräten fern.

3) Befolgen Sie die Schritte zum Anschließen des Geräts.

Allgemeine Anmerkungen

(1) Die Spezifikation des Kabels.

Die Verwendung von Kabeln, die von Reach Surgical, Inc. bereitgestellt werden, beeinträchtigt die EMV-Leistung dieses Produkts nicht. Wenn nicht spezifiziert Kabel verwendet werden, kann die EMV-Leistung dieses Geräts erheblich beeinträchtigt werden.

(2) Vorkorrekturen für unbefugte Änderungen

Der Benutzer darf dieses Produkt nicht verändern, da sonst die EMV-Leistung dieses Produkts abnehmen kann.

Die Modifikation des Produkts umfasst die folgenden Änderungen:

a. Kabel (Länge, Material, Verdrahtung, etc.).

b. Installation/Layout der Geräte.

c. Konfiguration/Komponenten der Ausrüstung.

d. Teile zum Schutz des Geräts (Deckel zum Öffnen/Schließen und Teile zur Befestigung des Deckels).

(3) Alle Schutzabdeckungen sollten während des Betriebs des Geräts geschlossen sein.

Es wird erwartet, dass dieses Produkt in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung verwendet wird, und der Käufer und Benutzer dieses Produkts sollte sicherstellen, dass es in dieser elektromagnetischen Umgebung verwendet wird.

Wesentliche Leistung

1. Bei fortschrittlicher Hochfrequenz-Funkleistung muss das System sicherstellen, dass die Abweichung der Nennleistung nicht mehr als 20% des Standardwerts beträgt

2. Für die Basis-Hochfrequenz-Funkleistung muss das System sicherstellen, dass die Abweichung der Nennleistung nicht mehr als 20% des Standardwerts beträgt

Leitfaden und Erklärung des Herstellers - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIONEN		
Das Gerät ist für die Verwendung in der wie folgt spezifizierten elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer von das Gerät sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Emissionsprüfung	Compliance	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
RF-Emissionen CISPR 11	Gruppe1	Das Gerät verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen.
RF-Emissionen	Klasse A	Die EMISSIONS-Eigenschaften dieses Geräts machen es für den Einsatz in Industriegebieten und Krankenhäusern geeignet
Harmonischer Strom IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsänderungen/Spannungsschwankungen/ Flicker IEC 61000-3-3	Erfüllt	

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Gerät ist für die Verwendung in der wie folgt spezifizierten elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird			
IMMUNITÄTstest	IEC 60601 Teststufe	Niveau der Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
Elektrostatik Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontakt ± 2,4,8 ,15kV Luft	± 8 kV Kontakt ± 2,4,8 ,15kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn der Boden mit synthetischem Material bedeckt ist, Die relative Luftfeuchtigkeit sollte mindestens 30 % betragen.
Schnelle elektrische Transiente/Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Eingangs-/ Ausgangsleitungen	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) gegen Erde	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung (s) gegen Erde	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzschluss Unterbrechungen an den Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklen bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT; 1 Zyklus und 70 % UT; 25/30 Zyklen Einphasig; bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklus	0 % UT; 0,5 Zyklus Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT; 1 Zyklus und 70 % UT; 25/30 Zyklen Einphasig; bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklus	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des Ultraschallgerätes Wenn das Gerät auch bei Unterbrechungen des Stromnetzes weiter betrieben werden muss, wird empfohlen, das Ultraschallchirurgie- Gerät Die Geräte werden von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie gespeist.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetisches Feld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Netzfrequenz magnetisch Felder sollten auf Ebene Merkmal sein. eines typischen Standorts in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung.

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Gerät ist für die Anwendung in der wie folgt spezifizierten elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
IMMUNITÄT Test	IEC 60601 Test Ebene	Compliance Ebene	Elektromagnetische Umgebung- Anleitung
Leitungsgebundene RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz	3V	Tragbare und mobile RF-Kommunikation Die Geräte sollten nicht näher an einem Teil des Geräts, einschließlich der Kabel, verwendet werden als der empfohlene Abstand, der sich aus der Gleichung für die Frequenz des Senders ergibt. Empfohlener Trennungsabstand
Abgestrahlte RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz bis } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz bis } 2,7\text{GHz}$ <p>wobei P die maximale Ausgangsleistung ist des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders und d ist der empfohlene Abstand in Metern (m). Die Feldstärken von ortsfesten RF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt wurden.3 sollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformitätsniveau liegen. In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:</p>  <p>Der ENCLOSURE PORT von ME EQUIPMENT und ME SYSTEMS muss gemäß Tabelle 9 der IEC 60601-1-2 unter Verwendung der in der IEC 61000-4-3 festgelegten Prüfverfahren getestet werden.</p>
Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und den Geräten.			

Die Ultraschallchirurgie-Ausrüstung zielt auf die Anwendung in einer elektromagnetischen Umgebung ab, in der abgestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des Geräts kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Gerät einhält, wie im Folgenden empfohlen. Entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Maximale Nennausgangsleistung des Senders (w)	Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders /m		
	150 kHz bis 80 MHz	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{T}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

HINWEIS: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

Technische Bedingungen

Für den Betrieb des Systems erforderliche Komponenten: Elektrochirurgisches Instrument, Transducer, Ultraschall Fußschalter, Elektrochirurgischer Fußschalter, Ultraschallschere oder Elektrochirurgische Handstücke Elektrochirurgischer Bipolarer Anschluss Bipolares Instrument.

Lesen Sie die Produktbeschreibung für diese Komponente.


Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag	Ultraschall:  Typ CF Anwendungsteil; Bipolare Elektrochirurgie +  Defibrillationssicherer Typ CF Anwendungsteil
Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag	Klasse I
Generator für schädliche Infusionen	Normale Ausrüstung
Grad des Schutzes gegen schädliches Eindringen von Wasser	Fußschalter: IP68
Kategorie Management	Klasse IIb
Ultraschallmodus Parameteranforderungen:	
Eingangsleistung	Versorgungsspannung: 100-240V Netzfrequenz: 50Hz/60Hz Eingangsleistung: 400VA
Ultraschallmodus Parameteranforderungen:	
Erregungsfrequenz	54 kHz - 57 kHz
Vibrationsausschlag der Primärspitze	25 µm - 110 µm
Ultraschallschere Spitze Hauptschallabgabefläche Produkt:	1,53-2,75 mm ²
Akustische Sekundärvernetzung an der Spitze der Ultraschallschere Ausgabebereich:	19.32-35.88 mm ²
Abgeleiteter Ausgangsschall an der Ultraschallschere Spitze an der Referenzspitze Primäre Amplitudenleistung	< 30W
Art der Frequenzsteuerung des Systems	Unabhängig von der Last wird die Erregungsfrequenz automatisch und kontinuierlich angepasst.
Index der Gangreserve	Nicht weniger als 2,5
Anforderungen an die elektrochirurgischen Parameter:	
Arbeitsfrequenz	400KHz ± 5%
Maximale Ausgangsspannung	≤ 250V
Erweiterter bipolarer Modus Maximaler Ausgangsstrom	≤ 5.5A
Bipolarer Grundmodus Maximaler Ausgangsstrom	≤ 2.2A
Maximale Spitze-Spitze-Spannung am Ausgang	≤ 500Vpk
Peak-Faktor	1.6 ± 0.4
Nennleistung	Erweiterte bipolare Funkfrequenz: 270 W Funkfrequenz Basic bipolar: 95W
Nennlast	Erweiterte bipolare Funkfrequenz: 30Ω Hochfrequenz Basis bipolar: 200Ω

Bedingungen der Betriebsumgebung	Temperatur: 10 ° C bis 30 ° C
	Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 70%
	Atmosphärischer Druckbereich: 800 hPa bis 1060 hPa
Transport- und Lagerbedingungen	Temperatur: -30 ° C bis + 55 ° C (Generator, Fußschalter, Adapter) Temperatur: -10 ° C bis + 55 ° C (Ultraschallschere)
	Luftfeuchtigkeit: ≤ 80%
	Atmosphärischer Druckbereich: 800 hPa bis 1060 hPa
Datum der Herstellung	Das Herstellungsdatum können Sie anhand der Seriennummer auf der Rückseite des Generators feststellen.
Netzkabel	Einhaltung der CCC-Zertifizierungsanforderungen
	Nennstrom: 10A
Persistenzrate	Bestimmt durch das Transducer-Handstück und die verwendete Ultraschallschere. Informationen zur Persistenzrate finden Sie in den entsprechenden Ultraschallschere und Transducer Handstück Anweisungen oder Kapitel 7 - Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Sicherung	€5 * 20 T8AH250V
Gewicht (ohne Verpackung)	Generator: nominal 8 kg
Gesamtes Volumen	OP9 Generator: (Länge * Breite * Höhe): 34 cm-34 cm-16 cm
Disposition	Einige interne Komponenten des Generators, des Fußschalters und des Fußschalterkabels enthalten Blei. Entsprechend den örtlichen Anforderungen und Vorschriften für die Entsorgung. Entsorgen Sie Batterien in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abfallentsorgungspraktiken.
AP/APG Klassifizierung	Keine AP/APG-Ausrüstung.
Nutzungsdauer:	Nutzungsdauer: 7 Jahre
Software Release Version	V01.01

Bipolare Ausgangswellenform


Erweiterte bipolare Ausgangsleistung-Last-Kurve

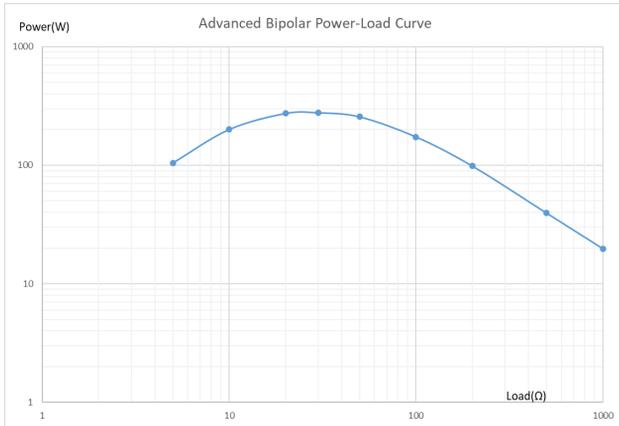

LEISTUNGSKURVE LIMIT Maximale Leistung: 270[W]			
Last (Ω)	Untere Grenze	Nominal	Obere Grenze
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Nominale Leistungskurve von 270 Watt Leistung bei Nennlast in Übereinstimmung mit der Strom-/Spannungsgrenze des Leistungskurvenmessers. Die Leistungskurve stellt die Hüllkurve dar, die unter Betriebsbedingungen variiert.

Grundlegende bipolare Ausgangskurve bei voller Leistung und Last

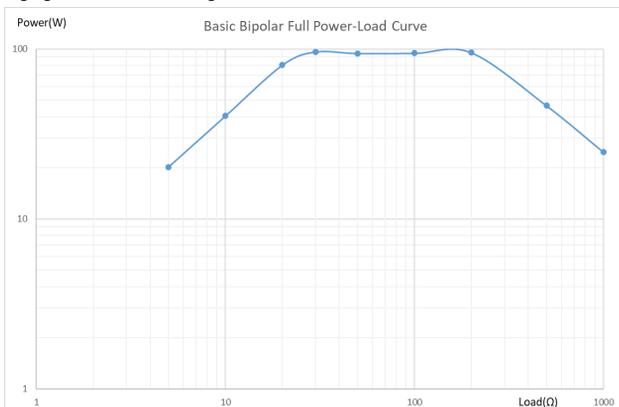


Grenze der vollen Leistungskurve [W]: Maximale Leistung 95 Watt			
Last (Ω)	Untere Grenze	Nominal	Obere Grenze
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Grundlegende bipolare Ausgangs-Halbleistungs-Last-Kurve

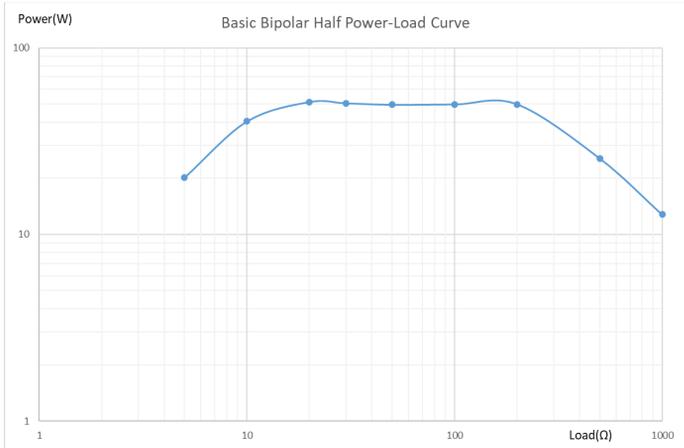

Grenze der halben Leistungskurve [W]: Maximale Leistung 50 Watt			
Last (Ω)	Untere Grenze	Nominal	Obere Grenze
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Ausgangsleistung vs. Leistungseinstellungen für Leistung im normalen bipolaren Zustand

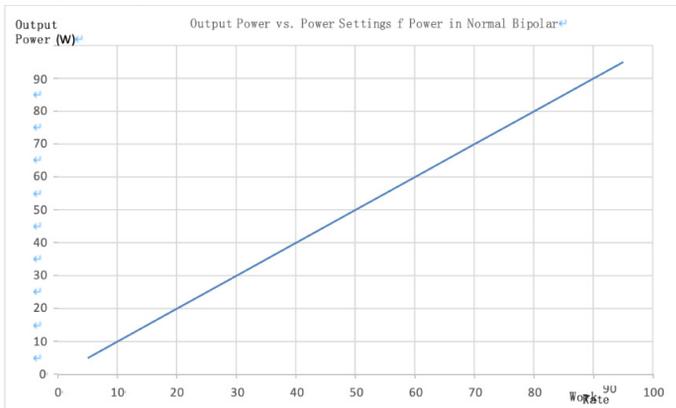

Ausgangsleistung vs. Leistungssollwert für Normal Bipolar [W]; Last: 200Ω			
Eingestellte Leistung (W)	Untere Grenze der Ausgangsleistung (W)	Nennleistung (W)	Obere Grenze der Ausgangsleistung (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Service und Garantie

Reach Surgical, Inc. garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und vorbeugender Wartung während der unten angegebenen Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Verpflichtung von Reach Surgical im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich darauf, nach eigenem Ermessen jedes defekte Produkt oder Teil zu reparieren oder zu ersetzen, das innerhalb des geltenden Garantiezeitraums an Reach Surgical, Inc. oder seinen autorisierten Vertriebspartner zurückgeschickt wird und sich zur Zufriedenheit von Reach Surgical als defekt erweist. Diese Garantie gilt nicht für Produkte oder Teile, die:

- Beeinträchtigt durch die Verwendung mit nicht autorisierten Geräten, die von nicht von Reach Surgical, Inc. autorisierten Parteien hergestellt oder vertrieben werden.
- Reparaturen oder Veränderungen außerhalb des Werks von Reach Surgical, wenn diese die Stabilität oder Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen, wie von Reach Surgical festgelegt.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Fahrlässigkeit oder Unfall.
- Verwendung in einer Weise, die nicht mit dem Design, den Verwendungsparametern, den Anweisungen und Richtlinien für das Produkt oder mit den von der Industrie akzeptierten Funktions-, Betriebs- oder Umweltstandards für ähnliche Produkte übereinstimmt.

Gewährleistungsfristen

Bipolarer Basis-Energie-Anschluss (OP-BPC): 1 Jahr für Komponenten und Arbeit.

Generator (OP9): 1 Jahr für Komponenten und Arbeit.

Fußschalter/Netz kabel: 1 Jahr für Komponenten und Arbeit.

Diese Garantie ist das ausschließliche Rechtsmittel für den Erstkäufer und ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Reach Surgical, Inc. haftet nicht für besondere, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, einschließlich Schäden, die sich aus dem Verlust von Nutzung, Gewinn, Geschäft oder Firmenwert ergeben, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgesehen.

Reach Surgical, Inc. ermächtigt niemanden zur Übernahme einer zusätzlichen Haftung in Verbindung mit dem Verkauf oder der Verwendung seiner Produkte. Es gibt keine Garantien, die über die hier genannten Bedingungen hinausgehen.

Reach Surgical, Inc. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, ohne dass eine Verpflichtung besteht, diese Änderungen rückwirkend auf bereits verkaufte oder gebaute Produkte anzuwenden.

Επισκόπηση

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Παρέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με τη σωστή λειτουργία, τους πιθανούς κινδύνους και τις πιθανές ζημιές στο προϊόν ή σε άτομα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη φυσιολογικής κατάστασης, ακολουθήστε τις καθορισμένες οδηγίες για να αποφύγετε βλάβη στον εαυτό σας ή ζημιά στον εξοπλισμό. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας, της απόδοσης, της γυγνής ή της συντήρησης, για την οποία ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για τα Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη χρήση αυτής της συσκευής. Δεν αποτελεί αναφορά για χειρουργικές τεχνικές.

Τυποποιημένες συμβάσεις που χρησιμοποιούνται: Προσοχή, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και δηλώσεις σημείωσης

Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες δηλώσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΣΗΜΕΙΩΣΗ και οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών. Αυτές οι δηλώσεις βρίσκονται σε όλη την τεκμηρίωση και θα πρέπει να διαβάζονται πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα μιας διαδικασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η δήλωση επισημαίνει μια διαδικασία, πρακτική ή κατάσταση λειτουργίας ή συντήρησης που, εάν δεν τηρηθεί αυστηρά, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η δήλωση προειδοποιεί τον χρήστη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό ή μέτριο τραυματισμό του χρήστη ή του ασθενούς, καθώς και σε βλάβη του εξοπλισμού ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ως προειδοποίηση κατά μη ασφαλών πρακτικών. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του οργάνου και την απαιτούμενη προσοχή για την αποφυγή ζημιών που προκύπτουν από την ορθή ή την ακατάλληλη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση αυτή υποδεικνύει μια πρακτική λειτουργίας ή μια κατάσταση που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση μιας εργασίας.

Περιγραφή

Το ηλεκτροχειρουργικό όργανο ENER REACH (εφεξής αναφερόμενο ως "η συσκευή") χρησιμοποιείται σε ιατρικές χειρουργικές αίθουσες για χειρουργικές επεμβάσεις κοπής, πήξης ανθρώπινων ιστών και απολίπωσης αγγείων. Διαθέτει δύο ξεχωριστές υποδοχές: η μία για την ενέργεια υπερήχων και η άλλη για την έξοδο κωματομορφής ραδιοσυχνότητας.

Στη λειτουργία ραδιοσυχνότητας, το Γεννήτρια παρέχει διαφορετικά ενεργειακά σχήματα ανάλογα με το συνδεδεμένο όργανο/τη συσκευή ηλεκτροχειρουργικής. Όταν είναι συνδεδεμένο ένα προηγμένο διπολικό όργανο, το Γεννήτρια παρέχει κωματομορφές RF για τη σφράγιση αρτηριακών και φλεβικών αγγείων, λεμφαγγείων και δεσμιδίων ιστού διαμέτρου έως 7 mm. Όταν συνδέεται ένα βασικό διπολικό όργανο, εκπέμπεται ενέργεια σταθερής ισχύος για κοπή και πήξη μαλακών ιστών.

Στη λειτουργία παραγωγής ενέργειας υπερήχων, χρησιμοποιώντας το TRA6 Μετατροπέας σε συνδυασμό με τα Αναλώσιμα εργαλεία υπερήχων μιας χρήσης CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, η συσκευή κόβει μαλακούς ιστούς που απαιτούν ένταση στην αιμορραγίας και ελάχιστη θερμική βλάβη και σφραγίζει αγγεία με μέγιστη διάμετρο έως 5 mm. Όταν συνδέεται η Αναλώσιμα Ψαλίδι μιας χρήσης SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 και SRE45, η συσκευή κόβει μαλακούς ιστούς που απαιτούν έλεγχο της αιμορραγίας και ελάχιστη θερμική βλάβη και σφραγίζει αγγεία με μέγιστη διάμετρο έως 7 mm.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή παρέχει ισχύ ραδιοσυχνότητας για την κίνηση ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων χειρός που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κοπή και τη σφράγιση αγγείων και για την κοπή, τη σύλληψη και τον τεμαχισμό ιστών.

Επιπλέον, το Γεννήτρια παρέχει υπερηχητική ισχύ για την οδήγηση χειρουργικών εργαλείων υπερήχων που ενδείκνυνται για τομές μαλακών ιστών όταν είναι επιθυμητός ο έλεγχος της αιμορραγίας και ο ελάχιστος θερμικός τραυματισμός.

Ενδείξεις

Η συσκευή παρέχει ισχύ ραδιοσυχνότητας για την οδήγηση ηλεκτροχειρουργικών εργαλείων χειρός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ανοικτών χειρουργικών επεμβάσεων ή λαπαροσκοπικών επεμβάσεων στη γενική, παιδιατρική, γυναικολογική, ουρολογική, θωρακική χειρουργική για την κοπή και τη σφράγιση αγγείων έως και 7 mm, καθώς και για την κοπή, τη σύλληψη και τον τεμαχισμό ιστών.

Επιπλέον, το Γεννήτρια παρέχει ισχύ για την οδήγηση χειρουργικών εργαλείων υπερήχων που ενδείκνυνται για τομές μαλακών ιστών όταν είναι επιθυμητός ο έλεγχος της αιμορραγίας και ο ελάχιστος θερμικός τραυματισμός. Τα χειρουργικά όργανα υπερήχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο της ηλεκτροχειρουργικής, των λέιζερ και των χαλύβδινων νυστερών για την κοπή ή/και την πήξη ιστών σε ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις ή λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις σε γενικές, παιδιατρικές, γυναικολογικές, ουρολογικές, θωρακικές, καθώς και για τη σφράγιση και διατομή λεμφαγγείων.

Προβλεπόμενος χρήστης

Η συσκευή προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας για χειρουργικές εφαρμογές.

Προβλεπόμενο περιβάλλον χρήσης

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ασθενείς ηλικίας 3 ετών και άνω που χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν τομές μαλακών ιστών με έλεγχο της αιμορραγίας και ελάχιστο θερμικό τραυματισμό.


Κλινικό όφελος

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην απολίπωση και διάιρεση αγγείων, ιστικών δεσμιδίων και λεμφαγγείων.

Αντενδείξεις

Αυτή η συσκευή αντενδείκνυται για οστικές τομές, απόφαση αντισυλληπτικών σαλπίγγων και διαδικασίες πήξης. Δεν προορίζεται επίσης για χρήση στη νευροχειρουργική.

Σύνθεση συστήματος

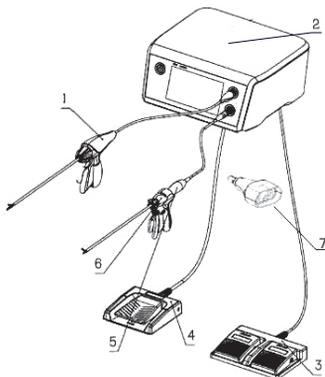

[01] Χειρολαβές Ηλεκτροχειρουργικής	[02] OP9 Γεννήτρια
[03] Ποδοδιακόπτης υπερήχων	[04] Ποδοδιακόπτης Ηλεκτροχειρουργικής
[05] Μετατροπέας	[06] Ψαλίδι υπερήχων
[07] Διπολικός Μετατροπέας Ηλεκτροχειρουργικής	

[01] Ηλεκτροχειρουργικό χειρουργικό εργαλείο

Το ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο χειρός, συνδεδεμένο με ένα Γεννήτρια, χειρίζεται από τον χειρουργό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εφαρμόζει ηλεκτροχειρουργική ενέργεια RF στον ιστό μεταξύ του Σιαγόνος για την πήξη ή τη σφράγιση. Το όργανο περιλαμβάνει επίσης μια λεπίδα για τη διαίρεση των ιστών. Μοντέλο: OSA23, OSA37, OSA44. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες.

[02] OP9 Γεννήτρια

Το Γεννήτρια παρέχει τόσο ηλεκτροχειρουργική ενέργεια όσο και ενέργεια υπερηχητικής θεραπείας μέσω ξεχωριστών θυρών σύνδεσης οργάνων. Αποτελείται από πλαίσιο, κέλυφος, ηλεκτρονική πλακέτα, οθόνη αφής LCD, διακόπτη ισχύος και διαεπαφές για τη σύνδεση εξαρτημάτων.

Μοντέλο: OP9

[03] Ποδοδιακόπτης υπερήχων

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της on/off εξόδου της ενέργειας υπερήχων με δύο διακόπτες ("MIN" και "MAX"). Μοντέλο: OP-FSD

[04] Ποδοδιακόπτης Ηλεκτροχειρουργικής

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εξόδου ενέργειας υψηλής συχνότητας με έναν μόνο διακόπτη.

Μοντέλο: OP-FSS

[05] Μετατροπέας

Το Μετατροπέας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια από ένα συμβατό Γεννήτρια σε μηχανική κίνηση για τις λεπίδες του οργάνου. Είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο όργανο με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Το Μετατροπέας δεν είναι αποστειρωμένο και πρέπει να αποστειρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του TRA6 Μετατροπέας για λεπτομερείς πληροφορίες.

Μοντέλο: TRA6.

[06] Ψαλίδι υπερήχων

Το Ψαλίδι υπερήχων χρησιμοποιεί τη μηχανική κίνηση από το Μετατροπέας και παρέχει ενέργεια υπερήχων για την κοπή ή την πήξη των ιστών. Θα πρέπει να γίνεται προσοχή, καθώς η μηχανική δόνηση δεν είναι ανιχνεύσιμη και θα μπορούσε να επηρεάσει ακούσια μη στοχευμένες περιοχές. Τα Ψαλίδι υπερήχων αποστειρώνονται με οξείδιο του αιθυλενίου. Εάν η διάρκεια ζωής ξεπεραστεί ή η συσκευασία αποστείρωσης έχει υποστεί ζημιά, τα Ψαλίδι υπερήχων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορρίπτονται. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Ψαλίδι υπερήχων για λεπτομερείς πληροφορίες.

Τα ακόλουθα Ψαλίδι υπερήχων είναι συμβατά με το OP9 Γεννήτρια:

Σειρά PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Σειρά SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Σειρά SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Διπολικός σύνδεσμος ηλεκτροχειρουργικής

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του βασικού διπολικού Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία με το Γεννήτρια για την πήξη των ιστών.

Μοντέλο: OP-BPC

Γεννήτρια Μπροστινός πίνακας

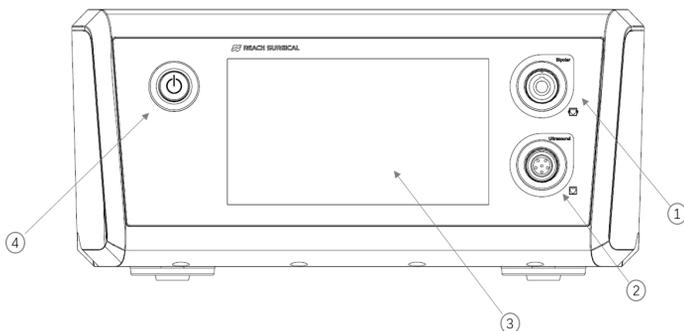

[01] Ηλεκτροχειρουργική υποδοχή

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προηγμένου διπολικού Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία ή ηλεκτροχειρουργικού διπολικού συνδέσμου.

[02] Μετατροπέας υποδοχή

Συνδέει το Μετατροπέας με το Γεννήτρια.


[03] Οθόνη αφής LCD

Εμφανίζει πληροφορίες συστήματος και χρησιμεύει ως διεπαφή για την προσαρμογή των χειριστήριων και των ρυθμίσεων.

[04] Διακόπτης λειτουργίας Κουμπί

Πιέστε για να ενεργοποιησετε το Γεννήτρια- πιέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιησετε.

Γεννήτρια Πίσω πάνελ

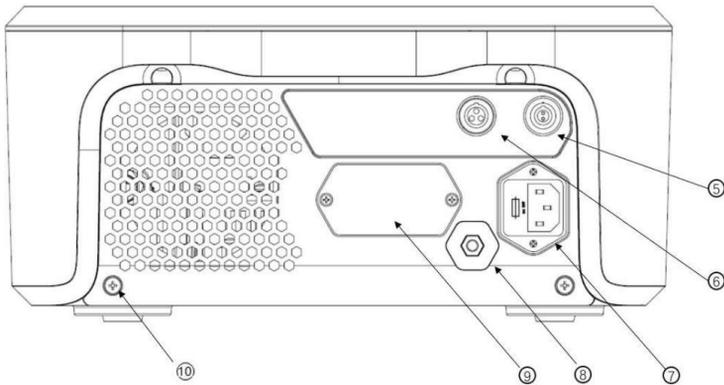

[05] Ηλεκτροχειρουργική υποδοχή ποδοδιακόπτη

Στρογγυλή πρίζα για τη σύνδεση του Ηλεκτροχειρουργικού Ποδοδιακόπτη.

[06] Υποδοχή διακόπτη ποδιού υπερήχων

Στρογγυλή υποδοχή για τη σύνδεση του ποδοδιακόπτη υπερήχων.

[07] Πρίζα ρεύματος

Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στο Γεννήτρια.

[08] Θύρα δυναμικής εξισορρόπησης

Εάν η γείωση της πρίζας ρεύματος είναι αβέβαιη, αυτή η θύρα επιτρέπει τη σύνδεση με προστατευμένη γείωση.

[09] Διεπαφή επέκτασης

Χρησιμοποιείται για επέκταση και συντήρηση λειτουργιών.

[10] Οπή τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες για το περιβάλλον λειτουργίας.

Αποσυσκευασία

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την παραλαβή των εξαρτημάτων.

- Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές από τη μεταφορά. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Reach Surgical, Inc ή τον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο (Για λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και κωδικούς προϊόντων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τεχνικές συνθήκες συστήματος"):

Μοντέλο	Περιγραφή	Στοιχείο
OP9	Γεννήτρια	Γεννήτρια, Καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγίες χρήσης
TRA6	Μετατροπέας	Μετατροπέας με καλώδιο
OP-FSD	Διακόπτης ποδιού υπερήχων	/
OP-FSS	Διπολικός διακόπτης ποδιού	/
OP-BPC	Βασικός διπολικός σύνδεσμος ενέργειας	/

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Κατά τη διάκριση της επιθεώρησης του εξοπλισμού, κρατήστε το άνω άκρο του οργάνου μακριά από άλλες συσκευές, χειρουργικές κουρτίνες, τον ασθενή ή άλλα αντικείμενα για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Εφαρμόστε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρουσία ατιμών, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του νοσοκομείου.

Ενέργεια υπερήχων με σειρά PD Ψαλίδι υπερήχων

- Συνδέστε το Μετατροπέας, τον ποδοδιακόπτη και τη σειρά PD Ψαλίδι υπερήχων στο Γεννήτρια.
- Αφού περάσετε τη δοκιμή Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων, ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος (1-5) χρησιμοποιώντας τα εικονίδια +/- στην οθόνη LCD.
- Πατήστε το κουμπί "Min" στο Ψαλίδι υπερήχων ή το πεντάλ Min στον ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε την ενέργεια υπερήχων στο προκαθορισμένο επίπεδο ισχύος.
- Πατήστε το κουμπί "Max" στο Ψαλίδι υπερήχων ή το πεντάλ Min στον διακόπτη ποδιού για να αποδώσετε το μέγιστο επίπεδο ενέργειας.
- Αφήστε το πλήκτρο ή τον ποδοδιακόπτη για να σταματήσετε την παραγωγή ενέργειας.

Ενέργεια υπερήχων με σειρά SRB/SRE Ψαλίδι υπερήχων

- Αφού περάσετε τη δοκιμή Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων, ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος (1-5) χρησιμοποιώντας τα εικονίδια +/- στην οθόνη LCD.
- Πατήστε το Κουμπί παροχής ενέργειας στο όργανο ή το κουμπί Min στο πεντάλ ποδιού για να ενεργοποιήσετε την ενέργεια υπερήχων στο

προκαθορισμένο επίπεδο ισχύος.

- Πατήστε το Κουμπί παροχής ενέργειας για προηγμένη αμόσταση στο όργανο για να ενεργοποιηστεί τη λειτουργία Προηγμένης αμόστασης.
- Αφήστε το κουμπί στο Ψαλίδι υπερήχων ή το κουμπί στο Διακόπτη ποδιών για να σταματήσετε την παροχή ενέργειας.

Ηλεκτροχειρουργική διπολική ενέργεια με προηγμένα διπολικά εργαλεία

- Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το εικονίδιο προηγμένου διπολικού συστήματος και το εικονίδιο ρυθμιζόμενου χειροκίνητου ελέγχου.
- Τραβήξτε το Μοχλός στο όργανο ή πατήστε το πεντάλ ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη ραδιοσυχνότητα.
- Το Γεννήτρια θα σταματήσει την παραγωγή ενέργειας όταν ολοκληρωθεί το κλείσιμο, γεγονός που υποδεικνύεται από το εικονίδιο ολοκλήρωσης στην οθόνη.
- Εάν η σύνδεση είναι ατελής, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος και θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό εικονίδιο.

Ηλεκτροχειρουργική διπολική ενέργεια με διπολικό ηλεκτροχειρουργικό όργανο

- Η οθόνη LCD εμφανίζει την τιμή ισχύος, ρυθμιζόμενα εικονίδια και μπάρες επιπέδου ισχύος.
- Οι ρυθμίσεις ισχύος κυμαίνονται από 1-95 Watt, με ρυθμιζόμενες αυξήσεις.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση εξόδου ισχύος: (15 Watt), Μέτρια (30 Watt) ή Υψηλή (60 Watt).
- Πατήστε το κουμπί στο χειροδιακόπτη ή στο πεντάλ ποδοδιακόπτη για να ενεργοποιηστεί τη ραδιοσυχνότητα.
- Αφήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την έξοδο ενέργειας.

Ρύθμιση συστάσεων

Ρυθμίσεις εφέ	Εύρος ρυθμίσεων ισχύος	Κλινική εφαρμογή	Βελτιστοποιημένη συσκευή
Χαμηλή	1-15 watts	Όπως νεύρα/σπονδυλική στήλη, χέρια και χειρουργική προσώπου	- Συσκευές με μικρότερες επιφάνειες - Λαβίδα με μικροσκοπικό άκρο (0,4 - 2,2 mm)
Μέσα	16-40 watts	Όπως η πήξη κατά τη διάρκεια της κεφαλής/λαιμού, της σπονδυλικής στήλης και της ανατομίας	- Συσκευές με μεσαία επιφάνεια - Λαβίδα με μικροσκοπικό άκρο (1,0 - 2,2 mm) - Μικρή λαπαροσκοπική λαβίδα με επίπεδη κεφαλή - Διπολικό ψαλίδι
Υψηλή	45-95 watts (αυξήσεις 5 watts)	Όπως κεφαλή/λαιμός και πλαστική χειρουργική (παρόμοια με το μεσαίο αποτέλεσμα, αλλά με ταχύτερο αποτέλεσμα)	- Συσκευές με μεγάλες επιφάνειες - Μεγάλη λαπαροσκοπική λαβίδα με επίπεδη κεφαλή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή με ουδέτερο ηλεκτρόδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υστέρι Ψαλίδι υπερήχων και το ηλεκτρικό υστέρι RF είναι εξαρτήματα που εφαρμόζονται σε επαφή με τον ασθενή.


Χρήση του Γεννήτρια

Ενεργοποιήστε τη συσκευή

- Το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία μόλις ενεργοποιηθεί. Όταν το Γεννήτρια είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και η λυχνία του διακόπτη αναμονής είναι αναμμένη, το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.
- Αφού πατήσετε το κουμπί αναμονής, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:



- Εάν δεν έχει συνδεθεί κανένα Μετατροπέας ή Ψαλίδι υπερήχων στο Γεννήτρια ή εάν είναι συνδεδεμένα εσφαλμένα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:

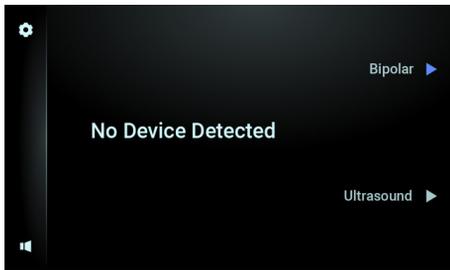


Χρήση οργάνου υπερήχων (Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων)


Όταν εντοπιστούν οι Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν η εναπομένουσα χρήση του Μετατροπέας είναι μικρότερη από 10, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα. Παρακαλούμε προεξέτε τον αριθμό των υπολειπόμενων χρήσεων, καθώς το Μετατροπέας πρέπει να αντικατασταθεί όταν ο αριθμός μηδενιστεί.

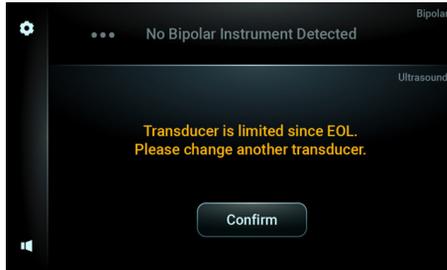


Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα, θα σας ζητηθεί να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο Ψαλίδι υπερήχων για να ξεκινήσει η δοκιμή Ψαλίδι υπερήχων με ανοιχτό Σιαγόνας.

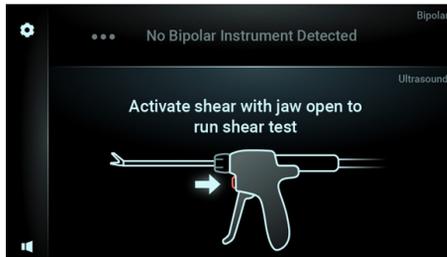

Πατήστε το κουμπί any και θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα.

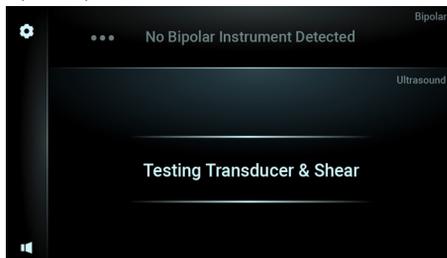


Όταν η δοκιμή Μετατροπέας αποτύχει, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:

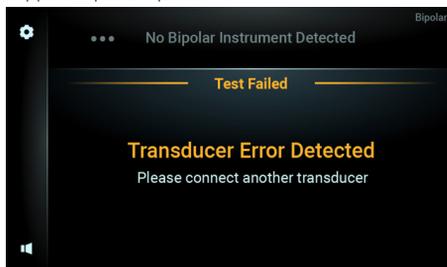


Όταν η δοκιμή Ψαλίδι υπερήχων αποτύχει, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα



Όταν η δοκιμή Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων περάσει, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:



Κατά τη σύνδεση του Ψαλίδι υπερήχων χωρίς τη λειτουργία Προηγμένη αιμόσταση θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη εργασίας.

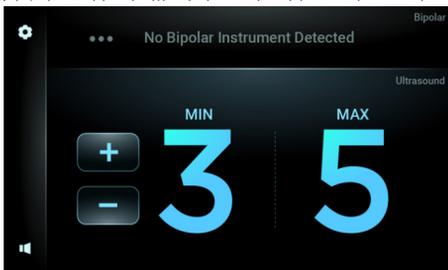


Κατά τη σύνδεση του SRE Ψαλίδι υπερήχων με το Advanced Hemostasis θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη εργασίας.




Η λειτουργία εξόδου θα επισημαίνεται ότι είναι ενεργοποιημένη.

Χρήση ηλεκτροχειρουργικού οργάνου


Όταν εντοπιστούν οι Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα.

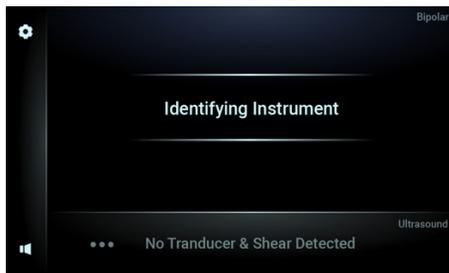


Όταν η δοκιμή του ηλεκτροχειρουργικού οργάνου περάσει, θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα:

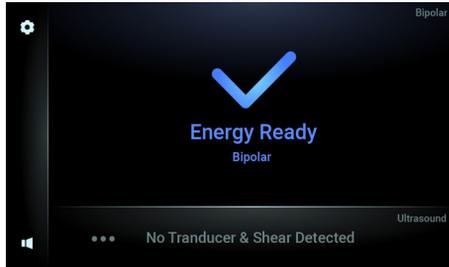

Κατά τη σύνδεση με προηγμένο διπολικό όργανο θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη εργασίας.



Κατά τη σύνδεση με κανονικό διπολικό όργανο θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη εργασίας.




Χρήση ηλεκτροχειρουργικού οργάνου και Ψαλίδι υπερήχων

Λάβετε υπόψη ότι όταν το Γεννήτρια είναι συνδεδεμένο τόσο σε ένα διπολικό ηλεκτροχειρουργικό όργανο όσο και σε ένα Ψαλίδι υπερήχων, το σύστημα λειτουργεί σε λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης για την εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης. Η συσκευή που έχει προτεραιότητα θα είναι η πρώτη που θα ενεργοποιήσει την ενέργεια. Αυτή η κατάσταση διαχωρισμένης οθόνης παρουσιάζεται παρακάτω:



Ρυθμίσεις συστήματος


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές ρυθμίσεων συστήματος:

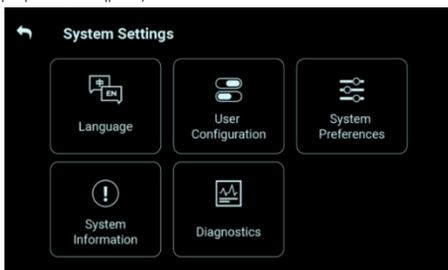


Γλώσσα: Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλώσσα και θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής γλώσσας:




Διαμόρφωση χρήστη: Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Διαμόρφωση χρήστη θα εμφανιστεί η οθόνη διαμόρφωσης χρήστη:

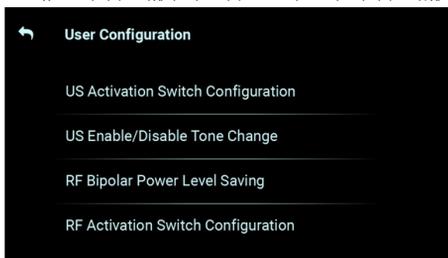


Προτιμήσεις συστήματος: Κάνοντας κλικ στο στοιχείο System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) θα εμφανιστεί η οθόνη προτιμήσεων συστήματος:



Πληροφορίες συστήματος: Πατήστε απαλά στο στοιχείο Πληροφορίες συστήματος για να εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών συστήματος:

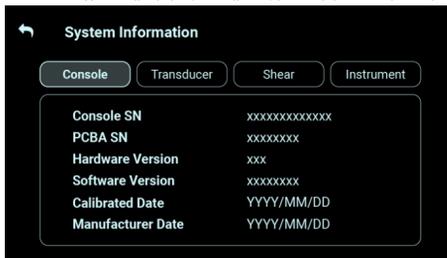

Διαγνωστικά: Κάντε κλικ στο στοιχείο Diagnostics (Διαγνωστικά) για να εμφανιστεί η οθόνη διαγνωστικών:

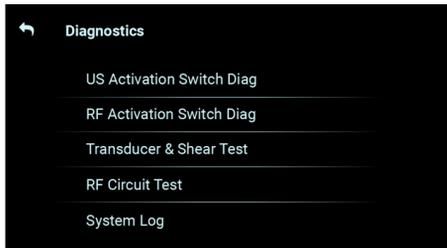

Για να βγείτε από τις ρυθμίσεις του συστήματος και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής του συστήματος, πατήστε το εικονίδιο "Επιστροφή" που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τερματίσετε με ασφάλεια το σύστημα:

Πατήστε το κουμπί αναμονής: Εντοπίστε το κουμπί αναμονής στο Γεννήτρια και πατήστε το για να ξεκινήσει η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας.

Αποσυνδέστε τα Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων: Αποσυνδέστε προσεκτικά το Μετατροπέας και το Ψαλίδι υπερήχων από το σύστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τον κατάλληλο χειρισμό των Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων.

Καθαρισμός: Καθαρίστε το Γεννήτρια, τον ποδοδιακόπτη και το Μετατροπέας σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο "Συντήρηση".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το Γεννήτρια ενσωματώνει διάφορα σήματα ειδοποίησης και κωδικούς σφάλματος για να βοηθήσει στον εντοπισμό και τη διάγνωση των βλαβών των εξαρτημάτων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα σήματα και οι κωδικοί έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την κλινική κρίση και παρατήρηση και όχι να τις αντικαθιστούν.

Ηχητική ειδοποίηση

Κατάσταση εργασίας	Τύπος ήχου	Πιθανή αιτία και δράση
Κατάσταση αυτοελέγχου	Κανονικός ήχος	/
	Ανώμαλος ήχος	Εντοπίστηκε σφάλμα υλικού. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για βοήθεια επισκευής.
Χρήση οργάνου υπερήχων	Μέγιστο επίπεδο ήχου	/
	Ελάχιστο επίπεδο ήχου	/
	Ανώμαλος ήχος	Το Ψαλίδι υπερήχων έχει έρθει σε επαφή με υπερβολικό ιστό. Μειώστε την επαφή του ιστού με το Ψαλίδι υπερήχων. Εάν ο συνεχής ήχος επιμένει, αφαιρέστε προσεκτικά κάθε ιστό που μπορεί να συσσωρευτεί γύρω από το άκρο του Ψαλίδι υπερήχων. Εντοπίστηκε σφάλμα στο Μετατροπέας ή/και στο Ψαλίδι υπερήχων. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη για περαιτέρω βοήθεια.
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ήχος	/
	Ήχος ITS	/
Ενεργοποίηση ηλεκτροχειρουργικού οργάνου	Προηγμένος διπολικός προειδοποιητικός τόνος	/
	Κανονικός διπολικός ήχος	/
	Ανώμαλος ήχος	Αποτυχημένη κοπή: Εάν ο ιστός που έρχεται σε επαφή με το όργανο δεν πληροί τις απαιτήσεις κοπής, μειώστε την ποσότητα του ιστού που έρχεται σε επαφή με το όργανο. Εάν ο τόνος σφάλματος επιμένει, απομακρύνετε προσεκτικά κάθε ιστό που μπορεί να συσσωρευτεί στο άκρο του οργάνου. Αποτυχία υλικού: Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει μια πιθανή βλάβη στο κύκλωμα ή στον σύνδεσμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή σφάλματος, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή να αναζητήσετε υποστήριξη για κατάλληλη καθοδήγηση και επίλυση.

Κωδικός σφαλμάτων

H Energy Platform Γεννήτρια είναι εξοπλισμένη με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναγνώρισης σφαλμάτων που αποτελείται από ειδοποιήσεις και σφάλματα συστήματος. Όταν ανιχνεύεται σφάλμα, το Γεννήτρια εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο, εμφανίζει ένα προειδοποιητικό σήμα στον πίνακα ελέγχου και εμφανίζει έναν αντίστοιχο κωδικό σφάλματος στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Πίνακας κωδικών σφαλμάτων

Κωδικός σφάλματος	Αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος
Προειδοποίηση	Συνδέστε σωστά το Ψαλίδι υπερήχων με το Μετατροπέας
Προειδοποίηση	Βεβαιωθείτε ότι το Σιαγόνας είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των δοκιμών
Προειδοποίηση	Ψαλίδι υπερήχων Εντοπίστηκε σφάλμα
Προειδοποίηση	Ο υπολειπόμενος χρόνος του Μετατροπέας είναι μηδέν
Προειδοποίηση	Ενεργοποιήστε μόνο ένα κουμπί κάθε φορά
Προειδοποίηση	Μειώστε τη δύναμη που ασκείται στο Ψαλίδι υπερήχων
Προειδοποίηση	Το κουμπί Ψαλίδι υπερήχων και ο ποδοδιακόπτης δεν μπορούν να κλείσουν ταυτόχρονα
Προειδοποίηση	Το κουμπί έχει κολλήσει, παρακαλούμε ελέγξτε και συνεχίστε
Προειδοποίηση	Ρυθμίστε το Σιαγόνες ή σφίξτε λιγότερο ιστό
Προειδοποίηση	Αφαιρέστε τη συσκευή από τους ιστούς
Σφάλμα συστήματος	Σφάλμα συστήματος
Σφάλμα συστήματος	Αυτοέλεγχος απέτυχε

Εάν εμφανιστεί σφάλμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:



- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Μετατροπέας είναι πλήρως τοποθετημένο προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Ελέγξτε αν το Ψαλίδι υπερήχων έχει σφίξει σωστά ή αν έχει συσσωρευτεί ιστός γύρω από το άκρο του Ψαλίδι υπερήχων. Ρυθμίστε τη στενάνοτητα του Ψαλίδι υπερήχων και αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν συσσώρευση ιστού γύρω από το περιβλήμα του Ψαλίδι υπερήχων. (Εάν η δοκιμή ξεκινάει πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το Ψαλίδι υπερήχων είναι στραμμένο προς τον αέρα. Εάν χρησιμοποιείται το Ψαλίδι υπερήχων, επιβεβαιώστε ότι η σιαγόνα σφισφίξης είναι ανοικτή και δεν έρχεται σε επαφή με αντικείμενα).
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Μετατροπέας ή του Ψαλίδι υπερήχων.
- Προχωρήστε στην κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Μετατροπέας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν η θερμοκρασία του υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε αμέσως ένα άλλο Μετατροπέας για αποκατάσταση ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσδιορίσετε την αιτία του σφάλματος και να διερευνήσετε προαιρετικές μεθόδους αποκατάστασης:
- Αφήστε το Μετατροπέας να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 45 λεπτά. Αυτή η μέθοδος φύξης ισχύει επίσης εάν το Μετατροπέας ζεσταθεί μετά από παρατεταμένη λειτουργία σε υψηλή ισχύ.
- Εάν δεν είναι εμφανής η υπερθέρμανση Μετατροπέας και το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους συντήρησης του κατασκευαστή για βοήθεια.
- Εκτός από τις ασφάλειες, το Γεννήτρια δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη. Για τυχόν απαιτήσεις αντικατάστασης ή σέρβις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις που είναι εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την Reach Surgical, Inc. ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Η συντήρηση και οι αναβαθμίσεις του Γεννήτρια πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό σέρβις εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την Reach Surgical.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόφύλαξης στον κυβερνοχώρο για την αποτροπή πιθανών απειλών. Τα ακόλουθα περιστατικά ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

- Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προϊόντα που δεν σχετίζονται με τη συσκευή.
 - Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επικοινωνία δικτύου με τη συσκευή.
 - Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού ή λογισμικού που δεν έχουν εγκριθεί από την Reach Surgical.
- Σε περίπτωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω περιστατικά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Reach Surgical, Inc. ή απευθυνθείτε απευθείας στην Reach Surgical, Inc. στη διεύθυνση Reachquality@reachsurgical.com.

Συντήρηση

Καθαρισμός και απολύμανση του συνδέσμου Γεννήτρια και του βασικού διπολικού συνδέσμου ενέργειας

Καθαρισμός

Καθαρίστε την οθόνη LCD Γεννήτρια και τον βασικό διπολικό σύνδεσμο Basic σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του νοσοκομείου. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η κύρια παροχή ρεύματος του Γεννήτρια έχει αποσυνδεθεί και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί από τη μονάδα εξόδου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο Γεννήτρια, η πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή η δημιουργία κινδύνων πυρκαγιάς. Μην ρίχνετε ή εκτοξεύετε υγρά πάνω ή μέσα στο Γεννήτρια και μην το βυθίζετε σε υγρά.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό:

- Ετοιμάστε ένα απορρυπαντικό ουδέτερου pH ή ένα ενζυμικό απορρυπαντικό ουδέτερου pH, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό πανί εμποτισμένο με μικρή ποσότητα καθαριστικού διαλύματος, σκουπίστε με το χέρι όλες τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης Γεννήτρια.
- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό, μαλακό πανί εμποτισμένο με ζεστό νερό βρύσης.
- Τέλος, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό, μαλακό πανί για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνές.

Απολύμανση

- Εάν το Γεννήτρια μολυνθεί με αίμα ή σωματικά υγρά, πρέπει να απολυμανθεί πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Τα ακόλουθα χημικά

απολυμαντικά έχουν επικυρωθεί για χρήση στο Γεννήτρια: 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, 6% υποχλωριώδες νάτριο, 10% υπεροξειδίου του υδρογόνου.

- Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη σωστή χρήση, τη συγκέντρωση και το χρόνο επαφής των απολυμαντικών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι απολυμαντήρες διαμορφώνονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός του ποδοδιακόπτη

Καθαρίστε το διακόπτη ποδιού και το καλώδιο μετά από κάθε χρήση με την ακόλουθη διαδικασία:

- Απουσνδέστε τον ποδοδιακόπτη από το Γεννήτρια.
- Ετοιμάστε ένα ενζυμικό απορρυπαντικό ουδέτερου pH σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνδέστε το καλώδιο με ασφάλεια με τον ποδοδιακόπτη και βυθίστε τα στο διάλυμα καθαρισμού για 2 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ποδοδιακόπτη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του Γεννήτρια είναι τελείως στεγνό για να αποφευχθεί η τυχαιά ενεργοποίηση.

- Μετά την εμβάπτιση, τρίψτε χειροκίνητα τον ποδοδιακόπτη και το καλώδιο με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες στο διάλυμα καθαρισμού.
- Ξεπλύνετε σχολαστικά τον ποδοδιακόπτη και το καλώδιο με ζεστό νερό βρύσης για τουλάχιστον 1 λεπτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το καλώδιο και τον ποδοδιακόπτη καλά συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος.

- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανήμα καθαρισμού υπερήχων για να καθαρίσετε τον διακόπτη ποδιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος του Γεννήτρια πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγνές πριν από τη συναρμολόγηση.

Καθαρισμός και απολύμανση του Μετατροπέα

Οι Μετατροπέας αποστέλλονται μη αποστειρωμένα και απαιτούν σχολαστικό καθαρισμό και αποστείρωση πριν από κάθε χρήση.

Καθάρισμα:

Καθαρίστε καλά τους μετατροπέες σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

- Ξεπλύνετε τον μορφοτροπέα με τη βίδα προς τα πάνω και καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα με φιλτραρισμένο νερό μέχρι να μην υπάρχουν υπολείμματα στην επιφάνεια.
- Ο μορφοτροπέας μπορεί να βυθιστεί σε ένα pH ουδέτερο ενζυμικό απορρυπαντικό (Κύρια συστατικά: πρωτεάση λπλάση αμυλάση κυτταρινάση πηκτινάση και άλλων βιολογικών ενζύμων, φιλικό προς το περιβάλλον, με παράνοια πρόληψης της σκουριάς και σταθεροποιητή) για χρονικό διάστημα έως 10 λεπτά και σε μία κατάλληλη θερμοκρασία 15°C ~ 65°C. Η αναλογία απορρυπαντικού και αποιονισμένου νερού είναι 1:400.

- Ξεπλύνετε τον μορφοτροπέα με τη βίδα προς τα πάνω με υπερκαθαρό νερό για 2 λεπτά.

- Καθαρίστε τη βίδα σύνδεσης, την επιφάνεια στήριξης νυστεριού και το βύσμα με ένα ματηλί εμποτισμένο σε αλκοόλη.

- Μουλιάστε τον μορφοτροπέα σε ιατρικό αλκοόλ 75% και κρατήστε το και ανακινήστε το για 30 φορές.

- Ξεπλύνετε τον μορφοτροπέα με τη βίδα προς τα πάνω με υπερκαθαρό νερό για 2 λεπτά.

Σημείωση: Η χρήση υπερηχητικών καθαριστικών δεν συνιστάται για τον μορφοτροπέα.

Ξήρανση:

Θερμοκρασία στεγνώματος: 50 ~ 70°C, Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά.

Αποστείρωση μορφοτροπέα:

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα καθαρισμού και στεγνώματος, ο μορφοτροπέας πρέπει να αποστειρώνεται με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω.

Αποστείρωση με ατμό (121°C)

- Τοποθετήστε τη θηκάκια πριν από την αποστείρωση. Ο μορφοτροπέας πρέπει να τυλιγτεί κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης. Τοποθετήστε τους μετατροπέες σε δοχείο αποστείρωσης ατμού υψηλής θερμοκρασίας για αποστείρωση, με θερμοκρασία 121°C και διάρκεια 30 λεπτών.
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 50 ~ 70°C, Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά.

Αποστείρωση με ατμό (134°C)

- Τοποθετήστε τη θηκάκια πριν από την αποστείρωση. Ο μορφοτροπέας πρέπει να τυλιγτεί κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης. Τοποθετήστε τους μετατροπέες σε δοχείο αποστείρωσης ατμού υψηλής θερμοκρασίας για αποστείρωση, με θερμοκρασία 134°C και διάρκεια 10 λεπτών.
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 50 ~ 70°C, Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά.

Δοκιμές ασφαλείας και λειτουργίας

Διασφαλίστε την εφαρμογή των δοκιμών ασφαλείας και λειτουργικότητας για τα Μετατροπέας, Γεννήτρια και Foot Switch σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς του νοσοκομείου. Για τις δοκιμές ασφαλείας και λειτουργίας άλλων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται από πολλούς ασθενείς, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το κάθε εξάρτημα.

Δοκιμή ασφαλείας

Γεννήτρια: Οι πιστοποιημένοι νοσοκομειακοί τεχνικοί πρέπει να εκτελούν δοκιμή ρεύματος διαρροής.

Διακόπτης ποδιού: Ελέγξτε το πεντάλ, τον σύνδεσμο του καλωδίου και το καλώδιο για τυχόν ρωγμές ή ζημιές. Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Άλλα συστατικά: Ελέγξτε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων οδηγιών λειτουργίας τους.

Λειτουργική δοκιμή

Λειτουργία υπερήχων

- Προετοιμάστε το πλήρες σετ PD Ψαλίδι υπερήχων και συνδέστε το Μετατροπέας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο II - Εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε αν είναι δυνατή η εισόδος στη διαστάση εργασίας. Διαφορετικά Ψαλίδι υπερήχων μπορεί να έχουν διαφορετικές διαεπαφές εισόδου. Ανατρέξτε στο μέρος 1, ενότητα 3 του κεφαλαίου 2 για λεπτομερείς οδηγίες.
- Επιβεβαιώστε την εμφάνιση των επιπέδων MIN power Level 3 και MAX power Level 5.
- Πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης ισχύος για να διασφαλίσετε ότι το επίπεδο ισχύος MIN μπορεί να ρυθμιστεί από τα επίπεδα 1 έως 5.
- Ενεργοποιήστε το Γεννήτρια και θέστε το σε λειτουργία λειτουργίας υπερήχων. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των Μετατροπέας και Ψαλίδι υπερήχων.
- Με τη σιαγόνα ανοιχτή, πατήστε το κουμπι "MAX" στον ποδοδιακόπτη. Στην οθόνη LCD θα πρέπει να εμφανιστεί το επίπεδο ισχύος MAX "5" και θα πρέπει να ακουστεί ένας ήχος ενεργοποίησης.
- Με τη σιαγόνα ανοιχτή, πατήστε το κουμπι "MIN" στον ποδοδιακόπτη. Στην οθόνη LCD θα πρέπει να εμφανιστεί το επίπεδο ισχύος MIN και θα πρέπει να ακουστεί ένας ήχος ενεργοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση του συστήματος, βεβαιωθείτε ότι η σιαγόνα βρίσκεται μακριά από ιστούς, άλλα όργανα ή άλλα αντικείμενα για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη.

Διπολική ηλεκτροχειρουργική λειτουργία

- Συνδέστε το προηγμένο διπολικό ηλεκτροχειρουργικό όργανο/Βασικό διπολικό όργανο σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Ελέγξτε αν ο σύστημα μπορεί να εισέλθει στη διαεπαφή εργασίας. Η βασική διπολική λειτουργία θα πρέπει να εμφανίσει το εικονίδιο του επιπέδου ισχύος 30, ενώ η προηγμένη διπολική λειτουργία θα πρέπει να εμφανίζει το εικονίδιο "προηγμένο διπολικό".
- Αγγίξτε ελαφρά τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης ισχύος στη βασική διπολική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε ότι το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 95. Αγγίξτε τις μπάνες Low (Χαμηλή), Medium (Μέτρια) και High (Υψηλή) για να μεταβείτε απευθείας μεταξύ 15, 30 και 60.
- Απενεργοποιήστε το Γεννήτρια και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος του Γεννήτρια και περιμένετε

για 10 δευτερόλεπτα. Ελέγξτε εάν στη βασική διπολική λειτουργία εμφανίζεται η διαπαφή ή διαπαφή επιπέδου ισχύος 30 και στη προηγμένη διπολική λειτουργία εμφανίζεται η διαπαφή "προηγμένη διπολική". Ελέγξτε εάν το Γεννήτρια έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις.

- Συνδέστε το προηγμένο και το βασικό διπολικό Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία και πατήστε τον μονό ποδοκιβώτιο. Ελέγξτε αν αναβοβλύνουν οι ενδείξεις στάθμης ισχύος στον πίνακα ελέγχου και ακούστε τον ήχο ενεργοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΤΗΡΙΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση του συστήματος, απαγορεύεται αυστηρά να επιτρέψετε οποιαδήποτε επαφή του Ψαλιδι υπερίχων με ιστούς, άλλα όργανα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Σύστημα που σχετίζεται με το σύστημα

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις υσοκομειακές οδηγίες για την κλινική πρακτική για χειρουργική με υπερίχων, ηλεκτροχειρουργική, γυναικολογία και λαπαροσκοπηση.
- Οι ελαστικές επεμβατικές συσκευές μπορεί να διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Εάν σε μια χειρουργική επέμβαση χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ελαστικές επεμβατικές εργαλεία και εξαρτήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές, ελέγξτε τη συμβατότητα των εργαλείων και των εξαρτημάτων πριν από την επέμβαση και ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα που εισάγονται στο ανθρώπινο σώμα έχουν τραχιά επιφάνεια, αιχμηρή άκρη ή προεξοχή που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους χειρουργούς. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροχειρουργικές συσκευές εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση τους για τη συγκεκριμένη επέμβαση που θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε. Η μη εκπαιδευμένη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ακούσιο σοβαρό τραυματισμό στον ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της διάρτησης του εντέρου και της μη συνειδητής και ανεπαρκούς νέκρωσης ιστών.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα του Γεννήτρια χωρίς άδεια για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας. Οποιαδήποτε επισκευή και αναβάθμιση του οργάνου πρέπει να εκτελείται από άτομο σέρβης εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την Reach Surgical, Inc. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το όργανο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ιατρική χειρουργική.
- Η βαθιά κατανόηση των αρχών και των τεχνικών που εμπλέκονται στις διαδικασίες λείζερ, ηλεκτροχειρουργικής και υπερίχων είναι απαραίτητη για την αποφυγή κινδύνων ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων τόσο για τον ασθενή όσο και για το ιατρικό προσωπικό, καθώς και ζημιών σε αυτή τη συσκευή ή σε άλλες ιατρικές συσκευές. Η ηλεκτρική μόνωση ή η γείωση δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο. Μην βυθίζετε τις ηλεκτροχειρουργικές συσκευές σε υγρά, εκτός εάν ο σχεδιασμός το απαιτεί και η επισήμανση αναφέρει ότι πρέπει να βυθίζονται.
- Η σφάλης και αποτελεσματική χειρουργική με υπερίχων και η ηλεκτροχειρουργική εξαρτώνται όχι μόνο από τον σχεδιασμό του εξοπλισμού αλλά και σε μεγάλο βαθμό από πολλούς παράγοντες που ελέγχονται από τον χειριστή. Για να βελτιστοποιήσετε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Όπως συμβαίνει με τις πηγές ενέργειας (ηλεκτροχειρουργική, λείζερ ή υπερίχων), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καρδιογενείς και η μολυσματικοί κίνδυνοι που μπορεί να παρουσιάζουν πολλά υποπροϊόντα των ιστών, όπως ο καπνός και τα αερολύματα. Τόσο στις ανοικτές όσο και στις ενδοσκοπικές διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες προφυλάξεις, όπως γυαλιά ασφαλείας, μάσκες φίλτρου αερίων και αποτελεσματικός εξοπλισμός εκκένωσης του καπνού.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευής, ελέγξτε τον ιστό για αιμόσταση. Εάν δεν υπάρχει αιμόσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μέθοδοι για την επίτευξη αιμόστασης.
- Προϊόντα που κατασκευάζονται ή διανέμονται από εταιρείες που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Reach Surgical, Inc. ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή. Η χρήση τέτοιων προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα αποτελέσματα και να τραυματίσει τον χρήστη ή τον ασθενή.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος παρεμβολών, η συσκευή και το κέλυφος πρέπει να συνδόνται σε ανεξάρτητο κύκλωμα προφροδοσίας.
- Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση παρουσία εύφλεκτου αερίου με αέρα ή με οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Πιθανότητα πρόκλησης σπινθήρα λόγω σύγκρουσης με άλλες μεταλλικές συσκευές. Οι σπινθήρες ενδέχεται να αναφλέξουν εύφλεκτα αέρια, όπως αέρια πεδίου.
- Πρέπει να λειτουργεί εντός του απαιτούμενου εύρους θερμοκρασιών λειτουργίας περιβάλλοντος.
- Η τάση της πρίζας εξόδου πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Γεννήτρια (κεφάλαιο "Τεχνικές συνθήκες συστήματος"). Εάν η παροχή ρεύματος δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο Γεννήτρια και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς.
- Μην μετατρέψετε τον ήχο ενεργοποίησης σε μη ακουστό επίπεδο. Οι τόνοι ενεργοποίησης μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από το προσωπικό της χειρουργικής ομάδας ενώ το Γεννήτρια παρέχει ενέργεια.
- Έχει αποδειχθεί ότι ο καπνός που παράγεται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροχειρουργικής επέμβασης είναι δύσκολο επεκίνωμο για τους ασθενείς ή το προσωπικό της χειρουργικής ομάδας. Προτείνεται επαρκή εξαερισμό με χειρουργικό απορροφητήρα καπνού ή άλλα μέσα.
- Υπάρχουν ορισμένα εξαρτήματα του ολοκληρωμένου χειρουργικού υπερίχων Γεννήτρια που αποστέλλονται μη αποστειρωμένα (π.χ. Μετατροπέας). Αποστειρώστε το προϊόν όπως απαιτείται πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του συστήματος. Για όποιον καθαρισμό και αποστείρωση, ανατρέξτε σε κάθε σχετική οδηγία.
- Για την αποφυγή τραυματισμού των χρηστών ή των ασθενών, το Ψαλίδι υπερίχων πρέπει να αποφεύγει άλλες συσκευές, χειρουργικές κουρτίνες, ασθενείς ή άλλα αντικείμενα πριν πατήσετε το κουμπί δοκιμής και κατά τη διάρκεια του ελέγχου του συστήματος. Τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση αερολύματος (σύμφωνα με τους κανονισμούς του υσοκομείου) πρέπει να εφαρμόζονται στη μέθοδο ελέγχου και δοκιμής του συστήματος.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη γνάθο για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της παροχής ενέργειας υπερίχων.
- Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη, η λεπίδα πρέπει να αποφεύγει την επαφή με ιστό, άλλες συσκευές ή άλλα αντικείμενα πριν από την ενεργοποίηση του συστήματος.
- Εάν εκτοξευθεί ή χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο Γεννήτρια ή εάν το Γεννήτρια χυθεί ή χυθεί μέσα στο υγρό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο Γεννήτρια και να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Ο σπινθηρισμός και η θέρμανση που σχετίζονται με τις τεχνικές κλεισμάτων των δοχείων μπορούν να αποτελέσουν πηγές ανάφλεξης. Η γάζα και το σφουγγάρι πρέπει να παραμείνουν υγρά. Κρατήστε τα ηλεκτροχειρουργικά ηλεκτρόδια μακριά από εύφλεκτα υλικά και περιβάλλοντα πλούσια σε οξυγόνο (O2).
- Όταν σχηματίζονται σημαντική ζημιά στο Μετατροπέας ή αν κάποια εξαρτήματα παρουσιάζουν σημάδια ζημιάς μετά τον καθαρισμό και τη συντήρηση απολάνιασης, απορρίψτε τα. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα επισπώνονται σαφώς για την αποφυγή κακής χρήσης πριν από τον επόμενο χειρισμό.
- Τα απορρίμματα μίας χρήσης και τα ηλεκτρονικά απορρίμματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του υσοκομείου και δεν πρέπει να απορρίπτονται κατά βούληση για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Αποφύγετε τη χρήση του Γεννήτρια κοντά ή στοίβαγμα τους πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση δίπλα ή στοίβαγμα, παρακολουθείτε το Γεννήτρια και τον άλλο εξοπλισμό για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.
- Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χειριστή. Για σέρβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Reach Surgical ή με το προσωπικό σέρβης.
- Ελέγξτε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και τις συνδέσεις πριν από τη χρήση. Επικυρώστε ότι η συσκευή λειτουργεί όπως προβλέπεται. Η ακατάλληλη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία τόξου, σπινθήρα, δυσλειτουργία της συσκευής ή ανεπιθύμητα χειρουργικά αποτελέσματα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή με προστατευτική γείωση.
- Κρατήστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του Γεννήτρια και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. οθόνες). Μην διασταυρώνετε ή συνδέετε ηλεκτρικά καλώδια με ηλεκτρονικές συσκευές. Το Γεννήτρια ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσήχη παρουσία εσωτερικών και εξωτερικών βηματοδότη. Οι παρεμβολές που προκαλούνται από τη χρήση του Ηλεκτροχειρουργικά Εργαλεία μπορεί να προκαλέσουν την είσοδο του βηματοδότη σε ασύγχρονη κατάσταση ή να εμποδίσουν εντελώς τη λειτουργία του βηματοδότη. Όταν οι συσκευές ηλεκτροχειρουργικής ή σφράγισης ιστών προορίζονται για χρήση σε ασθενείς με καρδιακό βηματοδότη, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή με το καρδιολογικό τμήμα του υσοκομείου για πρόσθετες πληροφορίες.
- Να είστε προσεκτικοί αν στοίβαζετε όργανα πάνω στο Γεννήτρια ή αν τοποθετείτε το Γεννήτρια πάνω σε ηλεκτρικά όργανα. Αυτή είναι μια ασταθής

διαμόρφωση και δεν παρέχει επαρκή ψύξη.

- Εάν το Γεννήτρια αποτύχει, μπορεί να προκληθεί διακοπή της χειρουργικής επέμβασης. Πρέπει να υπάρχει εφεδρικό σύστημα.
- Εάν απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς, το Γεννήτρια θα πρέπει να συνδεθεί στον ισοδυναμικό σύνδεσμο του νοσοκομείου με τη χρήση ισοδυναμικού καλωδίου.
- Όταν το σύστημα και ο εξοπλισμός φυσιολογικής παρακολούθησης χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο ασθενή, κάθε ηλεκτρόδιο παρακολούθησης πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο μακριά από το όργανο.
- Στη βασική διπολική λειτουργία, επιλέξτε τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ εξόδου για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Η βλάβη του χειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητη αύξηση της ισχύος εξόδου.
- Ο σύνδεσμος Γεννήτρια και ο βασικός διπολικός ηλεκτροχειρουργικός σύνδεσμος μπορεί να προσβληθεί από νερό ή σωματίδια. Κατά τη διαδικασία χρήσης και καθαρισμού, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η εισχώρηση νερού ή σωματιδίων.
- Όταν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ενδοσκοπείο, ενδέχεται να αυξηθεί το ρεύμα διαρροής στο σώμα του ασθενούς. Δώστε προσοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Μια ειδοποίηση προς τον χρήστη ή/και τον ασθενή ότι κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στην Reach Surgical, Inc. μέσω της διεύθυνσης Reachquality@reachsurgical.com. και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Όργανο που σχετίζεται με το όργανο

Κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ακραίο τμήμα του οργάνου Ψαλίδι υπερήχων, του μαξιλαριού Ψαλίδι υπερήχων και του Άξονα μπορεί να παρουσιάσει αυξημένες θερμοκρασίες όταν εφαρμόζονται υπερήχοι ή διπολικός ηλεκτροκαυτηριασμός σε ιστό για παρατεταμένες περιόδους. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί τυχαία επαφή μεταξύ αυτών των εξαρτημάτων του οργάνου και ιστών, χειρουργικών πετσετών, χειρουργικών χιτώνων ή οποιουδήποτε άσχετου περιχώρου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του διπολικού οργάνου. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά ή σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως γάζες ή χειρουργικές πετσέτες. Τα διπολικά όργανα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να παράγουν θερμότητα κατά τη χρήση, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Όταν το διπολικό ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο Γεννήτρια δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται κατάλληλα στο προστατευτικό περίβλημα ή να φυλάσσεται σε ασφαλή απόσταση από τον ασθενή, τα μέλη της χειρουργικής ομάδας και τυχόν εύφλεκτα υλικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης για πρόσθετες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Πληροφορίες EMC

Το προϊόν έχει περάσει τη δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, η οποία πληροί τις απαιτήσεις περιορισμού του προτύπου IEC60601-1-2 για ιατρικό εξοπλισμό. Αυτοί οι περιορισμοί παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κανονικές ιατρικές εγκαταστάσεις.

Σύνθεση προϊόντος

Σειριακός αριθμός	Όνομα εξαρτήματος	Μοντέλο/έκδοση αριθ.	Παρατηρήσεις
1	Ηλεκτροχειρουργικό όργανο	OP9	/
2	Μετατροπέας της γεννήτριας υπερήχων	TRA6	Συμβατή χρήση
3	Ψαλίδι υπερήχων Σύστημα για μία χρήση Ψαλίδι υπερήχων	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Συμβατή χρήση
4	Χειρουργική μονάδα υπερήχων υψηλής συχνότητας μίας χρήσης Σφραγιστικό ιστών	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ποδοδιακόπτης υπερήχων	OP-FSD	/
6	Ποδοδιακόπτης Ηλεκτροχειρουργικής	OP-FSS	/
7	Διπολικός σύνδεσμος ηλεκτροχειρουργικής	OP-BPC	/

Καλώδιο προϊόντος

Σειριακός αριθμός	Όνομα καλωδίου	Μήκος (m)	Θωρακισμένο
1	Καλώδιο ελέγχου ποδιών	3	Ναι
2	Καλώδιο τροφοδοσίας	5	Όχι
3	Διπολικό ηλεκτροχειρουργικό καλώδιο	3	Όχι
4	Το καλώδιο Μετατροπέας	2.9	Ναι

Επιδόσεις EMC

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές ραδιοσυνοτήτων που προκαλούνται από άλλο ιατρικό εξοπλισμό και ραδιοεπικοινωνίες. Για την αποφυγή τέτοιων παρεμβολών, το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2 και πληροί τις απαιτήσεις του. Ωστόσο, η Reach Surgical, Inc. δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν απολύτως καθόλου παρεμβολές σε μεμονωμένα περιβάλλοντα εγκαταστάσεων.

Εάν διαπιστωθεί ότι η συσκευή δέχεται παρεμβολές (οι οποίες μπορούν να προοριστούν με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής), ο χρήστης (ή το προσωπικό συντήρησης που έχει εγκριθεί από την Reach Surgical, Inc.) θα πρέπει να προσπαθήσει να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος παρεμβολών:

Ρυθμίστε την κατεύθυνση ή τη θέση της συσκευής που την επηρεάζει.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ αυτής της συσκευής και της συσκευής αποστολής.

Χρησιμοποιήστε άλλες πηγές ενέργειας (και όχι την ενέργεια που χρησιμοποιείται για να επηρεάσει τον εξοπλισμό) για την τροφοδοσία αυτού του εξοπλισμού.

Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις για άλλες προτάσεις.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν παρεμβολές που προκαλούνται από τις ακόλουθες καταστάσεις: χρήση άλλων καλωδίων διασύνδεσης εκτός των συνιστάμενων καλωδίων, μετατροπή ή τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού χωρίς άδεια. Οι μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού.

Όλοι οι τύποι ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό μέσω του αέρα ή άλλων καλωδίων που είναι συνδεδεμένα με αυτόν. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που μπορούν να εκπέμπουν σήματα RF, όπως κινητά τηλέφωνα, ραδιοπομπέδες ή προϊόντα ραδιοελέγχου, κοντά σε αυτή τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την απουχία της απόδοσης αυτής της συσκευής να μην πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές. Όταν τέτοιες συσκευές βρίσκονται κοντά σε αυτή τη συσκευή, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία αυτών των συσκευών. Το ιατρικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για αυτή τη συσκευή θα πρέπει να καθοδηγήσει τους τεχνικούς, τους ασθενείς και το λοιπό προσωπικό που μπορεί να βρίσκεται κοντά σε αυτή τη συσκευή να συμμορφώνονται πλήρως με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Για να επιτευχθεί πλήρως η καθορισμένη απόδοση ΗΜΣ, ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει το προϊόν σωστά σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται

στο χειρίδιο. Εάν υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την ΗΜΣ, επικοινωνήστε με το προσωπικό συντήρησης που έχει εγκριθεί από την Reach Surgical, Inc.

Τα Μετατροπείς (με καλώδια) και Ψαλίδι υπερήχων ορίζονται ως το εφαρμοσμένο μέρος του όλου συστήματος.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση του προϊόντος

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αλλά δεν περιλαμβάνει χώρους θωράκισης ραδιοσυχνότητας γύρω από ενεργό χειρουργικό εξοπλισμό ραδιοσυχνότητας ή σε χώρους όπου τοποθετείται εξοπλισμός κρούσης μαγνητικού συντονισμού, επειδή η ένταση των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών σε αυτές τις θέσεις είναι υψηλή.

Απόσταση διαχωρισμού και επιπτώσεις σταθερού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας: η ένταση του μαγνητικού πεδίου που παράγεται από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμίο βάσης ασύρματων (κυψελωτών/ασύρματων) τηλεφώνων, κινητοί ραδιοφωνικοί δέκτες, ραδιοερασιτεχνικοί δέκτες, ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM, τηλεοπτικές εκπομπές Γεννήτριας Κ.Λπ, δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια θεωρητικά. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από σταθερούς πομπούς RF, θα πρέπει να εξεταστεί η μέτρηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Εάν η μετρούμενη τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου στη θέση της συσκευής υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο ραδιοσυχνότητας που καθορίζεται στη "Δήλωση κατά των παρεμβολών", η συσκευή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Εάν διαπιστωθούν μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετες μετρήσεις, όπως ο επαναπροσανατολισμός ή η μετεγκατάσταση της συσκευής ή η χρήση ενός διαμοιχτή κατά των ραδιοσυχνότητων.

1) Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται ή έχει οριστεί από την Reach Surgical, Inc. Τα προϊόντα που είναι εξοπλισμένα με φινιρίσματα πρέπει να συνδέονται σε σταθερή πρίζα ρεύματος με προστατευτική γείωση. Μην χρησιμοποιείτε κανέναν τύπο προσαρμογέα ή συνδετήρα για να συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας.

2) Κρατήστε αυτή τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

3) Ακολουθήστε τα βήματα για να συνδέσετε τη συσκευή.

Γενικές σημειώσεις

(1) Οι προδιαγραφές του καλωδίου.

Η χρήση καλωδίων που παρέχονται από την Reach Surgical, Inc. δεν θα βλάψει την απόδοση EMC αυτού του προϊόντος. Εάν χρησιμοποιηθούν μη καθορισμένα καλώδια, η απόδοση ΗΜΣ αυτού του εξοπλισμού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

(2) Προφυλάξεις για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις

Ο χρήστης δεν πρέπει να τροποποιεί αυτό το προϊόν, διαφορετικά η απόδοση ΗΜΣ αυτού του προϊόντος μπορεί να μειωθεί.

Η τροποποίηση του προϊόντος περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

a. Καλώδια (μήκος, υλικό και καλωδίωση κ.λπ.).

b. Εγκατάσταση/διάταξη εξοπλισμού.

c. Διαμόρφωση εξοπλισμού/στοχείου.

d. Μέρη προστασίας του εξοπλισμού (μέρη ανοίγματος/κλεισίματος του καλύμματος και μέρη στερέωσης του καλύμματος).

(3) Όλα τα προστατευτικά καλύμματα θα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Αυτό το προϊόν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται κατωτέρω και ο αγοραστής και ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται σε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

Βασικές επιδόσεις

1. Για την προηγμένη παραγωγή ενέργειας ραδιοσυχνότητας υψηλής συχνότητας, το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απόκλιση της ονομαστικής ισχύος δεν υπερβαίνει το 20% της τυπικής τιμής.

2. Για τη βασική παραγωγή ενέργειας ραδιοσυχνότητας υψηλής συχνότητας, το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η απόκλιση της ονομαστικής ισχύος δεν υπερβαίνει το 20% της τυπικής τιμής.

Καθοδήγηση και δήλωση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ		
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται ως εξής. Ο πελάτης ή ο χρήστης του η συσκευής θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.		
Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Εκπομπές RF CISPR 11	Ομάδα1	Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές RF είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Εκπομπές RF	Κατηγορία Α	Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΗΣ αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους και νοσοκομεία.
Αρμονικό ρεύμα IEC 61000-3-2	Κατηγορία Α	
Μεταβολές τάσης/ διακυμάνσεις τάσης/ τρεμπάγια IEC 61000-3-3	Συμμορφώνεται	

Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ανοσία			
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται ως εξής. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.			
Δοκιμή ανοσίας	IEC 60601 επίπεδο δοκιμής	Επίπεδο συμμόρφωσης	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV επαφή ± 2,4,8, 15kV αέρα	± 8 kV επαφή ± 2,4,8, 15kV αέρα	Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακάκια. Εάν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό υλικό, Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.
Ηλεκτρικό γρήγορο μεταβατικό φαινόμενο/έκρηξη IEC 61000-4-4	± 2 kV για γραμμές τροφοδοσίας ± 1 kV για τις γραμμές εισόδου/εξόδου	± 2 kV για γραμμές τροφοδοσίας ± 1 kV για τις γραμμές εισόδου/εξόδου	Η ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Κόμια IEC 61000-4-5	± 1 kV γραμμής(-ες) προς γραμμή(-ες) ± 2 kV γραμμής(-ες) προς γη	± 1 kV από γραμμή(ες) σε γραμμή(ες) ± 2 kV γραμμή(ς) προς γη	Η ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Βυθίσεις τάσης, βραχυκύκλωμα διακοπές στις γραμμές εισόδου τροφοδοσίας IEC 61000-4-11	0 % UT- 0,5 κύκλος στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315°. 0 % UT, 1 κύκλος και 70 % UT, 25/30 κύκλοι Μονοφασικό: στις 0° 0 % UT; 250/300 κύκλος	0 % UT; 0,5 κύκλος Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315° 0 % UT, 1 κύκλος και 70 % UT, 25/30 κύκλοι Μονοφασικό: στις 0° 0 % UT; 250/300 κύκλος	Η ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του χειρουργικού περιεργού Ο εξοπλισμός απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών του ηλεκτρικού δικτύου, συνιστάται η χειρουργική υπερηχογραφική Ο εξοπλισμός να τροφοδοτείται από αδιάλειπτη παροχή ρεύματος ή από μπαταρία.

Συχνότητα ισχύος (50/60 Hz) Μαγνητικό πεδίο IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Συχνότητα ισχύος μαγνητική τα πεδία πρέπει να είναι σε χαρακτηριστικό επίπεδο. Από μια τυπική θέση σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.
-----------------------------------------------------------------	--------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ανοσία

Η συσκευή προορίζεται για εφαρμογή σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που προσδιορίζεται ως εξής.
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

ΑΝΟΣΙΑ δοκιμή	Δοκιμή IEC 60601 επίπεδο	Συμμόρφωση επίπεδο	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον-καθοδήγηση
Διερχόμενο RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz έως 80 MHz 6 V στις ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz	3V	Φορητές και κινητές επικοινωνίες RF Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πιο κοντά σε κανένα μέρος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται από την εξίσωση για τη συχνότητα του πομπού. Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
Ακτινοβολούμενο RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz έως 2,7 GHz 80 % AM στο 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz έως } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz έως } 2,7\text{GHz}$ <p>όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως προσδιορίζονται από ηλεκτρομαγνητική έρευνα χώρου.3 θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε περιοχή συχνότητας. Ενδέχεται να παρουσιαστούν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που επισμαίναται με το ακόλουθο σύμβολο:</p>  <p>Η ΘΥΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ και των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ δοκιμάζεται όπως ορίζεται στον πίνακα 9 του IEC 60601-1-2 χρησιμοποιώντας τις μεθόδους δοκιμής που ορίζονται στο IEC 61000-4-3.</p>

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF και των συσκευών.

Το Γενήτρια υπερήχων αποσκοπεί στην εφαρμογή σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι ακτινοβολούμενες διαταραχές RF. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών RF (πομπού) και της συσκευής ως σύσταση ως εξής., σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού (w)	Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού /m		
	150 kHz έως 80 MHz	80 MHz έως 800 MHz	800 MHz έως 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Τεχνικές συνθήκες

Εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος: Μετατροπέας, Ποδοδιακόπτης υπερήχων, Ποδοδιακόπτης Ηλεκτροχειρουργικής, Ψαλίδι υπερήχων ή χειρολαβές Ηλεκτροχειρουργικής, διπολικός σύνδεσμος ηλεκτροχειρουργικής Διπολικό όργανο.

Ανατρέξτε στην περιγραφή του προϊόντος για αυτό το εξάρτημα.


Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία	Υπέρηχος:  Διπολική ηλεκτροχειρουργική  Αμφίπλευρη απινίδωση-απόδειξη τύπου CF Εφαρμοσμένο μέρος
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία Ι
Γενήτρια σε επιβλαβείς εγχύσεις	Κανονικός εξοπλισμός
Βαθμός προστασίας από την επιβλαβή εισροή νερού	Διακόπτης ποδιού: IP68
Κατηγορία διαχείρισης	Κατηγορία IIb
Απαιτήσεις παραμέτρων λειτουργίας υπερήχων:	
Ισχύς εισόδου	Τάση τροφοδοσίας: 100-240V Συχνότητα τροφοδοσίας: 50Hz/60Hz Ισχύς εισόδου: 400VA
Απαιτήσεις παραμέτρων λειτουργίας υπερήχων:	
Συχνότητα διέγερσης	54 kHz - 57 kHz
Πρωτογενής έξαρση δόνησης άκρου	25 μm - 110 μm
Ψαλίδι υπερήχων κύρια επιφάνεια ακουστικής εξόδου Προϊόν:	1,53-2,75 mm2

Δευτερεύουσα ακουστική διασύνδεση στο άκρο Ψαλίδι υπερήχων Περιοχή εξόδου:	19,32~35,88 mm2
Παραγόμενος ήχος εξόδου στο άκρο Ψαλίδι υπερήχων στο άκρο αναφοράς Πρωτεύον πλάτος ισχύος	< 30W
Τύπος ελέγχου συχνότητας του συστήματος	Ανεξάρτητα από το φορτίο, η συχνότητα διέγερσης ρυθμίζεται αυτόματα και συνεχώς.
Δείκτης αποθεματικού ισχύος	Τουλάχιστον 2,5
Απαιτήσεις ηλεκτροχειρουργικών παραμέτρων:	
Συχνότητα εργασίας	400KHz ± 5%
Μέγιστη τάση εξόδου	≤ 250V
Προηγμένη διπολική λειτουργία Μέγιστο ρεύμα εξόδου	≤ 5.5A
Βασική διπολική λειτουργία Μέγιστο ρεύμα εξόδου	≤ 2.2A
Μέγιστη τάση κορυφής εξόδου	≤ 500Vpk
Συντελεστής αιχμής	1.6 ± 0.4
Ονομαστική ισχύς	Ραδιοσυχνότητα προηγμένη διπολική: 270 W Ραδιοσυχνότητα Βασικό διπολικό: 95W
Ονομαστικό φορτίο	Ραδιοσυχνότητα προηγμένη διπολική: 30Ω Ραδιοσυχνότητα Βασικό διπολικό: 200Ω

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας	Θερμοκρασία: C έως 30 ° C
	Σχετική υγρασία: ≤ 70%
	Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης: 800 hPa έως 1060 hPa
Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -30 ° C έως + 55 ° C (Γεννήτρια, ποδοδιακόπτης, προσαρμογέας) Θερμοκρασία: -10 ° C έως + 55 ° C (Ψαλίδι υπερήχων)
	Υγρασία: ≤ 80%
	Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης: 800 hPa έως 1060 hPa
Ημερομηνία κατασκευής	Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να προσδιοριστεί από τον σειριακό αριθμό στην πίσω πλευρά του Γεννήτρια.
Καλώδιο τροφοδοσίας	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης CCC
	Τρέχουσα βαθμολογία: 10A
Ποσοστό επιμονής	Προσδιορίζεται από το τεμάχιο χειρός Μετατροπέας και το χρησιμοποιούμενο Ψαλίδι υπερήχων. Για πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό επιμονής, ανατρέξτε στα ισχύοντα Ψαλίδι υπερήχων και Μετατροπέας Οδηγίες χειρολαβής ή Κεφάλαιο 7 - Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
Ασφάλεια	45 * 20 T8AH250V
Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Γεννήτρια: ονομαστικά 8 kg
Συνολικός όγκος	OP9 Γεννήτρια: (μήκος * πλάτος * ύψος): cm-16 cm
Διάθεση	Ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα του Γεννήτρια, του ποδοδιακόπτη και του καλωδίου ποδοδιακόπτη περιέχουν μόλυβδο. Σύμφωνα με τις τοπικές Απαιτήσεις και κανονισμούς για τη διάθεση. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις κατάλληλες πρακτικές απόρριψης αποβλήτων.
Ταξινόμηση AP/APG	Όχι εξοπλισμός AP/APG.
Διάρκεια ζωής:	Διάρκεια ζωής: 7 χρόνια
Έκδοση έκδοσης λογισμικού	V01.01

Διπολική κυματομορφή εξόδου


Προηγμένη διπολική καμπύλη ισχύος-φορτίου εξόδου

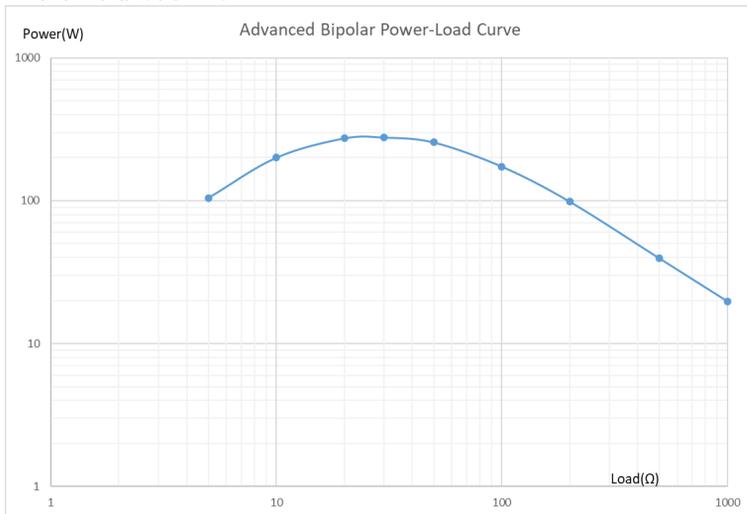

ΌΡΙΟ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μέγιστη έξοδος: 270[W]			
Φορτίο (Ω)	Κάτω όριο	Όνομαστικό	Ανώτατο όριο
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Όνομαστική καμπύλη ισχύος 270 Watt εξόδου σε ονομαστικό φορτίο σύμφωνα με το όριο ρεύματος/τάσης του μετρητή καμπύλης ισχύος. Η καμπύλη ισχύος αντιπροσωπεύει το φάκελο που μεταβάλλεται υπό συνθήκες λειτουργίας.


Βασική διπολική καμπύλη εξόδου πλήρους ισχύος-φορτίου

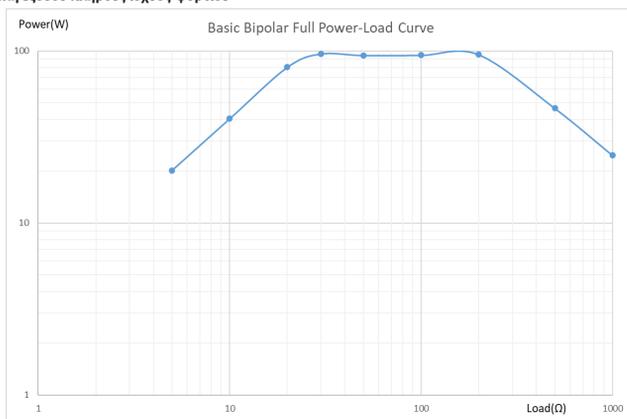

Όριο καμπύλης πλήρους ισχύος [W]: 95 Watts


Φορτίο (Ω)	Κάτω όριο	Όνομαστικό	Ανώτατο όριο
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Βασική διπολική καμπύλη εξόδου μισής ισχύος-φορτίου

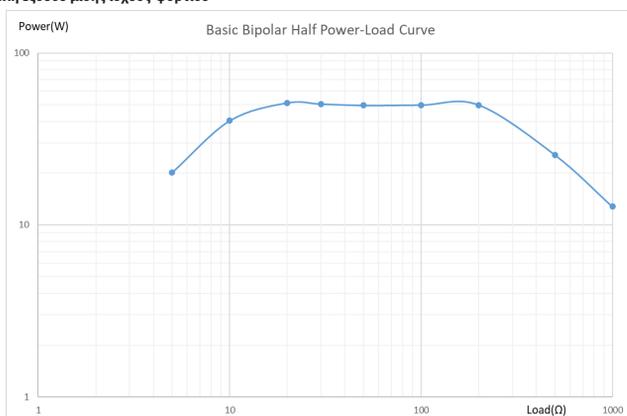

Όριο καμπύλης μισής ισχύος [W]: Watts: Μέγιστη ισχύς 50 Watts			
Φορτίο (Ω)	Κάτω όριο	Ονομαστικό	Ανώτατο όριο
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Ισχύς εξόδου συναρτήσει των ρυθμίσεων ισχύος για ισχύ σε κανονικό διπολικό σύστημα

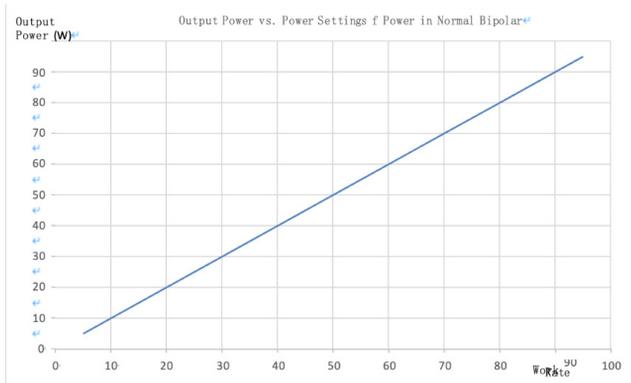

Ισχύς εξόδου σε σχέση με την τιμή ρύθμισης ισχύος για κανονικό διπολικό [W]; Φορτίο: 200Ω			
Ρύθμιση ισχύος (W)	Κάτω όριο ισχύος εξόδου (W)	Ονομαστική ισχύος (W)	Ανώτατο όριο ισχύος εξόδου (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Εξυπηρέτηση και εγγύηση

Η Reach Surgical, Inc. εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού και κατασκευής υπό κανονική χρήση και προληπτική συντήρηση για την περίοδο εγγύησης που καθορίζεται παρακάτω. Η υποχρέωση της Reach Surgical στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση, κατά την επιλογή της, οποιοδήποτε ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος που έχει επιστραφεί στην Reach Surgical, Inc. ή στον εξουσιοδοτημένο διανομέα της εντός της ισχύουσας περιόδου εγγύησης και διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά τρόπο που ικανοποιεί την Reach Surgical. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα ή εξαρτήματα που έχουν:

- επηρεάζεται αρνητικά λόγω χρήσης με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές που κατασκευάζονται ή διανέμονται από μέρη που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Reach Surgical, Inc.
- Επισκευή ή τροποποίηση εκτός του εργοστασίου της Reach Surgical, εάν επηρεάζει τη σταθερότητα ή την αξιοπιστία της συσκευής, όπως καθορίζεται από την Reach Surgical.
- Υφίσταται ακατάλληλη χρήση, αμέλεια ή ατύχημα.
- Χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν συνάδει με το σχεδιασμό, τις παραμέτρους χρήσης, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές για το προϊόν ή με τα αποδεκτά από τη βιομηχανία λειτουργικά, επιχειρησιακά ή περιβαλλοντικά πρότυπα για παρόμοια προϊόντα.

Περίοδοι εγγύησης

Βασικός διπολικός ενεργειακός σύνδεσμος (OP-BPC): 1 έτος για εξαρτήματα και εργασία.

Γεννήτρια (OP9): 1 έτος για τα εξαρτήματα και την εργασία.

Διακόπτης ποδιού/καλώδιο τροφοδοσίας: 1 έτος για εξαρτήματα και εργασία.

Η παρούσα εγγύηση αποτελεί το αποκλειστικό ένδικο μέσο για τον αρχικό αγοραστή και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπειροσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Reach Surgical, Inc. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, κερδών, επιχειρήσεων ή υπεραξίας, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Reach Surgical, Inc. δεν εξουσιοδοτεί κανένα πρόσωπο να αναλάβει οποιαδήποτε πρόσθετη ευθύνη σε σχέση με την πώληση ή τη χρήση των προϊόντων της. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις που επεκτείνονται πέραν των όρων που αναφέρονται στο παρόν.

Η Reach Surgical, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα προϊόντα της, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση να εφαρμόζει αναδρομικά τις αλλαγές αυτές σε προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί ή κατασκευαστεί.

Visión general

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar este aparato. Proporciona instrucciones importantes relativas al funcionamiento correcto, los riesgos potenciales y los posibles daños al producto o a las personas. En caso de que se produzca alguna situación anómala, siga las instrucciones especificadas para evitar hacerse daño a sí mismo o dañar el aparato. El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad, el funcionamiento, la garantía o el mantenimiento, por lo que el fabricante no se hace responsable. Lea también las instrucciones del Trasduttore y de las Tijeras Ultrasonicas antes de utilizar el aparato.

Este documento está diseñado para ayudar en el uso de este aparato. No es una referencia para las técnicas quirúrgicas.

Convenciones estándar utilizadas: Declaraciones de precaución, advertencia y nota

Tenga en cuenta las siguientes afirmaciones, clasificadas como PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA o NOTA, que proporcionan una guía esencial para completar las tareas de forma segura y minuciosa. Estas declaraciones pueden encontrarse a lo largo de la documentación y deben leerse antes de proceder al siguiente paso de un procedimiento.

ADVERTENCIA: Esta declaración destaca un procedimiento, práctica o condición de funcionamiento o mantenimiento que, si no se sigue estrictamente, podría provocar lesiones personales o la pérdida de la vida.

PRECAUCIÓN: Esta declaración alerta al usuario de una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente, así como daños al equipo o a otros bienes. También puede servir como advertencia contra prácticas inseguras. Incluye las precauciones necesarias para el uso seguro y eficaz del Instrumento y los cuidados requeridos para evitar daños derivados de un uso correcto o incorrecto.

NOTA: Esta afirmación indica una práctica o condición operativa que es esencial para ejecutar una tarea con eficacia.

Descripción

El Instrumento electroquirúrgico ENER REACH (denominado en lo sucesivo "el aparato") se utiliza en quirófanos médicos para procedimientos quirúrgicos de corte, coagulación de tejidos humanos y ligadura de vasos. Dispone de dos ranuras independientes: una para la energía ultrasónica y otra para la salida de ondas de radiofrecuencia.

En el modo de radiofrecuencia, el Generador suministra diferentes esquemas de energía en función del instrumento/dispositivo de electrocirugía conectado. Cuando se conecta un instrumento bipolar avanzado, el Generador suministra formas de onda de radiofrecuencia para el sellado de vasos arteriales y venosos, linfáticos y haces de tejido de hasta 7 mm de diámetro. Cuando se conecta un instrumento bipolar básico, se emite energía de potencia constante para el corte y la coagulación de tejidos blandos.

En el modo de salida de energía ultrasónica, utilizando el Trasduttore TRA6 en combinación con las Tijeras Ultrasonica de un solo uso CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, el dispositivo corta tejidos blandos que requieren control de hemorragias y un daño térmico mínimo, y sella vasos de hasta un diámetro máximo de 5 mm. Cuando se conecta con Tijeras Ultrasonicas de un solo uso SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 y SRE45, el dispositivo corta tejidos blandos que requieren control de la hemorragia y un daño térmico mínimo, y sella vasos hasta un diámetro máximo de 7 mm.

Uso previsto

El dispositivo suministra energía de radiofrecuencia para accionar las piezas de mano electroquirúrgicas destinadas a cortar y sellar vasos y a cortar, agarrar y diseccionar tejidos.

Además, el Generador proporciona potencia ultrasónica para accionar instrumentos quirúrgicos ultrasónicos que están indicados para incisiones en tejidos blandos cuando se desea controlar la hemorragia y minimizar las lesiones térmicas.

Indicaciones

El dispositivo proporciona potencia de radiofrecuencia para accionar piezas de mano electroquirúrgicas que se utilizan durante cirugías abiertas o laparoscópicas en cirugía general, pediátrica, ginecológica, urológica y torácica para cortar y sellar vasos de hasta 7 mm inclusive, y para cortar, agarrar y diseccionar tejidos.

Además, el Generador proporciona energía para accionar instrumentos quirúrgicos ultrasónicos que están indicados para incisiones en tejidos blandos cuando se desea controlar la hemorragia y minimizar las lesiones térmicas. Los instrumentos quirúrgicos ultrasónicos pueden utilizarse como complemento o sustituto de la electrocirugía, el láser y los bisturíes de acero para cortar y/o coagular tejidos en cirugías abiertas o laparoscópicas en general, pediátricas, ginecológicas, urológicas, torácicas, y sellar y transeccionar vasos linfáticos.

Usuario previsto

El dispositivo está destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios para aplicaciones quirúrgicas.

Entorno de uso previsto

El dispositivo está destinado a ser utilizado en un hospital.

Población de pacientes prevista

Este dispositivo es adecuado para pacientes a partir de 3 años que requieran procedimientos quirúrgicos que impliquen incisiones en tejidos blandos con control de hemorragias y lesiones térmicas mínimas.


Beneficio clínico

El dispositivo puede utilizarse con seguridad y eficacia en la ligadura y división de vasos, haces de tejido y linfáticos.

Contraindicaciones

Este dispositivo está contraindicado para incisiones óseas, oclusión de trompas anticonceptivas y procedimientos de coagulación. Tampoco está previsto su uso en neurocirugía.

Composición del sistema

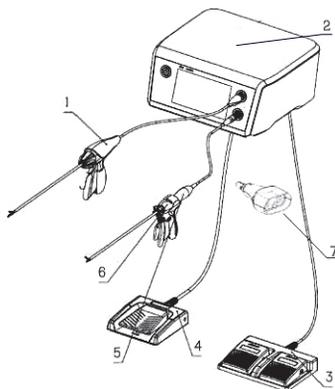

[01] Pieza de mano para electrocirugía	[02] Generador OP9
[03] Transductor para Equipos Quirúrgicos Ultrasónicos	[04] Interruptor de pedal electroquirúrgico
[05] Trasduttore	[06] Tijeras Ultrasónicas
[07] Conector bipolar de electrocirugía	

[01] Pieza de mano electroquirúrgica

La pieza de mano electroquirúrgica, conectada a un Generador, es operada por el cirujano durante el procedimiento. Aplica energía electroquirúrgica de radiofrecuencia al tejido entre sus mandíbulas para coagularlo o sellarlo. El instrumento también incluye una cuchilla para la división del tejido. Modelo: OSA23, OSA37, OSA44. Consulte las instrucciones para obtener información detallada.

[02] Generador OP9

El Generador proporciona tanto energía electroquirúrgica como energía de terapia ultrasónica a través de puertos de conexión de instrumentos independientes. Consta de chasis, carcasa, placa electrónica, pantalla táctil LCD, interruptor de encendido e interfaces para la conexión de accesorios.

Modelo: OP9

[03] Transductor para Equipos Quirúrgicos Ultrasónicos

Se utiliza para controlar el encendido/apagado de la salida de energía ultrasónica con dos interruptores ("MIN" y "MAX"). Modelo: OP-FSD

[04] Interruptor de pedal electroquirúrgico

Se utiliza para controlar la salida on/off de energía de alta frecuencia con un solo interruptor.

Modelo: OP-FSS

[05] Trasduttore

El Trasduttore convierte la energía eléctrica de un Generador compatible en movimiento mecánico para las palas del instrumento. Es un instrumento reutilizable con una vida útil limitada. El Trasduttore no es estéril y debe esterilizarse según las instrucciones antes de su uso. Consulte las instrucciones del Trasduttore TRA6 para obtener información detallada.

Modelo: TRA6.

[06] Tijeras Ultrasónicas

Las Tijeras Ultrasónicas utilizan el movimiento mecánico del Trasduttore y suministran energía ultrasónica para el corte o la coagulación del tejido. Debe tenerse precaución, ya que la vibración mecánica no es detectable y podría afectar involuntariamente a zonas no diana. Las Tijeras Ultrasónicas se esterilizan con óxido de etileno. Si se supera el tiempo de conservación o se daña el envase de esterilización, las Tijeras Ultrasónicas no deben utilizarse y deben desecharse. Consulte las instrucciones de las Tijeras Ultrasónicas para obtener información detallada.

Las siguientes Tijeras Ultrasónicas son compatibles con el Generador OP9:

Serie PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Serie SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Serie SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Conector bipolar de electrocirugía

Se utiliza para conectar los instrumentos electroquirúrgicos bipolares básicos al generador para la coagulación tisular.

Modelo: OP-BPC

Panel frontal del Generador

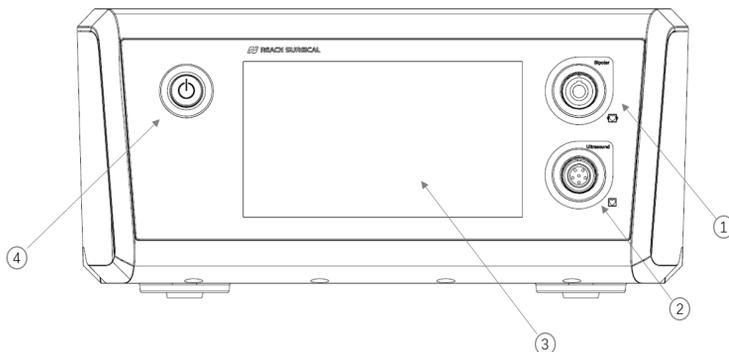

[01] Enchufe electroquirúrgico

Se utiliza para conectar instrumentos bipolares avanzados de electrocirugía o conector bipolar de electrocirugía.

[02] Toma del Trasduttore


Conecta el Trasduttore al Generador.

[03] Pantalla táctil LCD

Muestra información del sistema y sirve de interfaz para ajustar los controles y la configuración.

[04] Interruptor de encendido Botón

Pulse para encender el Generador; mantenga pulsado para apagarlo.

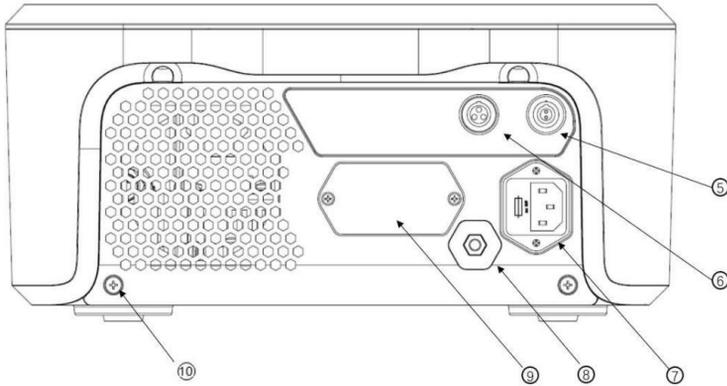Panel trasero del Generador**[05] Enchufe de pedal electroquirúrgico**

Enchufe redondo para conectar el pedal electroquirúrgico.

[06] Enchufe del Conmutador de pedal ultrasónico

Enchufe redondo para conectar el conmutador de pedal ultrasónico.

[07] Toma de corriente

Conecta el cable de alimentación al Generador.

[08] Puerto de equalización potencial

Si la conexión a tierra de la toma de corriente es incierta, este puerto permite la conexión a tierra protegida.

[09] Interfaz de expansión

Se utiliza para la ampliación de funciones y el mantenimiento.

[10] Agujero de montaje**Instrucciones de uso**

Consulte las directrices proporcionadas para el entorno operativo.

Desembalaje

Por favor, siga las instrucciones al recibir los componentes que se indican a continuación.

- Compruebe si hay algún daño visible durante el transporte. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con Reach Surgical, Inc o con el agente local para obtener asistencia.

Componentes incluidos en el (Para especificaciones técnicas detalladas y códigos de producto, consulte el capítulo "Condiciones técnicas del sistema"):

Modelo	Descripción	Componente
OP9	Generador	Generador, Cable de alimentación, Instrucciones
TRA6	Trasduttore	Trasduttore con Cable
OP-FSD	Conmutador de pedal ultrasónico	/
OP-FSS	Conmutador de pedal bipolar	/
OP-BPC	Conector básico de energía bipolar	/

Precauciones de seguridad

- Durante la inspección del equipo, mantenga el extremo distal del instrumento alejado de otros aparatos, paños quirúrgicos, el paciente o cualquier otro objeto para evitar lesiones.
- Aplique las medidas de seguridad necesarias en presencia de vapores, siguiendo los procedimientos y reglamentos del hospital.

Energía ultrasónica con Tijeras Ultrasónicas Serie PD

- Conecte el Trasduttore, el Interruptor de pedal y la Tijeras Ultrasónicas de la serie PD al Generador.
- Una vez superada la prueba del Trasduttore y del Interruptor de pedal ultrasónico, ajuste el nivel de potencia (1-5) mediante los iconos +/- de la pantalla LCD.
- Pulse el botón "Min" de la Tijeras Ultrasónicas o el pedal "Min" del Conmutador de pedal para activar la energía ultrasónica al nivel de potencia preestablecido.
- Pulse el botón "Max" de la Tijeras Ultrasónicas o del Conmutador de pedal para obtener el máximo nivel de energía.
- Suelte la llave o el conmutador de pedal para detener la salida de energía.

Energía ultrasónica con Tijeras Ultrasónicas Serie SRB/SRE

- Una vez superada la prueba del Trasduttore y del Interruptor de pedal ultrasónico, ajuste el nivel de potencia (1-5) mediante los iconos +/- de la pantalla LCD.
- Pulse el Botón Energía del aparato o el botón Min del pedal para activar la energía ultrasónica al nivel de potencia preestablecido.

- Pulse el Botón Energía con Hemostasia avanzada del instrumento para activar el modo de Hemostasia avanzada.
- Suelte el botón de las Tijeras Ultrasónicas o el botón del Interruptor de pedal para detener el suministro de energía.

Energía bipolar electroquirúrgica con instrumentos bipolares avanzados

- La pantalla LCD muestra el icono bipolar avanzado y el icono de control manual ajustable.
- Tire de la Palanca del instrumento o pise el pedal para activar la radiofrecuencia.
- El Generador detendrá la salida de energía cuando se complete el cierre, indicado por el icono de completo en la pantalla.
- Si la ligadura está incompleta, se reproducirá un tono de aviso y aparecerá un icono de advertencia.

Energía bipolar electroquirúrgica con instrumento electroquirúrgico bipolar

- La pantalla LCD muestra el valor de potencia, los iconos ajustables y las barras de nivel de potencia.
- Los ajustes de potencia van de 1 a 95 vatios, con incrementos ajustables.
- Seleccione el ajuste de salida de potencia deseado: Baja (15 vatios), Media (30 vatios) o Alta (60 vatios).
- Pulse el botón del interruptor manual o del pedal para activar la frecuencia de radio.
- Suelte el botón para desactivar la salida de energía.

Recomendaciones de ajuste

Ajustes de efectos	Rango de ajustes de potencia	Aplicación clínica	Dispositivo optimizado
Bajo	1-15 vatios	Como nervios/columna vertebral, manos y Cirugía facial	- Dispositivos con superficies más pequeñas - Pinzas microtip (0,4 - 2,2 mm)
Medio	16-40 vatios	Como la coagulación durante la cabeza/cuello, la columna vertebral y la anatomía	- Dispositivos con superficie media - Pinzas microtip (1,0 - 2,2 mm) - Pinzas laparoscópicas pequeñas de cabeza plana - Tijeras bipolares
Alta	45-95 vatios (incrementos de 5 vatios)	Como la cirugía de cabeza/cuello y plástica (similar al efecto medio, pero con un efecto más rápido)	- Dispositivos con grandes superficies - Pinzas laparoscópicas grandes de cabeza plana

NOTA: Este dispositivo no es compatible con el electrodo neutro.

NOTA: Las Tijeras Ultrasónicas y el bisturí eléctrico de radiofrecuencia son piezas que se aplican en contacto con el paciente.


Uso del generador

Encienda el aparato

- El sistema está listo para funcionar una vez que se ha encendido. Cuando el generador está conectado a la red eléctrica y la luz del interruptor de espera está encendida, el sistema está listo para funcionar.
- Tras pulsar el botón de espera, aparecerá la siguiente imagen:



- Si no hay ningún Trasduttore o Tijeras Ultrasónicas conectado al Generador, o si están conectados incorrectamente, aparecerá la siguiente imagen:

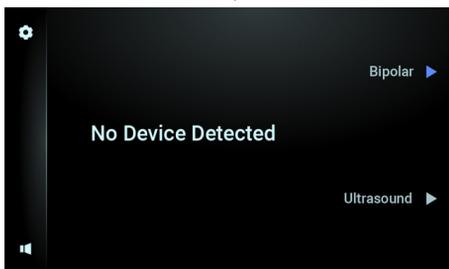

Uso de instrumentos ultrasónicos (Trasduttore e Interruptor de pedal ultrasónico)


Cuando se detecten el Trasduttore y el Interruptor de pedal ultrasónico, aparecerá la siguiente imagen.



NOTA: si el uso restante del Trasduttore es inferior a 10, aparecerá la siguiente imagen. Por favor, preste atención al número de usos restantes ya que el Trasduttore necesita ser reemplazado cuando el número se convirtió en cero.




A continuación aparecerá la siguiente imagen, se le pedirá que pulse cualquier botón de la cizalla ultrasónica para iniciar la prueba de cizallamiento ultrasónico con las mandíbulas abiertas.

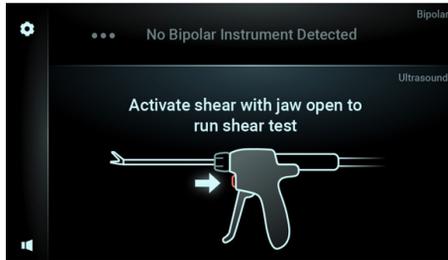

Pulse el botón cualquiera y aparecerá la siguiente imagen.




Cuando falle la prueba del trasduttore, aparecerá la siguiente imagen:

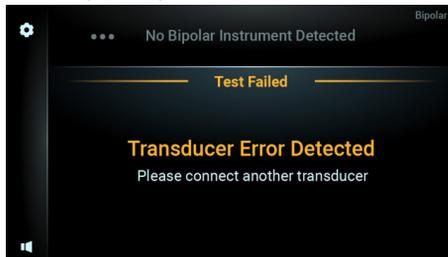


Cuando falle la prueba del Interruptor de pedal ultrasónico, se mostrará la siguiente imagen



Cuando pase la prueba del Trasduttore y del Interruptor de pedal ultrasónico, aparecerá la siguiente imagen:

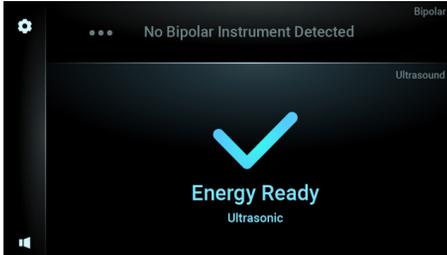

Al conectar Tijeras Ultrasónicas sin función de Hemostasis Avanzada, aparecerá la siguiente pantalla de trabajo.

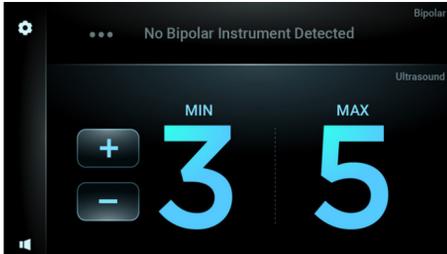


Al conectar las Tijeras Ultrasónicas SRE con Hemostasis Avanzada aparecerá la siguiente pantalla de trabajo.




El modo de salida se resaltará si está activado.

Uso de instrumentos electroquirúrgicos


Cuando se detecten el Trasduttore y el Interruptor de pedal ultrasónico, aparecerá la siguiente imagen.

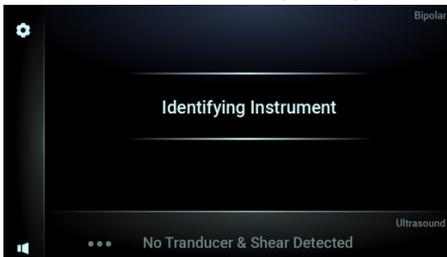


Cuando pase la prueba del instrumento electroquirúrgico, se mostrará la siguiente imagen:

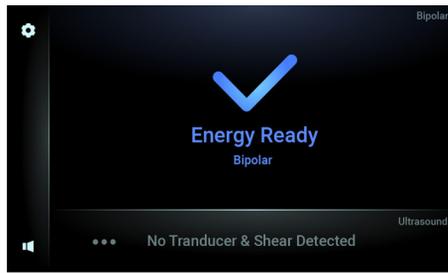

La siguiente pantalla de trabajo aparecerá cuando se conecte a un instrumento bipolar avanzado.



La siguiente pantalla de trabajo aparecerá cuando se conecte a un instrumento bipolar normal.

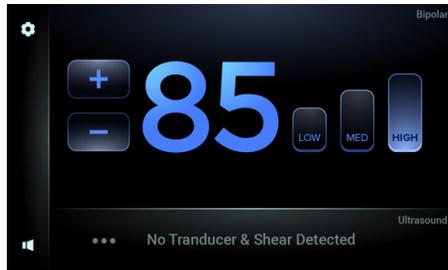


Uso de Instrumentos electroquirúrgicos y Tijeras Ultrasónicas

Tenga en cuenta que cuando el Generador está conectado tanto a un instrumento electroquirúrgico bipolar como a una Tijeras Ultrasónicas, el sistema funciona en modo de pantalla dividida para mostrar el estado actual. El dispositivo que tenga prioridad será el primero en activar la energía. Este estado de pantalla dividida se muestra a continuación:



Ajustes del sistema


Para acceder a los ajustes del sistema, pulse el icono de ajustes situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Dispone de las siguientes opciones de configuración del sistema:

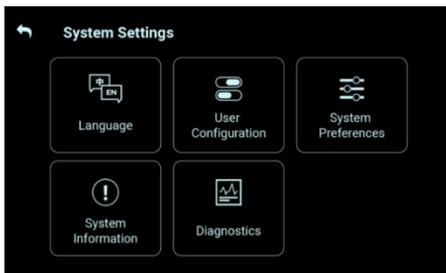


Idioma: Al pulsar sobre la opción Idioma aparecerá la pantalla de selección de idioma:




Configuración de usuario: Al hacer clic en el elemento Configuración de usuario aparecerá la pantalla de configuración de usuario:

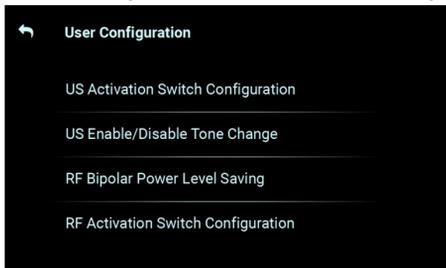

Preferencias del Sistema: Al hacer clic en el elemento Preferencias del sistema aparecerá la pantalla de preferencias del sistema:

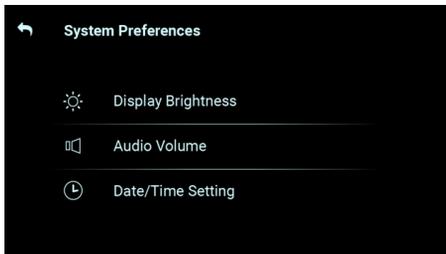

Información del sistema: Pulse suavemente sobre el elemento Información del sistema para mostrar la pantalla de información del sistema:

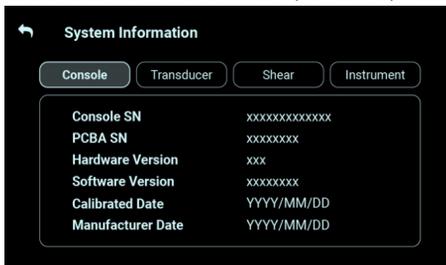

Diagnóstico: Al hacer clic en el elemento Diagnóstico aparecerá la pantalla de diagnóstico:



Para salir de los ajustes del sistema y volver al modo de espera del sistema, pulse el icono "Volver" situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Apagado del sistema

Siga los pasos que se indican a continuación para apagar el sistema de forma segura:

Pulse el Botón de Modo de Espera: Localice el Botón de Modo de Espera en el Generador y púselo para iniciar el proceso de apagado.

Desconecte el Trasduttore y el Interruptor de pedal ultrasónico: Desconecte con cuidado el Trasduttore y el Interruptor de pedal ultrasónico del sistema. Consulte las instrucciones de funcionamiento para manipular correctamente el Trasduttore y la Cizalla ultrasónica.

Limpieza: Limpie el Generador, el Conmutador de pedal y el Trasduttore de acuerdo con los procedimientos especificados en el capítulo "Mantenimiento".

Solución de problemas

El Generador incorpora varias señales de alerta y códigos de error para ayudar en la identificación y el diagnóstico de los fallos de los componentes. Es importante señalar que estas señales y códigos están diseñados para apoyar el juicio clínico y la observación, y no para sustituirlos.

Alerta sonora

Estado de trabajo	Tipo de sonido	Posible causa y acción
Estado de autocomprobación	Sonido normal	/
	Sonido anormal	Se ha detectado un fallo de hardware. Póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda para la reparación.
Utilización del instrumento ultrasónico	Nivel máximo de sonido	/
	Sonido de nivel mínimo	/
	Sonido anormal	El Interruptor de pedal ultrasónico ha entrado en contacto con un tejido excesivo. Reduzca el contacto del tejido con el Interruptor de pedal ultrasónico. Si persiste el sonido continuo, retire con cuidado el tejido que pueda estar acumulándose alrededor del extremo del Interruptor de pedal ultrasónico. Se ha detectado un fallo en el Trasduttore y/o en el Interruptor de pedal ultrasónico. Consulte al fabricante o póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener más ayuda.
	Sonido AVANZADO	/
	Sonido ITS	/
Activación de instrumentos electroquirúrgicos	Tono de aviso bipolar avanzado	/
	Sonido bipolar normal	/
	Sonido anormal	Corte sin éxito: Si el tejido contactado por el instrumento no cumple los requisitos de corte, reduzca la cantidad de tejido en contacto con el instrumento. Si el tono de fallo persiste, elimine cuidadosamente el tejido que pueda estar acumulándose en el extremo del instrumento. Fallo de Hardware: Este error indica un posible fallo en el circuito o conector. En caso de cualquier fallo o error, se recomienda consultar al fabricante o solicitar asistencia para obtener la orientación y resolución adecuadas.

Códigos de error

El Generador de la Plataforma Energética está equipado con un completo sistema de identificación de fallos que consiste en alertas y errores del sistema. Cuando se detecta un fallo, el Generador emite un tono de aviso, muestra una señal de advertencia en el panel de control y muestra el código de fallo correspondiente en la pantalla LCD. Siga los pasos que se indican a continuación para solucionar el problema:

Tabla de códigos de error

Código de error	Mensaje de fallo correspondiente
Advertencia	Conecte correctamente el Interruptor de pedal ultrasónico con el Trasduttore
Advertencia	Asegúrese de que las mandíbulas están abiertas mientras realiza la prueba
Advertencia	Interruptor de pedal ultrasónico de error detectado
Advertencia	El tiempo restante del Trasduttore es cero
Advertencia	Por favor, active sólo un botón a la vez
Advertencia	Por favor, reduzca la fuerza aplicada al Interruptor de pedal ultrasónico
Advertencia	El botón de Tijeras Ultrasónicas y el Interruptor de pedal no pueden cerrarse simultáneamente
Advertencia	Botón atascado, por favor compruebe y continúe
Advertencia	Ajuste las mandíbulas o sujete menos tejido
Advertencia	Retire el dispositivo de los tejidos
Error del sistema	Error del sistema
Error del sistema	Autocomprobación fallida

Si aparece un error en la pantalla durante la prueba, realice las siguientes acciones:



- Asegúrese de que el Cable del Traduttore está completamente insertado en la dirección correcta.
- Compruebe si la cizalla ultrasónica se ha apretado correctamente o si se ha acumulado algún tejido alrededor del extremo de la cizalla ultrasónica. Ajuste el apriete de la Cizalla ultrasónica y retire con cuidado cualquier acumulación de tejido alrededor de la carcasa de la Cizalla ultrasónica. (Si la prueba se inicia antes de la operación, asegúrese de que la Cizalla ultrasónica apunta hacia el aire. Si se están utilizando Tijeras Ultrasónicas, confirme que la mordaza de sujeción está abierta y no está en contacto con ningún objeto).
- Si el problema persiste, considere la posibilidad de sustituir el Traduttore o el Interruptor de pedal ultrasónico.
- Proceda al modo de trabajo del equipo.

NOTA: Es posible que el Traduttore no funcione correctamente si su temperatura supera el límite especificado. En tales casos, utilice inmediatamente otro Traduttore para recuperarlo o siga los pasos que se indican a continuación para determinar la causa del error y explorar los métodos de recuperación opcionales:

- Deje que el Traduttore se enfríe a temperatura ambiente durante un mínimo de 45 minutos. Este método de enfriamiento también se aplica si el Traduttore se calienta tras un funcionamiento prolongado a alta potencia.
- Si el sobrecalentamiento del Traduttore no es evidente y el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con los representantes de mantenimiento del fabricante para obtener ayuda.
- Aparte de los fusibles, el Generador no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Para cualquier sustitución o necesidad de servicio, póngase en contacto con el personal de servicio formado y autorizado por Reach Surgical, Inc. o con su representante local.

El mantenimiento y las actualizaciones del Generador deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio formado y autorizado por Reach Surgical.

Deben tomarse precauciones de ciberseguridad para prevenir posibles amenazas. Los siguientes incidentes plantean riesgos de ciberseguridad:

- Acceso no autorizado a cualquier producto no relacionado con el dispositivo.
- Cualquier comunicación de red no autorizada con el dispositivo.
- Actualizaciones de firmware o software que no hayan sido autorizadas por Reach Surgical.

En caso de que se produzca alguno de los incidentes anteriores, póngase en contacto con el representante de ventas de Reach Surgical, Inc. o contacte directamente con Reach Surgical, Inc. en Reachquality@reachsurgical.com.

Mantenimiento

Limpieza y desinfección del Generador y del Conector Básico de Energía Bipolar

Limpieza

Limpie la pantalla LCD del Generador y el Conector bipolar básico de acuerdo con los procedimientos y normas del hospital. Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de que la fuente de alimentación principal del Generador está desconectada y de que el cable de alimentación se ha retirado de la unidad de salida.

ADVERTENCIA: Los procedimientos de limpieza deben seguirse cuidadosamente para evitar dañar el Generador, provocar una descarga eléctrica o crear un riesgo de incendio. No derrame ni salpique líquidos sobre o dentro del Generador, ni lo sumerja en líquido.

Siga estos pasos para la limpieza:

- Prepare un detergente de pH neutro o un detergente enzimático de pH neutro como especifique el fabricante del detergente.
- Con un paño limpio y suave empapado con una pequeña cantidad de solución limpiadora, limpie manualmente todas las superficies, incluida la pantalla del Generador.
- Limpie todas las superficies con un paño limpio y suave empapado en agua tibia del grifo.
- Por último, limpie todas las superficies con un paño limpio y suave para asegurarse de que estén secas.

Desinfección

Si el Generador se contamina con sangre o fluidos corporales, debe desinfectarse antes de volver a utilizarlo. Los siguientes desinfectantes químicos han sido validados para su uso en el Generador: alcohol isopropílico al 70%, hipoclorito de sodio al 6%, peróxido de hidrógeno al 10%.

- Siga las recomendaciones del fabricante para el uso adecuado, la concentración y el tiempo de contacto de los desinfectantes.
- Asegúrese de que los desinfectadores se configuran y utilizan de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Limpieza del Conmutador de pedal

Limpie el Conmutador de pedal y el Cable después de cada uso siguiendo el siguiente procedimiento:

- Desconecte el Conmutador de pedal del Generador.
- Prepare un detergente enzimático de pH neutro siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Conecte firmemente el Cable con el Conmutador de pedal y sumérjalos en la solución limpiadora durante 2 minutos.

NOTA: Asegúrese de que el Cable del Conmutador de pedal utilizado para conectar el Generador esté completamente seco para evitar una activación accidental.

- Tras la inmersión, frote manualmente el Conmutador de pedal y el Cable con un cepillo de cerdas suaves en la solución limpiadora.
- Enjuague a fondo el Conmutador de pedal y el Cable con agua tibia del grifo durante al menos 1 minuto.

PRECAUCIÓN: Mantenga el Cable y el Conmutador de pedal firmemente conectados durante el enjuague.

- Limpie todas las superficies con un paño limpio y suave.

ADVERTENCIA: No utilice una máquina de limpieza por ultrasonidos para limpiar el Conmutador de pedal.

ADVERTENCIA: No conecte la alimentación del Generador antes de conectar el Cable de alimentación de CA. Asegúrese de que todas las conexiones estén secas antes del montaje.

Limpieza y desinfección del traduttore

Los traduttore se envían sin esterilizar y requieren una limpieza y esterilización minuciosas antes de cada uso.

Limpieza:

Limpie a fondo los Traduttore de acuerdo con los siguientes pasos:

- Renjuague el Transductor con el lado de la rosca hacia arriba y límpielo con un cepillo de cerdas suaves con agua purificada hasta que no haya manchas en la superficie;
- El Trasduttore puede sumergirse en un detergente enzimático de pH neutro (Ingredientes principales: proteasa lipasa amilasa celulasa pectinasa y otras enzimas biológicas, tensioactivo ecológico, factor de prevención de la oxidación y estabilizador) durante un período de hasta 10 minutos y a una temperatura adecuada de 15 ° C ~ 65 ° C. La proporción de detergente y agua purificada es 1:400;
- Enjuague el Trasduttore con el lado del tornillo hacia arriba con agua purificada durante 2 minutos;
- Limpie el tornillo de conexión, la superficie de montaje del bisturí y el conector con una toallita con alcohol.
- Remoje el Trasduttore en alcohol medicinal al 75% y sosténgalo y agítelo 30 veces;
- Enjuague el Trasduttore con el lado del tornillo hacia arriba con agua purificada durante 2 minutos.

Nota: No se recomienda el uso de limpiadores ultrasónicos para el Trasduttore.

El secado:

Temperatura de secado: 50-70°C, Tiempo de secado:30min.

Esterilización del Trasduttore:

Siguiendo los pasos de limpieza y secado anteriores, el Trasduttore debe esterilizarse mediante uno de los métodos que se enumeran a continuación.

Steam Sterilization (121°C)

- Instale las fundas antes de la esterilización. El Trasduttore debe envolverse durante la esterilización. Coloque los Trasduttore en un recipiente de esterilización a vapor de alta temperatura para la esterilización, con una temperatura de 121 ° C y una duración de 30 min.
- Temperatura de secado: 50-70°C, Tiempo de secado:30min.

Esterilización por vapor (134°C)

- Instale las fundas antes de la esterilización. El Trasduttore debe envolverse durante la esterilización. Coloque los Trasduttore en un recipiente de esterilización a vapor de alta temperatura para la esterilización, con una temperatura de 134 ° C y una duración de 10 min.
- Temperatura de secado: 50-70°C, Tiempo de secado:30min.

Pruebas de seguridad y funcionales

Asegúrese de que se realizan las pruebas de seguridad y funcionamiento del Trasduttore, Generador y Conmutador de pedal de acuerdo con los procedimientos y normas del hospital. Para las pruebas de seguridad y funcionamiento de otros componentes utilizados por varios pacientes, consulte las instrucciones de uso específicas de cada componente.

Prueba de seguridad

Generador: Técnicos hospitalarios certificados deben realizar una prueba de corriente de fuga.

Conmutador de pedal: Inspeccione el pedal, el conector del cable y el cable en busca de grietas o daños. Sustituya cualquier componente dañado.

Otros componentes: Compruebe todos los demás componentes según se indica en sus respectivos manuales de instrucciones.

Prueba funcional

Modo ultrasónicos

- Prepare el juego completo de Tijeras Ultrasónicas PD y conecte el Trasduttore siguiendo las instrucciones proporcionadas en el Capítulo II - Instalación y Funcionamiento del Equipo.
- Verifique si es posible entrar en el estado de funcionamiento. Diferentes Tijeras Ultrasónicas pueden tener diferentes interfaces de entrada. Consulte la Parte 1, Sección 3 del Capítulo 2 para obtener instrucciones detalladas.
- Confirme la visualización del nivel de potencia MIN 3 y del nivel de potencia MAX 5.
- Pulse los botones de aumento y disminución de potencia para que el nivel de potencia MIN pueda ajustarse de los niveles 1 a 5.
- Encienda el Generador y póngalo en modo de trabajo por ultrasonidos. Verifique la correcta conexión del Trasduttore y del Interruptor de pedal ultrasónico.
- Con la mandíbula abierta, pulse el botón "MAX" del conmutador de pedal. La pantalla LCD debe mostrar el nivel de potencia MAX "5" y debe sonar un tono de activación.
- Con la mandíbula abierta, pulse el botón "MIN" del conmutador de pedal. La pantalla LCD debe mostrar el nivel de potencia MIN y debe sonar un tono de activación.

ADVERTENCIA: Antes de activar el sistema, asegúrese de que la mandíbula se mantiene alejada de tejidos, otros instrumentos o cualquier otro objeto para evitar lesiones al usuario.

Modo electroquirúrgico bipolar

- Conecte el instrumento electroquirúrgico bipolar avanzado/instrumento bipolar básico siguiendo las instrucciones.
- Compruebe si el sistema puede entrar en la interfaz de trabajo. El modo bipolar básico debe mostrar el icono de nivel de potencia 30, mientras que el modo bipolar avanzado debe mostrar el icono "bipolar avanzado".
- Toque ligeramente las teclas de incremento y decremento de potencia en el modo bipolar básico para confirmar que el nivel de potencia puede ajustarse entre 1 y 95. Toque las barras Baja, Media y Alta para cambiar directamente entre 15, 30 y 60.
- Apague el generador y espere 5 segundos. A continuación, encienda la fuente de alimentación del Generador y espere 10 segundos. Compruebe si el modo bipolar básico muestra la interfaz de 30 niveles de potencia, y el modo bipolar avanzado muestra la interfaz "bipolar avanzado". Compruebe si el Generador se activa de acuerdo con los requisitos predeterminados.
- Conecte los Instrumentos electroquirúrgicos bipolares avanzado y básico y pulse el conmutador de pedal único. Compruebe si parpadean las indicaciones de nivel de potencia en el panel de control y escuche un sonido de activación.

ADVERTENCIA: Antes de activar el sistema, está estrictamente prohibido permitir cualquier contacto del Interruptor de pedal ultrasónico con tejidos, otros instrumentos o cualquier otro objeto para evitar lesiones al usuario.

Advertencias y precauciones

Relacionado con el sistema

- Lea las instrucciones antes de su uso y siga las directrices hospitalarias para la práctica clínica de la cirugía ultrasónica, la electrocirugía, la ginecología y la laparoscopia.
- Los dispositivos mínimamente invasivos pueden variar de un fabricante a otro. Si en una intervención quirúrgica se utilizan al mismo tiempo instrumentos y accesorios mínimamente invasivos de distintos fabricantes, compruebe la compatibilidad de los instrumentos y accesorios antes de la intervención y verifique si los accesorios introducidos en el cuerpo humano tienen una superficie rugosa, un borde afilado o una protuberancia que puedan causar riesgos para la seguridad.
- Este aparato está destinado a ser utilizado únicamente por cirujanos formados y autorizados. No utilice dispositivos electroquirúrgicos a menos que haya recibido la formación adecuada en su uso para el procedimiento específico que deberá completar. El uso no entrenado de este dispositivo puede causar lesiones graves no intencionadas al paciente, incluyendo perforación intestinal y necrosis tisular inconsciente e irreparable.
- No abra la caja del Generador sin permiso para evitar posibles riesgos de descarga eléctrica. Cualquier reparación y actualización del instrumento deberá ser realizada por un técnico de servicio formado y autorizado por Reach Surgical, Inc. No utilice este instrumento para ningún otro fin que no sea la cirugía médica.
- Es esencial conocer a fondo los principios y técnicas que intervienen en los procedimientos con láser, electrocirugía y ultrasonidos para evitar riesgos

de descarga y quemaduras tanto para el paciente como para el personal médico, así como daños en este aparato o en otros dispositivos médicos. No debe comprometerse el aislamiento eléctrico ni la conexión a tierra. No sumerja los dispositivos electroquirúrgicos en líquidos a menos que el diseño lo requiera y el etiquetado indique que deben sumergirse.

- La seguridad y la eficacia de la cirugía ultrasonográfica y la electrocirugía dependen no sólo del diseño del equipo, sino también en gran medida de muchos factores controlados por el operador. Para mejorar la seguridad y la eficacia, lea, comprenda y siga las instrucciones de uso proporcionadas con el aparato.
- Al igual que con todas las fuentes de energía (electroquirúrgica, láser o ultrasonidos), deben tenerse en cuenta los riesgos cancerígenos e infecciosos que pueden presentar muchos subproductos tisulares, como el humo y los aerosoles. Tanto en los procedimientos abiertos como en los endoscópicos deben observarse precauciones adecuadas, como gafas de seguridad, máscaras de filtración y un equipo eficaz de evacuación de humos.
- Tras retirar el dispositivo, compruebe la hemostasia del tejido. Si no hay hemostasia, deben utilizarse métodos adecuados para conseguirla.
- Los productos fabricados o distribuidos por empresas no autorizadas por Reach Surgical, Inc. pueden no ser compatibles con el dispositivo. El uso de tales productos puede dar lugar a resultados inesperados y lesionar al usuario o al paciente.
- Para reducir el riesgo de interferencias, el aparato y la carcasa deben conectarse a un circuito de alimentación independiente.
- El equipo no es adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno u óxido nítrico. Posibilidad de que se produzcan chispas debido a la colisión con otros dispositivos metálicos. Las chispas pueden inflamar gases inflamables, como los gases de camp.
- El debe funcionar dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento requerido.
- La tensión de la toma de salida deberá cumplir los requisitos del generador (capítulo "Condiciones técnicas del sistema"). Si la toma de corriente no está conectada correctamente, puede dañar el generador y provocar descargas eléctricas o peligro de incendio.
- No utilice alargadores para evitar riesgos de incendio.
- No ponga el tono de activación a un nivel inaudible. Los tonos de activación pueden ser percibidos por el personal del equipo quirúrgico mientras el Generador está suministrando energía.
- Se ha demostrado que el humo generado durante la electrocirugía es potencialmente perjudicial para los pacientes o el personal del equipo quirúrgico. Sugiera una ventilación adecuada con un evacuador de humo quirúrgico u otros medios.
- Hay algunos componentes del Generador ultrasonográfico quirúrgico integrado que se envían sin esterilizar (por ejemplo, el Trasduttore). Esterilícelos según sea necesario antes de iniciar la instalación del sistema. Para las instrucciones de limpieza y esterilización, consulte cada instrucción pertinente.
- Para evitar lesiones a los usuarios o pacientes, el Interruptor de pedal ultrasonográfico debe evitar otros dispositivos, paños quirúrgicos, pacientes u otros objetos antes de pulsar el botón de prueba y durante la comprobación del sistema. Las medidas de seguridad en caso de aerosol (de acuerdo con la normativa hospitalaria) se aplicarán en la inspección del sistema y en el método de prueba.
- No aplique demasiada presión sobre la manábula para evitar inhibir el suministro de energía ultrasonográfica.
- Para evitar lesiones al usuario, la cuchilla debe evitar el contacto con el tejido, otros dispositivos u otros objetos antes de activar el sistema.
- Si se salpica o vierte líquido sobre o dentro del Generador, o si éste se derrama o se vierte en el líquido, puede dañar el Generador y provocar una descarga eléctrica o peligro de incendio.
- Tanto las chispas como el calentamiento asociado a las técnicas de cierre de los vasos pueden servir como fuentes de ignición. La gasa y la esponja deben permanecer húmedas. Mantenga los electrodos electroquirúrgicos alejados de materiales combustibles y de entornos ricos en oxígeno (O2).
- Cuando se produzcan daños importantes en el Trasduttore o si alguna pieza muestra signos de deterioro tras el mantenimiento de limpieza y desinfección, deséchela. Las piezas dañadas están claramente marcadas para evitar un uso indebido antes de su posterior manipulación.
- Los residuos desechables y los residuos electrónicos se eliminarán de acuerdo con las normas del hospital y no se tirarán a discreción para evitar la contaminación medioambiental.
- Evite utilizar el Generador cerca o apilado sobre otros equipos. Si es necesario utilizarlo adyacente o apilado, supervise el generador y los demás equipos para garantizar un funcionamiento correcto.
- El aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para el servicio, póngase en contacto con su representante de ventas o personal de servicio de Reach Surgical.
- Compruebe todos los dispositivos conectados al sistema y las conexiones antes de utilizarlos. Compruebe que el dispositivo funciona según lo previsto. Una conexión incorrecta puede provocar arcos eléctricos, chispas, un mal funcionamiento del dispositivo o resultados quirúrgicos no deseados.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo sólo debe conectarse a un suministro con toma de tierra de protección.
- Mantenga la mayor distancia posible entre el Generador y otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, monitores). No cruce ni ate cables eléctricos a dispositivos electrónicos. El Generador puede causar interferencias con otros dispositivos electrónicos.
- El sistema debe utilizarse con precaución en presencia de marcapasos internos y externos. Las interferencias provocadas por el uso de instrumentos electroquirúrgicos pueden hacer que el marcapasos entre en un estado asíncrono o impedir completamente su funcionamiento. Cuando se vaya a utilizar electrocirugía o dispositivos de sellado de tejidos en pacientes con marcapasos cardíacos, póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o con el departamento de cardiología del hospital para obtener información adicional.
- Tenga cuidado si apila instrumentos encima del Generador o si coloca el Generador encima de instrumentos eléctricos. Esta es una configuración inestable y no proporciona una refrigeración adecuada.
- Si el generador falla, puede provocar una interrupción quirúrgica. Se dispondrá de un sistema de reserva.
- Si la normativa local lo exige, el Generador debe conectarse al conector equipotencial del hospital mediante un Cable equipotencial.
- Cuando el sistema y el equipo de monitorización fisiológica se utilicen simultáneamente en el mismo paciente, cualquier electrodo de monitorización deberá colocarse lo más lejos posible del instrumento.
- En el modo bipolar básico, elija la potencia de salida más baja posible para el efecto deseado.
- El fallo de un equipo quirúrgico de alta frecuencia puede provocar un aumento inesperado de la potencia de salida.
- El Generador y el Conector electroquirúrgico bipolar básico pueden verse invadidos por agua o partículas. En el proceso de uso y limpieza, es necesario evitar la invasión de agua o partículas.
- Cuando el sistema se utiliza en combinación con un endoscopio, puede aumentar la corriente de fuga en el cuerpo del paciente. Preste atención durante el procedimiento.
- Un aviso al usuario y/o paciente de que cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe comunicarse a Reach Surgical, Inc. a través de Reachquality@reachsurgical.com. y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

Instrumentos relacionados

Durante los procedimientos quirúrgicos, es importante tener en cuenta que la parte final del instrumento, la almohadilla de las Tijeras Ultrasonográficas y el Eje pueden experimentar temperaturas elevadas cuando se aplican ultrasonidos o electrocauterio bipolar al tejido durante periodos prolongados. Para garantizar la seguridad, es crucial evitar cualquier contacto accidental entre estos componentes del instrumento y el tejido, los paños quirúrgicos, las batas quirúrgicas o cualquier zona no relacionada durante todo el procedimiento.

Además, es vital tener precaución al colocar el instrumento bipolar. En concreto, no debe colocarse cerca o en contacto con materiales combustibles como gases o paños quirúrgicos. Los instrumentos bipolares utilizados en este contexto pueden generar calor durante su uso, lo que podría provocar un riesgo de incendio. Cuando el Generador electroquirúrgico bipolar no esté en uso, debe guardarse adecuadamente en la funda protectora o mantenerse a una distancia segura del paciente, de los miembros del equipo quirúrgico y de cualquier material combustible.

NOTA: Consulte las respectivas instrucciones de uso para conocer las advertencias y precauciones adicionales.

Información EMC

El producto ha superado la prueba de compatibilidad electromagnética, que cumple los requisitos de limitación de la norma IEC60601-1-2 para equipos médicos. Estas restricciones proporcionan una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones médicas normales.

Composición del producto

Número de serie	Nombre de la pieza	Nº de modelo/versión	Observaciones
1	Instrumentos electroquirúrgicos	OP9	/
2	Transductor para Equipos Quirúrgicos Ultrasónicos	TRA6	Usó compatible
3	Interruptor de pedal ultrasónico de un solo uso Interruptor de pedal ultrasónico	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Usó compatible
4	Unidad desechable de cirugía ultrasónica de alta frecuencia Sellador de tejidos	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Transductor para Equipos Quirúrgicos Ultrasónicos	OP-FSD	/
6	Interruptor de pedal electroquirúrgico	OP-FSS	/
7	Conector bipolar para electrocirugía	OP-BPC	/

Cable del producto

Número de serie	Nombre del Cable	Longitud (m)	Blindado
1	Cable del mando de pedal	3	Sí
2	Cable de alimentación	5	No
3	Cable electroquirúrgico bipolar	3	No
4	El Cable de Trasduttore	2,9	Sí

Rendimiento del EMC

Este equipo puede estar sujeto a interferencias de radiofrecuencia causadas por otros equipos médicos y comunicaciones por radio. Para evitar dichas interferencias, este producto ha sido probado según la norma IEC 60601-1-2 y cumple sus requisitos. No obstante, Reach Surgical, Inc. no garantiza la ausencia absoluta de interferencias en entornos de instalación individuales.

Si se comprueba que el aparato sufre interferencias (lo que puede determinarse encendiendo y apagando el aparato), el usuario (o el personal de mantenimiento autorizado por Reach Surgical, Inc.) deberá intentar tomar una o varias de las siguientes medidas para solucionar el problema de interferencias:

Ajuste la dirección o la posición del dispositivo que le afecta.

Aumente la distancia entre este dispositivo y el dispositivo emisor.

Utilice otras fuentes de energía (en lugar de la energía utilizada para afectar al equipo) para alimentar este equipo.

Consulte al proveedor o al representante del servicio técnico para obtener otras sugerencias.

El fabricante no se hace responsable de las interferencias causadas por las siguientes situaciones: utilizar otros cables de interconexión que no sean los recomendados; alterar o modificar este equipo sin autorización. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden hacer que el equipo pierda eficacia.

Todos los tipos de equipos electrónicos pueden causar interferencias electromagnéticas a otros equipos a través del aire o de otros cables conectados a él. No utilice cerca de este aparato dispositivos que puedan emitir señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, transceptores de radio o productos de radiocontrol, ya que esto puede hacer que el rendimiento de este aparato no cumpla las especificaciones indicadas. Cuando tales dispositivos estén cerca de este aparato, apague la alimentación de los mismos. El personal médico encargado de este aparato debe instruir a los técnicos, pacientes y demás personal que pueda estar cerca de este aparato para que cumplan plenamente los requisitos anteriores.

Para alcanzar plenamente el rendimiento CEM especificado, el usuario debe instalar el producto correctamente siguiendo los pasos descritos en el manual. Si se produce algún problema relacionado con la CEM, póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado por Reach Surgical, Inc.

El Trasduttore (con cable) y las Tijeras Ultrasónicas se definen como la parte aplicada de todo el sistema.

Precauciones para la instalación del producto

El equipo puede utilizarse en un entorno hospitalario, pero no incluye salas de blindaje contra radiofrecuencias alrededor de equipos quirúrgicos de radiofrecuencia activa o donde se coloquen equipos de impacto por resonancia magnética, ya que la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas en estos lugares es elevada.

Distancia de separación e impacto de los equipos fijos de radiocomunicación: la intensidad del campo magnético generado por los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos inalámbricos (celulares/inalámbricos), los receptores de radio móvil terrestre, los receptores de radioaficionados, las emisiones de radio AM y FM y los generadores de emisiones de televisión, etc., no puede medirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético generado por los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la medición del campo electromagnético. Si el valor medido de la intensidad del campo magnético en la ubicación del aparato supera el nivel de radiofrecuencia correspondiente especificado en la "Declaración antiinterferencias", deberá inspeccionarse el aparato para asegurarse de que puede funcionar con normalidad. Si se detectan condiciones de funcionamiento anormales, deberá considerarse la posibilidad de tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el equipo, o utilizar una sala antirradiofrecuencia.

1) Utilice el cable de alimentación proporcionado o designado por Reach Surgical, Inc. Los productos equipados con un enchufe de alimentación deben conectarse a una toma de corriente fija con toma de tierra de protección. No utilice ningún tipo de adaptador o conector para conectar el enchufe de alimentación.

2) Mantenga este aparato alejado de otros aparatos electrónicos en la medida de lo posible.

3) Siga los pasos para conectar el aparato.

Notas generales

El uso de la especificación del Cable.

El uso de los cables proporcionados por Reach Surgical, Inc no dañará el rendimiento CEM de este producto. Si se utilizan cables no especificados, el rendimiento CEM de este equipo puede reducirse significativamente.

(2) Precauciones para modificaciones no autorizadas

El usuario no deberá modificar este producto, de lo contrario el rendimiento CEM del mismo podría disminuir.

La modificación del producto incluye los siguientes cambios:

a. Cable (longitud, material y cableado, etc.).

b. Instalación/disposición del equipo.

c. Configuración/componentes del equipo.

d. Piezas de protección del equipo (apertura/cierre de la cubierta y piezas de fijación de la cubierta).

(3) Todas las cubiertas protectoras deben estar cerradas cuando utilice el equipo.

Se espera que este producto se utilice en el entorno electromagnético especificado a continuación, y el comprador y el usuario de este producto deben asegurarse de que se utiliza en este entorno electromagnético.

Rendimiento esencial

1. Para la salida de energía radioeléctrica de alta frecuencia avanzada, el sistema deberá garantizar que la desviación de la potencia nominal de salida no

supere el 20% del valor estándar.

2. Para la salida de energía de radio de alta frecuencia básica, el sistema deberá garantizar que la desviación de la salida de energía nominal no supere el 20% del valor estándar

Orientación y declaración del FABRICANTE - EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS		
El aparato está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
Emisiones RF CISPR 11	Grupo1	El dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de radiofrecuencia	Clase A	Las características de EMISIÓN de este equipo lo hacen adecuado para su uso en zonas industriales y hospitales
Corriente armónica IEC 61000-3-2	Clase A	
Cambios de tensión/fluctuaciones de tensión/parpadeo IEC 61000-3-3	Conforme	

Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética			
El aparato está destinado a ser utilizado en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo			
Prueba de INMUNIDAD	IEC 60601 nivel de prueba	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
Electrostática descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto de ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV aire	Contacto de ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están recubiertos de material sintético, La humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/rápidos IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, cortocircuitos interrupciones en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°. 0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0 0 % UT; ciclo 250/300	0 % UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315° 0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0 0 % UT; ciclo 250/300	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del ecógrafo quirúrgico El equipo requiere un funcionamiento continuado durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el Ultrasonido quirúrgico El equipo se alimentará de una fuente de alimentación ininterrumpida o de una batería.
Frecuencia de alimentación (50/60 Hz) Campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frecuencia de alimentación magnética Los campos deben ser de nivel característico. De una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.

Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética			
El dispositivo está destinado a su aplicación en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del aparato debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno			
INMUNIDAD prueba	Prueba IEC 60601 nivel	Cumplimiento nivel	Entorno electromagnético orientación
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz 6 V en bandas ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz	3V	Comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles El equipo no debe utilizarse más cerca de cualquier parte del aparato , incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación de frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	3V/m	$d = \frac{[3.5]}{\sqrt{E1}} \sqrt{P}$ $d = \frac{[3.5]}{\sqrt{E1}} \sqrt{P} \quad 80\text{MHz a } 800\text{MHz}$ $d = \frac{[2]}{\sqrt{E1}} \sqrt{P} \quad 800\text{MHz a } 2,7\text{GHz}$ <p>donde P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, determinadas mediante un estudio electromagnético del emplazamiento.3 deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias. Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con el siguiente símbolo:</p>  <p>El PUERTO DE ENCHUFE de los EQUIPOS y SISTEMAS ME se someterá a ensayo según lo especificado en la Tabla 9 de la norma IEC 60601-1-2 utilizando los métodos de ensayo especificados en la norma IEC 61000-4-3.</p>

Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia y los dispositivos.
El dispositivo está destinado a su aplicación en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de radiofrecuencia radiadas. El cliente o usuario del aparato puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia (transmisores) y El aparato según las siguientes recomendaciones, en función de la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal máxima de salida del transmisor (w)	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor /m		
	De 150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

NOTA: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Condiciones técnicas

Componentes necesarios para el funcionamiento del sistema: Instrumentos electroquirúrgicos, Trasduttore, Interruptor de pedal ultrasónico, Interruptor de pedal electroquirúrgico, Tijeras Ultrasónicas o Piezas de mano para electrocirugía Instrumento bipolar.

Consulte la descripción del producto para este componente.


Grado de protección contra descargas eléctricas	Ultrasónicos:  Pieza aplicada de tipo CF; Electrocirugía bipolar 
Grado de protección contra descargas eléctricas	Pieza aplicada a prueba de desfibrilación de tipo CF
Generador de infusiones nocivas	Clase I
Generador de infusiones nocivas	Equipo normal
Grado de protección contra la entrada nociva de agua	Interruptor de pedal: IP68
Categoría de gestión	Clase IIb
Requisitos de los parámetros del modo ultrasónicos:	
Potencia de entrada	Tensión de alimentación: 100-240V Frecuencia de alimentación: 50Hz/60Hz Potencia de entrada: 400VA
Requisitos de los parámetros del modo ultrasónicos:	
Frecuencia de excitación	54 kHz - 57 kHz
Excursión de vibración de la punta primaria	25 µm - 110 µm
Interruptor de pedal ultrasónico principal superficie de salida acústica Producto:	1,53~2,75 mm2
Reticulación secundaria acústica en la punta de Tijeras Ultrasónicas Área de salida:	19,32~35,88 mm2
Sonido de salida derivado en la punta del Interruptor de pedal ultrasónico en la punta de referencia Potencia de amplitud primaria	< 30W
Tipo de control de frecuencia del sistema	Independientemente de la carga, la frecuencia de excitación se ajusta automáticamente de forma continua.
Índice de reserva de marcha	No menos de 2,5
Requisitos de los parámetros electroquirúrgicos:	
Frecuencia de trabajo	400KHz ± 5%
Tensión máxima de salida	≤ 250V
Modo bipolar avanzado Corriente de salida máxima	≤ 5.5A
Modo bipolar básico Corriente de salida máxima	≤ 2.2A
Máxima tensión pico a pico de salida	≤ 500Vpk
Factor de cresta	1.6 ± 0.4
Potencia nominal	Radiofrecuencia bipolar avanzada: 270 W Radiofrecuencia Básica bipolar: 95W
Carga nominal	Radiofrecuencia bipolar avanzada: 30Ω Radiofrecuencia Básico bipolar: 200Ω

Condiciones del entorno operativo	Temperatura: 10 ° C a 30 ° C
	Humedad relativa: ≤ 70%.
Condiciones de transporte y almacenamiento	Rango de presión atmosférica: de 800 hPa a 1060 hPa
	Temperatura: de -30 ° C a + 55 ° C (generador, conmutador de pedal, adaptador)
	Temperatura: -10 ° C a + 55 ° C (Interruptor de pedal ultrasónico)
Fecha de fabricación	Humedad: ≤ 80%.
	Rango de presión atmosférica: de 800 hPa a 1060 hPa
Fecha de fabricación	La fecha de fabricación puede determinarse por el número de serie que figura en el panel trasero del Generador.
Cable de alimentación	Cumplimiento de los requisitos de certificación de la CCC Corriente nominal: 10A
Tasa de persistencia	Determinado por la pieza de mano del Trasduttore y la Tijeras Ultrasónicas utilizadas. Para obtener información sobre el índice de persistencia, consulte las Tijeras Ultrasónicas aplicables e Instrucciones de la pieza de mano del Trasduttore o el capítulo 7 - Advertencias y precauciones.
Fusible	€5 * 20 T8AH250V
Peso (sin embalaje)	Generador: 8 kg nominales

Volumen total	Generador OP9: (largo * ancho * alto): 34 cm-34 cm-16 cm
Disposición	Algunos componentes internos del Generador, el Conmutador de pedal y el Cable del conmutador de pedal contienen plomo. De acuerdo con las Requisitos y normativa para la eliminación. Elimine las pilas de acuerdo con las prácticas adecuadas de eliminación de residuos.
Clasificación AP/APG	No son equipos AP/APG.
Vida útil:	Vida útil: 7 años
Versión del software	V01.01

Forma de onda de salida bipolar


Curva potencia-carga de salida bipolar avanzada

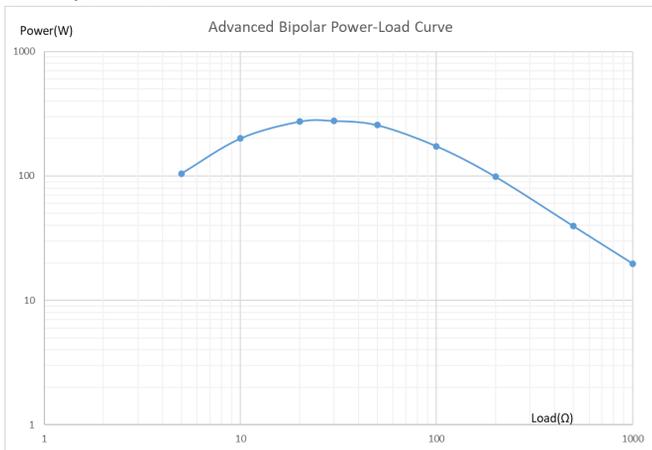

LÍMITE DE LA CURVA DE POTENCIA Salida máx: 270[W]			
Carga (Ω)	Límite inferior	Nominal	Límite superior
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Curva de potencia nominal de 270 vatios de salida a carga nominal de acuerdo con el límite de corriente/tensión del medidor de la curva de potencia. La curva de potencia representa la envolvente que varía en condiciones de funcionamiento.

Curva básica de potencia-carga de salida bipolar

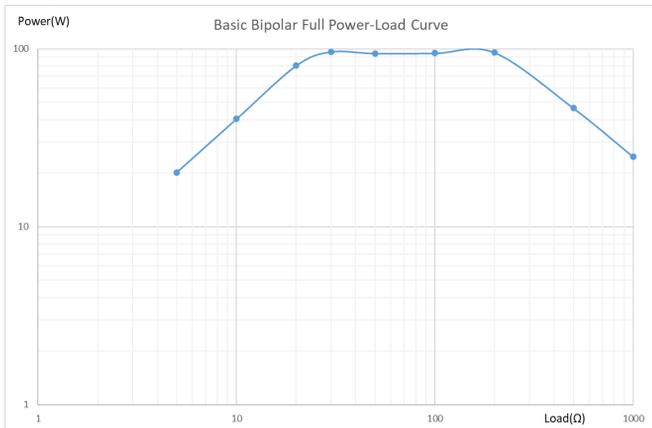


Límite de la curva de potencia máxima [W]: Potencia máxima 95 vatios			
Carga (Ω)	Límite inferior	Nominal	Límite superior
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Curva básica de media potencia-carga de salida bipolar

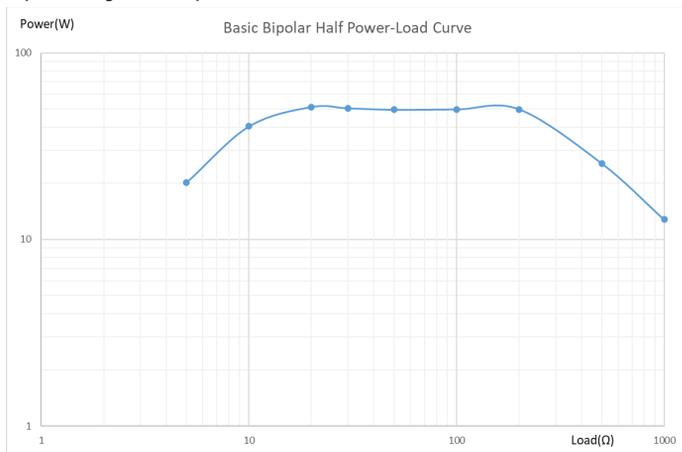

Límite de la curva de media potencia [W]: Potencia máxima 50 vatios			
Carga (Ω)	Límite inferior	Nominal	Límite superior
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Potencia de salida frente a ajustes de potencia para potencia en bipolar normal

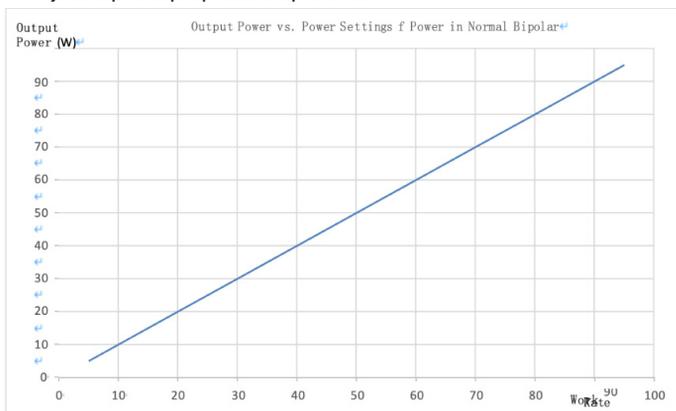

Potencia de salida frente al valor de ajuste de potencia para bipolar normal [W]; carga: 200Ω			
Potencia ajustada (W)	Límite inferior de potencia de salida (W)	Potencia nominal (W)	Límite superior de potencia de salida (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Servicio y garantía

Reach Surgical, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y mantenimiento preventivo durante el período de garantía especificado a continuación. La obligación de Reach Surgical bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar, a su elección, cualquier producto o pieza defectuosa que haya sido devuelta a Reach Surgical, Inc. o a su Distribuidor autorizado dentro del período de garantía aplicable y que se encuentre defectuosa a satisfacción de Reach Surgical. Esta garantía no se aplica a productos o piezas que hayan sido:

- Afectados negativamente debido al uso con dispositivos no autorizados fabricados o distribuidos por partes no autorizadas por Reach Surgical, Inc.
- Reparado o alterado fuera de la fábrica de Reach Surgical, si afecta a la estabilidad o fiabilidad del dispositivo según determine Reach Surgical.
- Sujeto a un uso inadecuado, negligencia o accidente.
- Utilizado de forma incompatible con el diseño, los parámetros de uso, las instrucciones y las directrices del producto o con las normas funcionales, operativas o medioambientales aceptadas por la industria para productos similares.

Períodos de garantía

Conector de energía bipolar básico (OP-BPC): 1 año para componentes y mano de obra.

Generador (OP9): 1 año para componentes y mano de obra.

Conmutador de pedal/cable de alimentación: 1 año para los componentes y la mano de obra.

Esta garantía es el recurso exclusivo para el comprador original y sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Reach Surgical, Inc. no será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente, incluidos los daños resultantes de la pérdida de uso, beneficios, negocio o fondo de comercio, salvo en los casos expresamente previstos por la legislación aplicable.

Reach Surgical, Inc. no autoriza a ninguna persona a asumir ninguna responsabilidad adicional en relación con la venta o el uso de sus productos. No existen garantías que se extiendan más allá de los términos aquí establecidos.

Reach Surgical, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos sin incurrir en ninguna obligación de aplicar retroactivamente dichos cambios a los productos vendidos o fabricados con anterioridad.

Ülevaade

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi järgmine teave. See sisaldab olulisi juhiseid nõuetekohase kasutamise, võimalike riskide ja toote või isikute võimaliku kahjustamise kohta. Mis tahes ebanormaalse olukorra korral järgige määratud juhiseid, et vältida enda või seadme kahjustamist. Nende juhiste eiramine võib kaasa tuua ohtutuse, jõudluse, garantii või hoolduse kahjustamise, mille eest tootja ei saa vastutada. Enne seadme kasutamist lugege ka Muundur ja Ultraheli käärid juhiseid.

Käesolev dokument on mõeldud abiks selle seadme kasutamisel. See ei ole viide kirurgiliste tehnikate kohta.

Kasutatud standardkonventsioonid: Ettevaatust, hoiatust ja märkusi sisaldavaid avaldusi.

Palun võtke arvesse järgmisi väiteid, mis on kategoriseeritud kui ETTEVAATUST, HOIATUST või MÄRKUS, mis annavad olulisi juhiseid ülesannete ohutuks ja põhjalikuks täitmiseks. Neid avaldusi võib leida kogu dokumentatsioonis ja neid tuleks lugeda enne protseduuri järgmise sammuga juurde asumist.

HOIATUS: See avaldus toob esile töö- või hooldusprotseduuri, praktika või tingimuse, mille mittetäielik järgimine võib põhjustada kehavigastusi või elu kaotamist.

ETTEVAATUST: See hoiatab kasutajat potentsiaalselt ohtliku olukorra eest, mille vältimise korral võib kasutaja või patsient saada kergemaid või mõõdukaid vigastusi, samuti kahjustada seadmeid või muud vara. See võib olla ka hoiatuseks ebatavaliste tavade eest. See hõlmab vajalikke ettevaatusabinõusid seadme ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks ning ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud nõuetekohasest või ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjustuste vältimiseks.

MÄRKUS: See väide viitab töötavale või tingimusele, mis on oluline ülesande tõhusaks täitmiseks.

Kirjeldus

ENER REACH elektrokirurgilist instrumenti (edaspidi "seade") kasutatakse meditsiinilistes operatsioonisaalides kirurgilistes protseduurides inimese kudede lõikamiseks, koagulatsiooniks ja vereosote sidumiseks. Seadmel on kaks eraldi pesa: üks ultraheli energia ja teine raadiosagedusliku lainekeju väljundiks. Raadiosagedusrežiimis annab Generaator erinevaid energiaskeeme sõltuvalt ühendatud instrumentidist/elektrokirurgiaseadmest. Kui on ühendatud täistatud bipolaarne instrument, edastab Generaator raadiosageduslikke lainekejusid arteriaalsete ja venoosete vereosote, lümfiteede ja kuni 7 mm läbimõõduga koekimpude sulgemiseks. Põhilise bipolaarse instrumendi ühendamisel väljastatakse pehmete kudede lõikamiseks ja koagulatsiooniks konstantse võimsusega energiat.

Ultraheli energia väljundrežiimil, kasutades TRA6 Muundur koos Ühekordselt kasutatav ultraheli skalpell CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, lõikab seade pehmeid kudesid, mis vajavad verejooksu kontrolli ja minimaalset termilist kahjustust, ning sulgeb veresooneid kuni 5 mm läbimõõduga. Ühendatuna seadmega Ühekordsed ultraheli käärid SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 ja SRE45, lõikab seade pehmeid kudesid, mis vajavad verejooksu kontrollimist ja minimaalset termilist kahjustust, ning sulgeb veresooneid kuni 7 mm läbimõõduga.

Kavandatav kasutusviis

Seade annab raadiosageduslikku energiat, et juhtida elektrokirurgilisi käiseseadmeid, mis on mõeldud vereosote lõikamiseks ja sulgemiseks ning kudede lõikamiseks, haaramiseks ja lahtilõikamiseks.

Lisaks sellele pakub Generaator ultraheli võimsust, et juhtida ultraheli-kirurgilisi instrumente, mis on mõeldud pehmete kudede sisselõikamiseks, kui soovitate verejooksu kontrollimist ja minimaalset termilist vigastust.

Näidustused

Seade annab raadiosageduslikku energiat elektrokirurgiliste käiseseadmete juhtimiseks, mida kasutatakse avatud operatsioonide või laparoskoopiliste operatsioonide ajal üld-, laste-, günekoloogilises, uroloogilises ja rindkerekirurgias, et lõigata ja sulgeda kuni 7 mm läbimõõduga veresooneid ning lõigata, haarata ja tükeldada kudesid.

Lisaks annab Generaator energiat ultraheli-kirurgiliste instrumentide juhtimiseks, mis on mõeldud pehmete kudede sisselõikamiseks, kui soovitate verejooksu kontrollimist ja minimaalset termilist vigastust. Ultraheli-kirurgilisi instrumente võib kasutada elektrokirurgia, laserite ja terasest skalpellide täienduseks või asendamiseks, et lõigata ja/või koaguleerida kude avatud operatsioonides või laparoskoopilistes operatsioonides üld-, pediaatria-, günekologia-, uroloogia- ja rindkereoperatsioonides ning lümfisoonete sulgemisel ja läbilõikamisel.

Kavandatud kasutaja

Seade on mõeldud kasutamiseks tervishoiutöötajatele kirurgilistes rakendustes.

Kavandatud kasutuskeskkond

Seade on mõeldud kasutamiseks haiglas.

Kavandatud patsientide populatsioon

See seade sobib 3-aastastele ja vanematele patsientidele, kes vajavad pehmete kudede sisselõikeid sisaldavaid kirurgilisi protseduure, mille puhul on verejooksu kontroll ja minimaalne termiline vigastus.


Kliiniline kasu

Seadet saab ohutult ja tõhusalt kasutada vereosote, koekimpude ja lümfisoonete sidumiseks ja jagamiseks.

Vastunäidustused

See seade on vastunäidustatud luu sisselõikude, rasestumisvastaste munajuhade oklusiooni ja koagulatsiooniprotseduuride puhul. Samuti ei ole see ette nähtud kasutamiseks neurokirurgias.

Süsteemi koostis

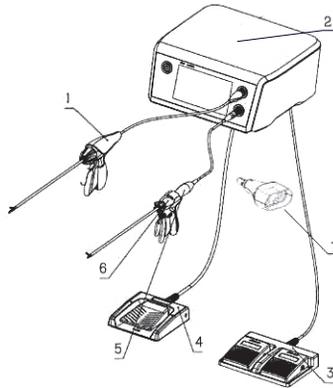

[01]Elektrokirurgia käsiinstrumendid	[02]OP9 Generaator
[03]Ultraheli jalglüliti	[04]Elektrokirurgiline jalglüliti
[05]Muundur	[06]Ultraheli käärid
[07]Elektrokirurgia bipolaarne muundur	

[01] Elektrokirurgiline käepide

Elektrokirurgilist käsi seadet, mis on ühendatud Generaator-ga, juhib kirurg protseduuri ajal. See rakendab RF elektrokirurgilist energiat koagulatsiooniks või sulgemiseks koe lõuad vahel. Instrument sisaldab ka tera kudede jagamiseks. Mudel: OSA23, OSA37, OSA44. Üksikasjalikku teavet leiate kasutusjuhendist.

[02] OP9 Generaator

Generaator pakub nii elektrokirurgilist energiat kui ka ultraheliravi energiat eraldi instrumentide ühendusportide kaudu. See koosneb šassiist, korpusest, elektroonikaplaadist, LCD-puutekraanist, toitelülitist ja liidestest lisaseadmete ühendamiseks.

Mudel: OP9

[03] Ultraheli jalglüliti

Kasutatakse ultraheli energia sisse/välja lülitamise kontrollimiseks kahe lüliti ("MIN" ja "MAX") abil. Mudel: OP-FSD

[04] Elektrokirurgiline jalglüliti

Kasutatakse kõrgsagedusliku energia sisse- ja väljalülitamise juhtimiseks ühe lülitiga.

Mudel: OP-FSS

[05] Muundur

Muundur muundab ühilduva Generaator elektrilise energia seadme labade mehaaniliseks liikumiseks. See on korduvkasutatav seade, mille kasutusega on piiratud. Muundur ei ole steriliseeritav ja seda tuleb enne kasutamist steriliseerida vastavalt juhistele. Üksikasjalikku teavet leiate TRA6 Muundur kasutusjuhendist.

Mudel: TRA6.

[06] Ultraheli käärid

Ultraheli käärid kasutab Muundur mehaanilist liikumist ja annab ultraheli energiat kudede lõikamiseks või koagulatsiooniks. Tuleb olla ettevaatlik, kuna mehaaniline vibratsioon ei ole tuvastatav ja võib tahtmatult mõjutada mittesihotstarbelisi piirkondi. Ultraheli käärid steriliseeritakse etüleenoksiidiga. Kui säilivusaeg on ületatud või steriliseerimispakend on kahjustatud, ei tohi Ultraheli käärid kasutada ja see tuleb hävitada. Üksikasjalikku teavet leiate Ultraheli käärid kasutusjuhendist.

Järgmised Ultraheli käärid ühilduvad OP9 Generaator-ga:

PD-seeria: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB-seeria: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE seeria: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektrokirurgiline bipolaarne liides [07] Elektrokirurgiline bipolaarne liides

Kasutatakse põhilise bipolaarse Elektrokirurgilised instrumentid ühendamiseks Generaator-ga kudede koagulatsiooniks.

Mudel: OP-BPC

Generaator Esipaneel

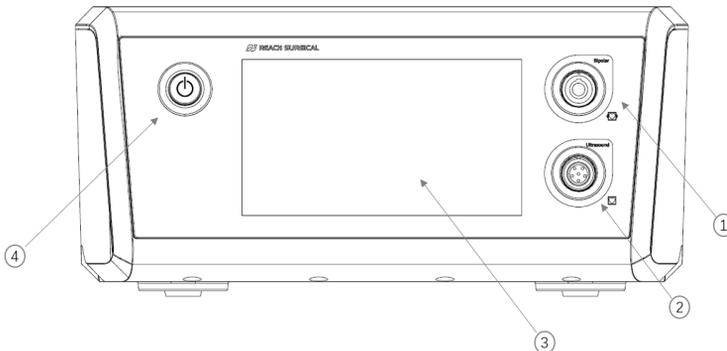

[01] Elektrokirurgiline pesa

Kasutatakse täiustatud bipolaarse Elektrokirurgilised instrumendid või elektrokirurgilise bipolaarse pistiku ühendamiseks.

[02] Muundur pistikupesa


Ühendab Muundur ja Generaator.

[03] LCD puutekraan

Kuvab süsteemiinfot ja on kasutajaliideseks juhtimisseadiste ja seadete reguleerimiseks.

[04] Toitelüliti Nupp

Generaator sisselülitamiseks vajutage; väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

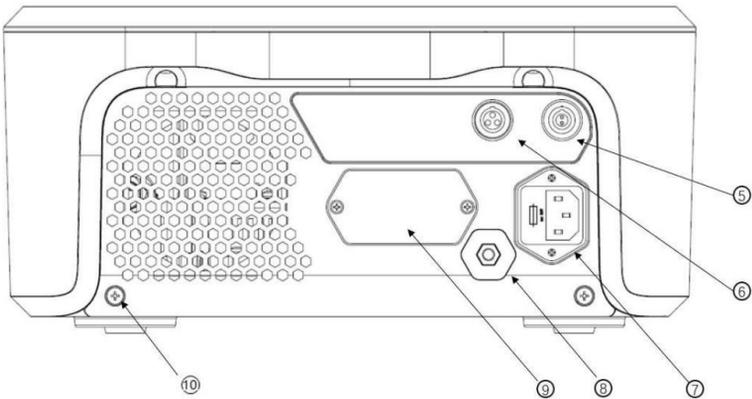Generaator Tagapaneel**[05] Elektrokirurgilise jalalüliti pistikupesa**

Ümmargune pistikupesa elektrokirurgilise jalalöögi ühendamiseks.

[06] Ultraheli jalalüliti pistikupesa

Ümmargune pesa ultraheli jalalüliti ühendamiseks.

[07] Pistikupesa

Ühendab toitejuhtme Generaator külge.

[08] Potentsiaalne tasandusport

Kui pistikupesa maandus on ebakindel, võimaldab see pesa ühendust kaitstud maandusega.

[09] Laiendusliides

Kasutatakse funktsioonide laiendamiseks ja hoolduseks.

[10] Paigaldusava**Kasutusjuhend**

Vaadake tegevuskeskkonna kohta esitatud juhiseid.

Välja pakkimine

Palun järgige alljärgnevat juhiseid komponentide kättesaamisel.

- Kontrollige, kas on olemas nähtavaid transpordikahjustusi. Kui leiate kahjustusi, võtke abi saamiseks ühendust Reach Surgical, Inc. või kohaliku esindajaga.

Komponendid, mis kuuluvad süsteemi (Üksikasjalikud tehnilised andmed ja tootekoodid on esitatud peatükis "Süsteemi tehnilised tingimused"):

Mudel	Kirjeldus	Komponent
OP9	Generaator	Generaator, toitejuhe, kasutusjuhend
TRA6	Muundur	Muundur koos kaabliga
OP-FSD	Ultraheli jalalüliti	/
OP-FSS	Bipolaarne jalalüliti	/
OP-BPC	Põhiline bipolaarne energiaühendus	/

Ohutusabinõud

- Seadmete kontrollimise ajal hoidke instrumentide distaalset otsa vigastuste vältimiseks eemal teistest seadmetest, kirurgilistest eesrietest, patsiendist või muudest esemetest.
- Rakendage vajalikke ohutusmeetmeid aurude olemasolu korral, järgides haigla protseduure ja eeskirju.

Ultraheli energia PD-seeria Ultraheli käärid abil

- Ühendage Muundur, jalalüliti ja PD-seeria Ultraheli käärid Generaator-ga.
- Pärast Muundur ja Ultraheli käärid testi läbimist reguleerige võimsustaset (1-5), kasutades LCD-ekraanil olevaid +/- ikoone.
- Vajutage Ultraheli käärid nupule "Min" või jalalüliti Min pedaalile, et aktiveerida ultraheli energia eelseadistatud võimsuse tasemel.
- Vajutage nuppu "Max" Ultraheli käärid või Min pedaal jalalüliti, et pakkuda maksimaalset energiataset.
- Energia väljastamise peatamiseks vabastage võti või jalalüliti.

Ultraheli energia koos SRB/SRE-seeria Ultraheli käärid-ga

- Pärast Muundur ja Ultraheli käärid testi läbimist reguleerige võimsustaset (1-5), kasutades LCD-ekraanil olevaid +/- ikoone.
- Vajutage seadme Energia edastamise nupp või jalgpedaali nuppu Min, et aktiveerida ultraheli energia eelseadistatud võimsuse tasemel.
- Vajutage seadmel Režiimiga Advanced Hemostasis (Hemostaasi erirežiim) energia edastamise nupp, et aktiveerida täiustatud hemostaasi režiim.
- Energia andmise peatamiseks vabastage nupp Ultraheli käärid või Jalgpedaal nupp.

Elektrokirurgiline bipolaarne energia koos täiustatud bipolaarsete instrumentidega.

- LCD-ekraanil kuvatakse täiustatud bipolaarse juhtimise ikooni ja reguleeritava käe juhtimise ikooni.
- Raadiosageduse aktiveerimiseks tõmmake seadme Trikkel või vajutage jalgpedaali.
- Generaator lõpetab energia väljastamise, kui sulgemine on lõpetatud, mida näitab ekraanil olev ikoon "lõpetatud".
- Kui liignatsioon on mittetäielik, kõlab hoiatustoon ja kuvatakse hoiatussümbol.

Elektrokirurgiline bipolaarne energia bipolaarse elektrokirurgilise instrumendiga

- LCD-ekraanil kuvatakse võimsuse väärtus, reguleeritavad ikoonid ja võimsuse taseme ribad.
- Võimsuse seaded ulatuvad 1-95 vattini, mille võimsus on reguleeritav.
- Valige soovitud väljundvõimsuse seade: Madal (15 vatti), Keskmine (30 vatti) või Kõrge (60 vatti).
- Raadiosageduse aktiveerimiseks vajutage nuppu käsilülil või jalgpedaalil.
- Energjaväljundi deaktiveerimiseks vabastage nupp.

Soovituste seadistamine

Efekti seaded	Võimsuse seadete vahemik	Kliiniline rakendus	Optimeeritud seade
Madal	1-15 vatti	Näiteks närvid/selgroog, käed ja näokirurgia.	- Väiksema pindalaga seadmed - Mikropiimad (0,4-2,2 mm)
Mid	16-40 vatti	Näiteks koagulatsioon pea/kaela, selgroo ja anatoomia ajal.	- Keskmise pindalaga seadmed - Mikropiimad (1,0-2,2 mm) - Väikesed laparoskoopilised laparoskoopilised pintsetid - Bipolaarsed käärid
Kõrge	45-95 vatti (5 vati sammud)	Näiteks pea/kaela ja plastiline kirurgia (sarnane keskmise mõjuga, kuid kiirema mõjuga).	- Suure pindalaga seadmed - Suured laparoskoopilised laparoskoopilised pintsetid

MÄRKUS: See seade ei ühildu neutraalse elektroodiga.

MÄRKUS: Ultraheli käärid ja RF elektriline skalpell on patsiendiga kokkupuutuvad osad.


Kasutades Generaator

Seadme sisselülitamine

- Süsteem on pärast sisselülitamist töövalmis. Kui Generaator on ühendatud vooluvõrku ja ootelüliti tuli põleb, on süsteem kasutusvalmis.
- Pärast ooterežiimi nupu vajutamist kuvatakse järgmine pilt:



- Kui Muundur või Ultraheli käärid ei ole ühendatud Generaator-ga või kui need on valesti ühendatud, kuvatakse järgmine pilt:

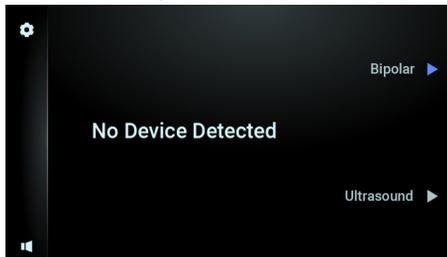


Kasutades ultraheli instrumenti (Muundur ja Ultraheli käärid)


Kui tuvastatakse Muundur ja Ultraheli käärid, kuvatakse järgmine pilt.



MÄRKUS: kui Muundur järelejäanud kasutusaeag on väiksem kui 10, kuvatakse järgmine pilt. Palun pöörake tähelepanu järelejäanud kasutuskordade arvule, sest Muundur tuleb välja vahetada, kui arv on muutunud nulliks.

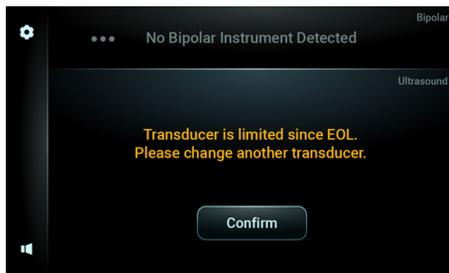


Järgnevalt kuvatakse järgmine pilt, teil palutakse vajutada Ultraheli käärid mis tahes nuppu, et alustada Ultraheli käärid testi avatud Lõuad-ga.




Vajutage suvalist nuppu ja kuvatakse järgmine pilt.




Kui Muundur test ebaõnnestub, kuvatakse järgmine pilt:

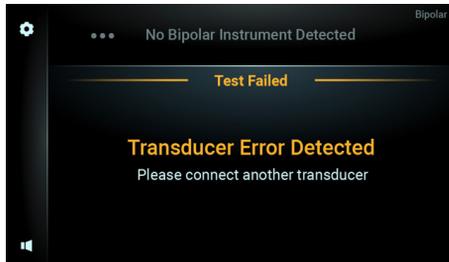


Kui test Ultraheli käärid ebaõnnestub, kuvatakse järgmine pilt



Kui Muundur ja Ultraheli käärid test on läbitud, kuvatakse järgmine pilt:

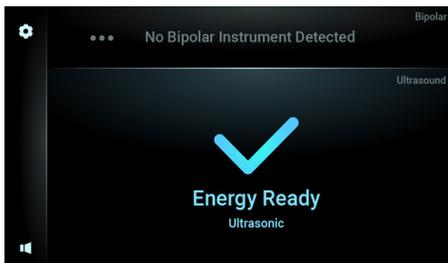

Kui ühendate Ultraheli käärid ilma täiustatud hemostaasifunktsioonita, kuvatakse järgmine tööekraan.

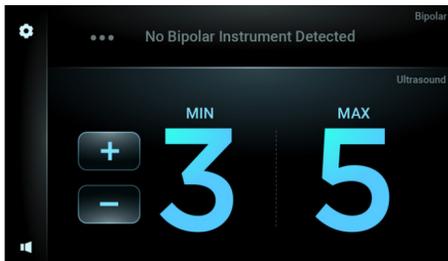


SRE Ultraheli käärid ühendamisel täiustatud hemostaasiga kuvatakse järgmine tööekraan.




Väljundrežiim on esile tõstetud, see on aktiveeritud.

Elektrokirurgilise instrumendi kasutamine


Kui tuvastatakse Muundur ja Ultraheli käärid, kuvatakse järgmine pilt.

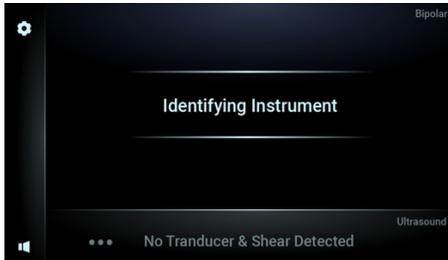

Kui elektrokirurgilise instrumendi test on läbitud, kuvatakse järgmine pilt:

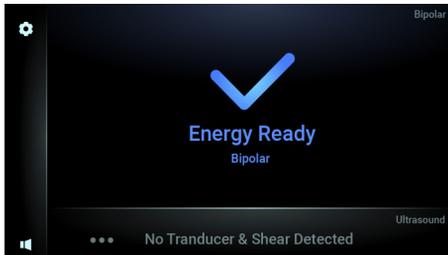

Täiustatud bipolaarse seadmega ühendamisel kuvatakse järgmine tööekraan.

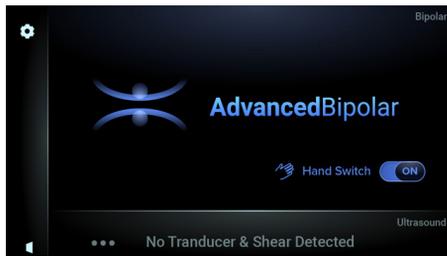


Tavalise bipolaarse seadmega ühendamisel kuvatakse järgmine tööekraan.




Kasutades elektrokirurgilist instrumenti ja Ultraheli käärid

Pange tähele, et kui Generaator on ühendatud nii bipolaarse elektrokirurgilise instrumendi kui ka Ultraheli käärid-ga, töötab süsteem praeguse seisundi kuvamiseks jagatud ekraani režiimis. Seade, mis on eelisjärjekorras, aktiveerib energia esimesena. See jagatud ekraani olek on näidatud allpool:

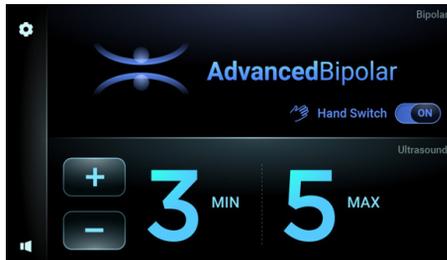

Süsteemi seaded


Süsteemi seadetele juurdepääsemiseks klõpsake ekraani vasakus ülannurgas asuval seadete ikoonil. Kättesaadavad on järgmised süsteemi seadistamisvõimalused:

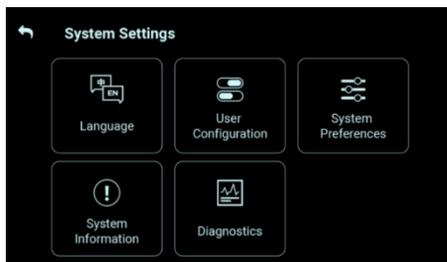


Keel: Klõpsates elemendil Keel kuvatakse keele valiku ekraan:




Kasutaja konfiguratsioon: Kasutajakonfiguratsiooni elemendil klõpsates kuvatakse kasutaja konfiguratsiooni ekraan:

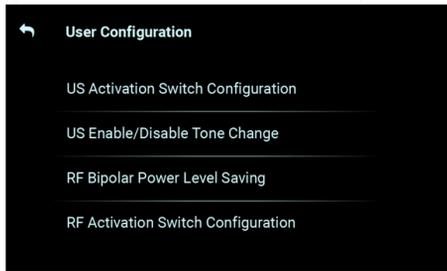


Süsteemi eelistused: Klõpsates elemendil Süsteemi eelistused kuvatakse süsteemi eelistuste ekraan:



Süsteemi info: Klõpsake ettevaatlikult elemendil System Info, et kuvada süsteemiinfo ekraan:

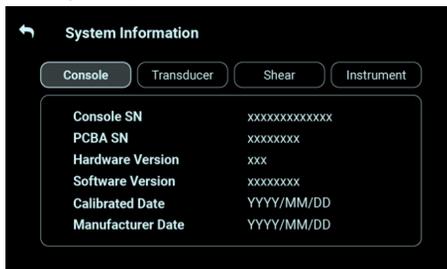

Diagnostika: Vajutades punktile Diagnostika, kuvatakse diagnostikaekraan:

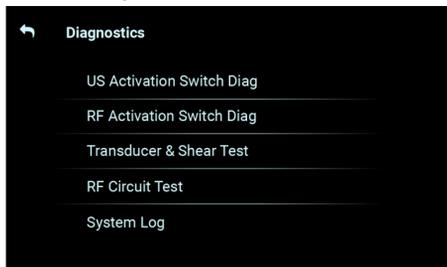

Süsteemi seadetest väljumiseks ja süsteemi ooterežiimi naasmiseks vajutage ekraani vasakus ülanurgas asuvat ikooni "Return".

Süsteemi väljalülitamine

Järgige alljärgnevat samme süsteemi ohutuks väljalülitamiseks:

Vajutage ooterežiimi nuppu: Leidke Generaator-l olev ooterežiimi nupp ja vajutage seda, et käivitada väljalülitamisprotsess.

Ühendage lahti Muundur ja Ultraheli käärid: Ühendage Muundur ja Ultraheli käärid ettevaatlikult süsteemist lahti. Vt kasutusjuhendit Muundur ja Ultraheli käärid nõuetekohase käsitsemise kohta.

Puhastamine: Puhastage Generaator, jalalüliti ja Muundur vastavalt peatükis "Hooldus" kirjeldatud protseduuridele.

Veaotsing

Generaator sisaldab mitmesuguseid hoiatussignaale ja veakoode, mis aitavad tuvastada ja diagnoosida komponentide vigu. Oluline on märkida, et need signaalid ja koodid on mõeldud pigem kliinilise otsustuse ja vaatluse toetamiseks kui nende asendamiseks.

Heli hoiatus

Töötav staatus	Heli tüüp	Võimalik põhjus ja meetmed
Enesekontrolli staatus	Tavaline heli	/
	Ebanormaalne heli	Avastatud on riistvaraline viga. Palun võtke remondiabi saamiseks ühendust tootjaga.
Kasutades ultraheli instrument	Maksimaalne helitase	/
	Min Level heli	/
	Ebanormaalne heli	Ultraheli käärid on kokku puutunud liigse koega. Vähendage kudede kokkupuudet Ultraheli käärid-ga. Kui pidev heli püsib, eemaldage ettevaatlikult kõik koe, mis võivad koguneda Ultraheli käärid otsa ümber. Muundur ja/või Ultraheli käärid puhul on tuvastatud viga. Palun pöörduge edasise abi saamiseks tootja poole või võtke ühendust klienditoega.
	ADVANCED heli	/
	ITS heli	/
Elektrokirurgilise instrumendi aktiveerimine	Täiustatud bipolaarne hoiatustoon	/
	Normaalne bipolaarne heli	/
	Ebanormaalne heli	Ebaõnnestunud lõikamine: Kui instrumendiga kokkupuutunud kude ei vasta lõikamisnõuetele, vähendage instrumendiga kokkupuutuva koe kogust. Kui vigastustoon jääb püsima, puhastage ettevaatlikult instrumendi otsa kogunenud kude. Riistvara rike: See viga näitab võimalikku riket vooluahelas või pistikus. Rikke või vea korral on soovitatav pöörduda tootja poole või otsida tuge, et saada asjakohaseid juhiseid ja lahendusi.

Veakoodid

Energy Platform Generaator on varustatud põhjaliku veatuvastussüsteemiga, mis koosneb hoiatustest ja süsteemivigadest. Rikke tuvastamisel annab Generaator hoiatussignaali, kuvab hoiatussignaali juhtpaneelil ja näitab vastavat veakoodi LCD-ekraanil. Järgige probleemi lahendamiseks allpool kirjeldatud samme:

Veakoodide tabel

Veakood	Vastav veateade
Hoiatus	Palun ühendage Ultraheli käärid ja Muundur õigesti
Hoiatus	Veenduge, et Lõuad on testimise ajal avatud
Hoiatus	Ultraheli käärid Avastatud viga
Hoiatus	Muundur järelejäänud aeg on null.
Hoiatus	Palun aktiveerige ainult üks nupp korraga
Hoiatus	Palun vähendage Ultraheli käärid-le rakendatavat jõudu
Hoiatus	Ultraheli käärid nuppu ja jalalülitit ei saa samaaegselt sulgeda.
Hoiatus	Nupp on kinni, palun kontrollige ja jätkake
Hoiatus	Kohandada Lõuad või klamber vähem koe
Hoiatus	Eemaldage seade kudedest
Süsteemi viga	Süsteemi viga
Süsteemi viga	Enesekontroll ebaõnnestus

Kui testimise ajal ilmub ekraanile viga, tehke järgmised toimingud:



- Veenduge, et kaabel Muundur on täielikult õiges suunas sisestatud.
- Kontrollige, kas Ultraheli käärid on õigesti pingutatud või kas Ultraheli käärid otsa ümber on kogunenud kude. Reguleerige Ultraheli käärid tihendust ja eemaldage ettevaatlikult koekogumid Ultraheli käärid ümbruse ümber. (Kui katse alustatakse enne operatsiooni, veenduge, et Ultraheli käärid on suunatud õhu poole. Kui kasutatakse Ultraheli käärid, veenduge, et kinnituslõug on avatud ja ei puutu kokku ühegi esemega).
- Kui probleem püsib, kaaluge Muundur või Ultraheli käärid väljavahetamist.
- Liigutage seadme töörežiimi.

MÄRKUS: Muundur ei pruugi korralikult toimida, kui selle temperatuur ületab määratud piiri. Sellisel juhul kasutage taastamiseks kohe teist Muundur või järgige allpool toodud samme, et teha kindlaks vea põhjus ja uurida võimalikke taastamismeetodeid:

- Laske Muundur jahtuda toatemperatuuril vähemalt 45 minutit. See jahutusmeetod kehtib ka juhul, kui Muundur muutub kuumaks pärast pikemat töötamist suure võimsusega.
- Kui Muundur ülekuumenemine ei ole ilmne ja probleem jääb lahendamata, võtke abi saamiseks ühendust tootja hooldustöötajatega.
- Peale kaitsmete ei ole Generaator-l ühtegi kasutajapoolset hooldust vajavat osa. Kõikide asendus- või hooldusvajaduste korral võtke ühendust Reach Surgical, Inc. poolt koolitatud ja volitatud hoolduspersonaliga või oma kohaliku esindajaga.

Seadme Generaator hooldust ja uuendusi tohivad teostada ainult Reach Surgicali poolt koolitatud ja volitatud hoolduspersonal.

Võimalike ohtude vältimiseks tuleks kaaluda küberturvalisuse ettevaatusabinõusid. Küberturvalisuse riske kujutavad endast järgmised intsidendid:

- Loata juurdepääs seadme mis tahes mitteseotud toodetele.
- Igasugune voltimata võrgusuhltus seadmega.
- Firmware või tarkvara uuendamine, mida Reach Surgical ei ole heaks kiitnud.

Hooldus

Generaator ja Basic Bipolar Energy Connector'i puhastamine ja desinfitseerimine

Puhastamine

Puhastage Generaator LCD-ekraan ja põhiline bipolaarne pistik vastavalt haigla protseduuridele ja eeskirjadele. Enne puhastamist veenduge, et Generaator peamine toiteallikas on lahti ühendatud ja toitejuhe on väljalaskeüksusest eemaldatud.

HOIATUS: Puhastamisprotseduure tuleb järgida hoolikalt, et vältida Generaator kahjustamist, elektrilöögi tekitamist või tuleohu tekkimist. Ärge tilgutage ega pritsige vedelikke Generaator peale või sisse ega kastke seda vedelikku.

Järgige puhastamiseks järgmisi samme:

- Valmistage neutraalse pH-ga pesuvahend või neutraalse pH-ga ensüümne pesuvahend vastavalt pesuvahendi tootja spetsifikatsioonile.
- Pühkige käsitsi kõik pinnad, sealhulgas Generaator ekraan, puhta pehme lapiga, mida on niisutatud väikese koguse puhastuslahusega.
- Pühkige kõik pinnad puhta, pehme lapiga, mida on immutatud sooja kraaniveega.
- Lõpuks pühkige kõik pinnad puhta pehme lapiga, et tagada nende kuivus.

Desinfitseerimine

- Kui Generaator saastub vere või kehavedelikega, tuleb see enne taaskasutamist desinfitseerida. Järgmised keemilised desinfitseerimisvahendid on kinnitatud Generaator jaoks: 70% isopropüülalkohol, 6% naatriumhüpokloriit, 10% vesinikperoksiid.
- Järgige tootja soovitusi desinfitseerimisvahendite nõuetekohase kasutamise, kontsentratsiooni ja kokkupuuteaja kohta.
- Veenduge, et desinfitseerimisvahendid on seadistatud ja neid kasutatakse vastavalt tootja juhistele.

Jalalüliti puhastamine

Puhastage jalalüliti ja kaablit pärast iga kasutamist, kasutades järgmist protseduuri:

- Ühendage jalalüliti Generaator lahti.
- Valmistage neutraalse pH-ga ensüümne pesuvahend vastavalt tootja juhistele.
- Ühendage kaabel kindlalt jalalülitiga ja kastke need 2 minutiks puhastuslahusesse.
- MÄRKUS:** Veenduge, et Generaator ühendamiseks kasutatav jalalüliti kaabel oleks täiesti kuiv, et vältida juhuslikku aktiveerimist.
- Pärast kasutamist puhastage käsitsi jalalüliti ja kaabel pehme harjastega harjaga puhastuslahuses.
- Loputage jalalüliti ja kaablit põhjalikult sooja kraaniveega vähemalt 1 minuti jooksul.

ETTEVAATUST: Hoidke kaabel ja jalalüliti loputuse ajal kindlalt ühendatud.

- Pühkige kõik pinnad puhta pehme lapiga.

HOIATUS: Ärge kasutage jalalüliti puhastamiseks ultraheli puhastusseadet.

HOIATUS: Ärge lülitage Generaator-i toiteallikast sisse enne vahelduvvoolukaabli ühendamist. Veenduge, et kõik ühendused on enne kokkupanekut kuivad.

Muundur puhastamine ja desinfitseerimine

Muundur on tarnitud mittesteriliselt ja vajab enne iga kasutamist põhjalikku puhastamist ja steriliseerimist.

Puhastamine:

Puhastage muundur põhjalikult vastavalt järgmistele sammudele:

- Loputage muundur kruvipoolt ülispoole ja puhastage seda puhastatud veega pehmete harjastega harja abil, kuni pinnal ei ole enam plekke;
- Muundur leotatakse pH-neutraalses ensüümilises pesuaines (peamised koostisosad: proteaas, lipaas, amülaas, tsellulaas, pektinaas ja muud bioloogilised ensüümid, keskkonnasõbralik pindaktiivne aine, roostetõrjefaktor ja stabilisaator) kuni 10 minuti jooksul sobival temperatuuril 15°C - 65°C. Pesuaine ja puhastatud vee suhe on 1:400.

- Loputage muundurit kruvipoolt ülispoole 2 minutit puhastatud veega;
- Puhastage ühenduskruvi, skalpelli kinnituspind ja pistik alkoholiga.
- Leotage muundurit 75% metüülsinilise alkoholiga ning hoidke ja lokutage seda 30 korda;
- Loputage muundurit kruvipoolt ülispoole 2 minutit puhastatud veega.

Märkus: Ultrahelipuhastusvahendite kasutamine ei ole muunduri puhul soovitatav.

Kuivatamine:

Kuivatustemperatuur: 50 ~ 70 °C, kuivatusaeg: 30min.

Muunduri steriliseerimine:

Pärast ülaltoodud puhastamist- ja kuivatamisetappe tuleb muundur steriliseerida ühe allpool loetletud meetodi abil.

Auruga steriliseerimine (121 °C)

- Tupp tuleb paigaldada enne steriliseerimist. Muundur tuleb steriliseerimise ajal ümber mähida. Asetage muundur steriliseerimiseks kõrgtemperatuurilisse aurusterilisaatorisse, mille temperatuur on 121 °C ja kestus 30min.

- Kuivatustemperatuur: 50 ~ 70 °C, kuivatusaeg: 30min.

Auruga steriliseerimine (134 °C)

- Tupp tuleb paigaldada enne steriliseerimist. Muundur tuleb steriliseerimise ajal ümber mähida. Asetage muundur steriliseerimiseks kõrgtemperatuurilisse aurusterilisaatorisse, mille temperatuur on 134 °C ja kestus 10 minutit.

- Kuivatustemperatuur: 50-70 °C, kuivatusaeg: 30min.

Ohutus- ja funktsionaalsed testid

Tagada Muundur, Generaator ja jalalüliti ohutus- ja funktsionaalsete testide läbiviimine vastavalt haigla menetlustele ja eeskirjadele. Muude mitme patsiendi poolt kasutatavate komponentide ohutus- ja funktsioonikatsete jaoks vaadake iga komponendi kasutusjuhendit.

Ohutustesti

Generaator: Sertifitseeritud haiglatehnikud peaksid tegema lekkevoolukatset.

Jalalüliti: Kontrollige pedaali, kaabli pistikut ja kaabli pragude või kahjustuste suhtes. Vahetage kõik kahjustatud komponendid välja.

Muud komponendid: Kontrollige kõiki teisi komponente vastavalt nende kasutusjuhendile.

Funktsionaalne test

Ultraheli režiim

- Valmistage ette PD Ultraheli käärid komplekt ja ühendage Muundur vastavalt II peatükis "Seadme paigaldamine ja kasutamine" esitatud juhistele.
- Kontrollige, kas on võimalik siseneda tööseisundisse. Erinevatel Ultraheli kääridel võivad olla erinevad sisenedamisliidesed. Üksikasjalikud juhised leiata 2. peatüki 1. osa 3. jaost.
- Kinnitage, et ekraanil kuvatakse MIN võimsustase 3 ja MAX võimsustase 5.
- Vajutage võimsuse suurendamise ja vähendamise nuppe, et tagada MIN võimsuse taseme reguleerimine tasemetest 1 kuni 5.
- Lülitage Generaator sisse ja lülitage see ultraheli töörežiimi. Kontrollige, kas Muundur ja Ultraheli käärid on õigesti ühendatud.

- Kui lõug on avatud, vajutage jalalüliti nuppu "MAX". LCD-ekraanil peaks ilmuma MAX võimsustase "5" ja kostuma aktiveerimistoon.
- Kui lõug on avatud, vajutage jalalüliti nuppu "MIN". LCD-ekraanil peaks kuvama MIN-tugevuse taset ja kostuma aktiveerimistoon.

HOIATUS: Enne süsteemi aktiveerimist veenduge, et lõualu oleks eemal kudetest, teistest instrumentidest või muudest esemetest, et vältida kasutaja vigastusi.

Bipolaarne elektrokirurgiline režiim

- Ühendage täiustatud bipolaarne elektrokirurgiline instrument/baasiline bipolaarne instrument vastavalt juhistele.
- Kontrollige, kas süsteem saab siseneda tööliidesesse. Bipolaarses pühirežiimis peaks kuvama 30 võimsustaseme ikooni, samas kui täiustatud bipolaarses režiimis peaks kuvama ikooni "täiustatud bipolaarne".
- Puudutage kergelt võimsuse suurendamise ja vähendamise klahve bipolaarses pühirežiimis, et kinnitada, et võimsust saab reguleerida vahemikus 1 kuni 95. Puudutage madala, keskmise ja kõrge võimsuse riba, et lülituda ette 15, 30 ja 60 vahel.
- Lülitage Generator välja ja oodake 5 sekundit. Seejärel lülitage Generator toiteallikasse sisse ja oodake 10 sekundit. Kontrollige, kas bipolaarses pühirežiimis kuvatakse 30 võimsustaseme liides ja täiustatud bipolaarses režiimis kuvatakse "täiustatud bipolaarne" liides. Kontrollige, kas Generator on aktiveeritud vastavalt etteantud nõuetele.
- Ühendage edasijõudnud ja Basic bipolaarne Elektrokirurgilised instrumendid ja vajutage ühe jalalüli. Kontrollige, kas juhtpaneelil vilguvad võimsustaseme näidud ja kuulake aktiveerimise heli.

HOIATUS: Enne süsteemi aktiveerimist on rangelt keelatud lubada Ultraheli käärid kokkupuudet kudede, muude instrumentide või muude esemetega, et vältida kasutaja vigastusi.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Süsteemiga seotud

- Lugege enne kasutamist juhiseid ja järgige haigla kliinilise praktika juhiseid ultraheli- ja elektrokirurgia, günekoloogia ja laparoskoopia puhul.
- Minimaalselt invasiivsed seadmed võivad tootjati erineada. Kui eri tootjate minimaalselt invasiivseid instrumente ja tarvikuid kasutate operatsioonis samaaegselt, kontrollige enne operatsiooni instrumentide ja tarvikute ühilduvust ning kontrollige, kas inimkehasse sisestatud tarvikutel on karedad pinnad, teravad servad või väljaulatavad osad, mis võivad põhjustada ohutusrisiki.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult koolitatud ja litsentseeritud kirurgidele. Ärge kasutage elektrokirurgilisi seadmeid, kui teid ei ole nõuetekohaselt koolitatud nende kasutamiseks konkreetse protseduuri jaoks, mida teil on vaja teostada. Selle seadme väljaõppeta kasutamine võib põhjustada patsiendile tahtmatult tõsiseid vigastusi, sealhulgas soole perforatsiooni ning teadvustamata ja parandamatut koenekroosi.
- Ärge avage seadme Generatori korpusi ilma loata, et vältida võimaliku elektrilöögi ohtu. Seadme mis tahes remonti ja uuendamist peab teostama Reach Surgical, Inc. poolt koolitatud ja volitatud teenindaja. Ärge kasutage seda instrumenti ühelgi muul eesmärgil kui meditsiinilise kirurgia jaoks.
- Laser-, elektrokirurgiliste ja ultraheli protseduuride põhimõtteid ja tehnikat põhjalik tundmine on oluline, et vältida nii patsiendi kui ka meditsiinipersonali šoki- ja põletusohu ning selle seadme või muude meditsiiniseadmete kahjustamist. Elektrisilotsiooni või maandamist ei tohi kahjustada. Ärge kastke elektrokirurgilisi seadmeid vedelikesse, välja arvatud juhul, kui konstruktsioon nõuab seda ja märgistus ütleb, et neid tuleb kasutada.
- Ohutu ja tõhus ultraheli- ja elektrokirurgia ei sõltu mitte ainult seadmete konstruktsioonist, vaid suuresti ka paljudest operaatori poolt kontrollitavatest teguritest. Ohutuse ja tõhususe parandamiseks lugege, mõistke ja järgige seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Nagu kõigi energiaallikate (elektrokirurgia, laser või ultraheli) puhul, tuleb arvestada kantserogeensete ja nakkusohutega, mida paljud koe kõrvalsaadused, nagu suits ja aerosoolid, võivad põhjustada. Nii avatud kui ka endoskoopiliste protseduuride puhul tuleb järgida asjakohaseid ettevaatusabinõusid, nagu kaitseprillid, filtreerivad maskid ja tõhusad suitsueemaldusseadmed.
- Pärast seadme eemaldamist kontrollige koe hemostaasi. Kui hemostaas puudub, tuleb hemostaasi saavutamiseks kasutada sobivaid meetodeid.
- Reach Surgical, Inc. poolt mittevõetatud ettevõtte toodetud või leivatud tooted ei pruugi seadmega ühilduda. Selliste toodete kasutamine võib põhjustada ootamatuid tulemusi ja vigastada kasutajat või patsienti.
- Hääreohu vähendamiseks tuleb seade ja kest ühendada sõltumatule vooluahelale.
- Seade ei sobi kasutamiseks tuleohtliku anesteetikumide segu koos õhuga või hapniku või dilaamastikoksiidiga. Võimalik sädemete tekkimine kokkupuurte tõttu teiste metalliseadmetega. Sädemed võivad süttida süttivaid gaase, näiteks põlvgaase.
- Peab töötama nõutavas ümbristeva keskkonna töitemperatuuril vahemikus.
- Väljundi pistikupesa pinge peab vastama standardi Generatori nõuetele (peatükki "Süsteemi tehnilised tingimused"). Kui toiteallikas ei ole õigesti ühendatud, võib see Generatori kahjustada ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju ohtu.
- Tuleohtu vältimiseks ärge kasutage pikendusjuhtmeid.
- Ärge lülitage aktiveerimistoon kuuldamatu tasemele. Kirurgilise meeskonna töötajad võivad aktiveerimistooni märgata, kui Generator annab energiat.
- On tõestatud, et elektrokirurgia käigus tekkinud suits võib kahjustada patsienti või kirurgilise meeskonna töötajaid. Soovitakse piisavat ventilatsiooni kirurgilise suitsueemaldaja või muude vahenditega.
- Ultraheli-kirurgilises integreeritud Generator on mõned komponendid, mis tarnitakse mittesteriilsena (nt Muundur). Steriliseerige toode vastavalt vajadusele enne süsteemi paigaldamise alustamist. Puhastamis- ja steriliseerimisjuhiseid leiate igast vastavast juhendist.
- Kasutajate või patsientide vigastuste vältimiseks peab Ultraheli käärid enne tsestnupu vajutamist ja süsteemi kontrolli ajal vältima teisi seadmeid, kirurgilisi linte, patsiente või muud esemeid. Süsteemi kontrollimisel ja katseteotul tuleb rakendada ohutusmeetmeid aerosoolide kasutamise korral (vastavalt haigla eeskirjadele).
- Ärge avaldage lõualuudele liiga suurt survet, et vältida ultraheli energia edastamise takistamist.
- Kasutaja vigastuste vältimiseks peab teia enne süsteemi aktiveerimist vältima kokkupuudet kudede, teiste seadmete või muude esemetega.
- Kui vedelikku pritsitakse või valatakse Generatori peale või sisse või kui Generatori valatakse või valatakse vedelikku, võib see Generatori kahjustada ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju ohtu.
- Süüteallikateks võivad olla nii sädemete tekkimine kui ka anuma sulgemisega seotud kuumutamine. Salvrätik ja käsn peaksid jääma niiskeks. Hoidke elektrokirurgilised elektroodid eemal põlevatest materjalidest ja hapnikurikkast (O₂) keskkonnast.
- Kui Muundur on oluliselt kahjustatud või kui mõni osa näib pärast puhastus- ja desinfitseerimishooldust kahjustuse märke, visake see ära. Kahjustatud osad on selgelt märgistatud, et vältida väärkasutust enne edasist käitlemist.
- Ühekordsed jäätmed ja elektroonikajäätmed kõrvaldatakse vastavalt haigla eeskirjadele ja neid ei tohi keskkonna saastamise vältimiseks omavoliliselt ära visata.
- Vältige Generatori kasutamist teiste seadmete lähedal või nende peal. Kui on vaja kasutada kõrvuti või virmas, jälgige Generatori ja teisi seadmeid, et tagada nõuetekohane töö.
- Seade ei sisalda ühtegi operaatori poolt hooldatavat osa. Hoolduse saamiseks võtke ühendust oma Reach Surgicali müügiesindaja või hoolduspersonaliga.
- Enne kasutamist kontrollige kõiki süsteemiga ühendatud seadmeid ja ühendusi. Kontrollige, et seade töötab ettenähtud viisil. Ebakorrektnel ühendus võib põhjustada valguskaare tekkimist, sädemete tekkimist, seadme talitlushäireid või soovimatuid operatsioonitulemusi.
- Elektrilöögi ohtu vältimiseks tuleb see seade ühendada ainult kaitsemaandusega voolvõrku.
- Hoidke Generatori ja muude elektroonikaseadmete (nt monitoride) vahel võimalikult kaugel. Ärge risti ega see elektrijuhtmeid elektrooniliste seadmetega. Generator võib põhjustada häireid teistes elektroonikaseadmetes.
- Süsteemi tuleb kasutada ettevaatlikult sisemise ja väliste südamestimulaatorite puhul. Süsteemi Elektrokirurgilised instrumendid kasutamist tingitud häired võivad põhjustada südamestimulaatori asünkroonne oleku või täielikult takistada südamestimulaatori toimimist. Kui südamestimulaatoriga patsientidel on ette nähtud kasutada elektrokirurgilisi või koeplommimisseadmeid, võtke lisateabe saamiseks ühendust südamestimulaatori tootja või haigla kardioloogiaosakonnaga.

- Olge ettevaatlik, kui panete seadmeid Generaator peale või asetate Generaator elektriliste seadmete peale. See on ebastabiilne konfiguratsioon ja ei taga piisavat jahutust.
- Kui Generaator ebaõnnestub, võib see põhjustada operatsiooni katkemise. Varustusel peab olema kättesaadav.
- Kui kohalikul eeskirjal seda nõuavad, tuleb Generaator ühendada haigla ekvipotentsiaalühendusega, kasutades selleks ekvipotentsiaalkaablit.
- Kui süsteemi ja füsioloogilise jälgimise seadmeid kasutatakse samal patsiendil samaaegselt, tuleb kõigil jälgimiselektroodid paigutada seadmeid võimalikult kaugel.
- Bipolaarses põhirežiimis valige soovitud efekti saavutamiseks väikseim võimalik väljundvõimsus.
- Kõrgsagedusliku kirurgilise seadme rike võib põhjustada väljundvõimsuse ootamatut suurenemist.
- Generaator ja põhiline bipolaarne elektrokirurgiline ühenduskoht võib olla vee või tahkete osakeste poolt läbitud. Kasutamise ja puhastamise käigus tuleb vältida vee või tahkete osakeste sissetungi.
- Kui süsteimi kasutatakse koos endoskoobiga, võib see suurendada patsiendi keha lekkevoolu. Pöörake protseduuri ajal tähelepanu.
- Teade kasutajale ja/või patsiendile, et igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teavitada Reach Surgical, Inc. aadressil Reachquality@reachsurgical.com. ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Instrumentidega seotud

Kirurgiliste protseduuride ajal on oluline olla teadlik, et instrumentide Ultraheli käärid, Ultraheli käärid pad ja Völli otsaosa võib olla kõrgendatud temperatuuriga, kui ultraheli või bipolaarse elektrokauteriga pikemat aega kudedele töödeldakse. Ohutuse tagamiseks on väga oluline vältida nende instrumentide komponentide juhuslikku kokkupuudet kudede, kirurgiliste esriiete, kirurgiliste mantlite või muude mitteseotud alade vahel kogu protseduuri jooksul.

Lisaks sellele on väga oluline olla ettevaatlik bipolaarse seadme paigutamisel. Elköige ei tohi seda asetada põlevate materjalide, näiteks marli või kirurgiliste esriiete lähedusse või nendega kokkupuutes. Selles kontekstis kasutatavad bipolaarsed instrumentid võivad kasutamise ajal tekitada kuumust, mis võib põhjustada tulekahjuhuuto. Kui bipolaarselt elektrokirurgilist instrumenti Generaator ei kasutata, tuleb seda nõuetekohaselt hoistada kaitsekastis või hoida seda patsiendist, kirurgilise meeskonna liikmetest ja mis tahes põlevatest materjalidest ohutusse kaugusesse.

MÄRKUS: Lisahoiatusi ja ettevaatusabinõusid leiate vastavatest kasutusjuhenditest.

EMC teave

Toode on läbinud elektromagnetilise ühilduvuse testi, mis vastab meditsiiniseadmete standardi IEC60601-1-2 piirangutele. Need piirangud tagavad mõistliku kaitse kahjulike häirete eest tavapärasest meditsiiniseadmetest.

Toote koostis

Seerianumber	Osa nimi	Mudeli/versiooni nr.	Märkused
1	Elektrokirurgiline instrument	OP9	/
2	Muundur ultraheli käepidemele	TRA6	Ühilduv kasutamine
3	Ultraheli käärid Süsteem ühekordseks kasutamiseks Ultraheli käärid	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Ühilduv kasutamine
4	Ühekordselt kasutatav ultraheli kõrgsageduslik kirurgia seade Kudede tihendaja	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultraheli jalglüliti	OP-FSD	/
6	Elektrokirurgiline jalglüliti	OP-FSS	/
7	Elektrokirurgiline bipolaarne liides	OP-BPC	/

Tootekaabel

Seerianumber	Kaabli nimi	Pikkus (m)	Varjestatud
1	Jalajuhtseadme kaabel	3	Jah
2	Toitejuhe	5	Ei
3	Bipolaarne elektrokirurgiline kaabel	3	Ei
4	Kaabel Muundur	2.9	Jah

EMC jõudlus

See seade võib olla teiste meditsiiniseadmete ja raadioside poolt põhjustatud raadiosagedusihäirete all. Selliste häirete vältimiseks on seda toodet testitud vastavalt standardile IEC 60601-1-2 ja see vastab selle nõuetele. Reach Surgical, Inc. ei garanteeri siiski, et üksikutes paigalduskeskkondades ei esine absoluutselt mingeid häireid.

Kui leitakse, et seade on häiritud (mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega), peaks kasutaja (või Reach Surgical, Inc. poolt heaks kiidetud hoolduspersonal) püüdma võtta ühe või mitu järgmistest meetmetest, et häirete probleemi lahendada:

Reguleerige seda mõjutava seadme suunda või asendit.

Suurendage selle seadme ja saatva seadme vahelist kaugust.

Kasutage selle seadme toiteallikana muid toiteallikaid (mitte seadme mõjutamiseks kasutatavat energiat).

Muude soovitusete saamiseks konsulteerige tarnijaga või teenindava esindajaga.

Tootja ei vastuta mis tahes häirete eest, mis on põhjustatud järgmistest olukordades: kasutada muid kui soovitatud ühenduskaableid; muuta või modifitseerida seda seadet ilma loata. Lubamatud muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada seadme tõhususe kadumist.

Igasugused elektronikaesadmed võivad tekitada elektromagnetilisi häireid teistele seadmetele õhu või nendega ühendatud kaablite kaudu. Ärge kasutage selle seadme läheduses seadmeid, mis võivad kiirata RF-signaale, näiteks mobiiltelefonid, radiotransceiverid või raadiojuhtimisseadmed, kuna see võib põhjustada selle seadme talituse mittevastavust ettenähtud spetsifikatsioonidele. Kui sellised seadmed on selle seadme läheduses, lülitage nende seadmete toide välja. Selle seadme eest vastutav meditsiinitöötaja peaks juhendama tehnikuid, patsiente ja teisi töötajaid, kes võivad olla selle seadme läheduses, et nad järgiksid täielikult ülaltoodud nõudeid.

Et saavutada täielikult ettenähtud EMV-omadused, peab kasutaja paigaldama toote õigesti vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud sammudele. EMC-ga seotud probleemide korral võtke ühendust Reach Surgical, Inc. poolt heaks kiidetud hoolduspersonaliga.

Muundur (koos kaabliga) ja Ultraheli käärid on määratletud kui kogu süsteimi rakendatava osa.

Ettevaatusabinõud toote paigaldamisel

Seadmeid võib kasutada haiglateskonnas, kuid need ei hõlma raadiosageduslikke varjesturuumi aktiivsete raadiosageduslike kirurgiliste seadmete ümber või seal, kus on paigutatud magnetresonantsi mõjutavaid seadmeid, sest elektromagnetilise häire intensiivsus on nendes kohtades suur. Paiksete raadiosideseadmete eralduskaugus ja mõju: magnetvälja tugevust, mida tekitavad paiksed saatjad, näiteks traadita (mobiiltelefonid/sidevabade) telefonide tugijaamad, mobiilsild vastuvõtjad, radioamatööride vastuvõtjad, AM ja FM raadiosaated, teleseadmed Generaator jne, ei saa teoreetiliselt täpselt mõõta. Paiksete raadiosaatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks kaaluda elektromagnetvälja mõõtmist. Kui magnetvälja

tugevuse mõõdetud väärtus seadme asukohas ületab "Häirete vastase avalduse" vastavat raadiosageduse taset, tuleb seadet kontrollida, et tagada selle normaalne töö. Kui leitakse ebanormaalset töitingimused, tuleks kaaluda lisamõõtmisi, näiteks seadme ümberorienteerimist või ümberpaigutamist või raadiosagedusevastase ruumi kasutamist.

- 1) Kasutage Reach Surgical, Inc. poolt pakutatavat või määratud toitejuhet. Tooteid, mis on varustatud toitepistikuga, tuleb ühendada kaitsva maandusega fikseeritud pistikupeassa. Ärge kasutage toitepistiku ühendamiseks mingit tüüpi adapterit või pistikut.
- 2) Hoidke seda seadet võimalikult kaugel teistest elektroonikaseadmetest.
- 3) Seadme ühendamiseks järgige samme.

Üldised märkused

(1) Kaabli spetsifikatsioon.

Reach Surgical, Inc. poolt pakutatavate kaablite kasutamine ei kahjusta selle toote EMV-omadusi. Spetsifitseerimata kaablite kasutamisel võib selle seadme EMC-tulemus oluliselt halveneda.

(2) Ettevaatusabinõud omavoliiliste muudatuste korral

Kasutaja ei tohi seda toodet muuta, vastasel juhul võib selle toote EMV-omadused halveneda.

Toote muutmine hõlmab järgmisi muudatusi:

- a. Kaabel (pikkus, materjal ja juhtmestik jne).
- b. Seadmete paigaldamine/paigaldamine.
- c. Seadmete konfiguratsioon/komponendid.
- d. Seadme kaitseosad (kaane avamine/sulgumine ja kaane kinnitamine).

(3) Kõik kaitsekatted peavad olema seadme kasutamise ajal suletud.

Seda toodet kasutatakse eeldatavalt allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas ning selle ostja ja kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse selles elektromagnetilises keskkonnas.

Oulune jõudlus

1. Täiustatud kõrgsagedusliku raadioenergia väljundvõimsuse puhul peab süsteem tagama, et nimivõimsuse väljundvõimsuse kõrvalekalle ei ületa 20% standardväärtusest.

2. Põhilise kõrgsagedusliku raadioenergia väljundvõimsuse puhul peab süsteem tagama, et nimivõimsuse väljundvõimsuse kõrvalekalle ei ületa 20% standardväärtusest.

Juhised ja TÖÖTAJA deklaratsioon - ELEKTROMAGNEETILINE EMISSIOOTSUS		
Seade on ette nähtud kasutamiseks järgnevalt määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Seade e klient või kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.		
Heitkogustest test	Vastavus	Elektromagnetiline keskkond - juhised
RF-emissioonid CISPR 11	Rühm1	Seade kasutab RF-energiat ainult oma siseks funktsiooniks. Seetõttu on selle RF-emissioonid väga madalad ja ei põhjusta tõenäoliselt häireid lähedalasuvates elektroonikaseadmetes.
RF-emissioonid	A-klass	Selle seadme EMISSIOONI omadused muudavad selle sobivaks kasutamiseks tööstuspiirkondades ja haiglates.
Harmooniline vool IEC 61000-3-2	A-klass	
Pinge muutused / pinge kõikumine / värelus IEC 61000-3-3	Vastab	

Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetiline immuunsus

Seade on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, mis on määratletud järgmiselt.

Klient või seadme kasutaja peaks tagama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

IMMUNITEDI test	IEC 60601 testi tase	Vastavus tase	Elektromagnetiline keskkond - juhised
Elektrostaatiline tühjenemine (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2,4,8,15kV õhk	± 8 kV kontakt ± 2,4,8,15kV õhk	Põrandad peaksid olema puidust, betoonist või keraamilistest plaatidest. Kui põrandad on kaetud sünteetilisega materjaliga, Suhteline õhuniiskus peaks olema vähemalt 30 %.
Elektriline kiire transient / purunemine IEC 61000-4-4	± 2 kV elektriliinide puhul ± 1 kV sisend-/väljundliinide puhul	± 2 kV elektriliinide puhul ± 1 kV sisend-/väljundliinide puhul	Elektrivõrgu kvaliteet peaks vastama tüüpilisele kaubandus- või haiglateskeskkonnale.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV liin(id) liin(id) vastu ± 2 kV liin(id) maandusele	± 1 kV liin(id) liinile (s) ± 2 kV liin (s) maandusele	Elektrivõrgu kvaliteet peaks vastama tüüpilisele kaubandus- või haiglateskeskkonnale.
Pinge langus, lühike katkestused toiteallika sisendliinidel IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 tsükli 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° juures. 0 % UT; 1 tsükkel ja 70 % UT; 25/30 tsükliit. Ühefaasiline: 0° juures 0 % TÛ; 250/300 tsükkel	0 % UT; 0,5 tsükkel 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315° juures. 0 % UT; 1 tsükkel ja 70 % UT; 25/30 tsükliit. Ühefaasiline: 0° juures 0 % TÛ; 250/300 tsükkel	Elektrivõrgu kvaliteet peaks vastama tüüpilisele kaubandus- või haiglateskeskkonnale. Kui kasutaja ultraheli kirurgilise Seadmete töö peab jätkuma vooluvõrgu katkestuste ajal, on soovitatav, et ultraheli-kirurgiline seadmed peavad saama toite katkematus toiteallikast või akust.
Võimsuse sagedus (50/60 Hz) Magnetväli IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Võimsus sagedus magnetiline väljad peaksid olema tasemel iseloomulikud tüüpilisest asukohast tüüpilises äri- või haiglateskeskkonnas.

Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetiline immuunsus

Seade on ette nähtud kasutamiseks alljärgnevalt määratletud elektromagnetilises keskkonnas.

Klient või seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

IMMUNITY test	IEC 60601 katse tase	Vastavus tase	Elektromagnetiline keskkond- juhised
Juhtiv RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz kuni 80 MHz 6 V ISM-sagedusalades vahemikus 0,15 MHz ja 80 MHz	3V	Kaasaskantav ja mobiilne raadioside Seadmeid ei tohi kasutada lähemal seadme mis tahes osale, sealhulgas kaablitele, kui saatja sagedus võrrandi alusel arvutatud soovitatav vahemaa. Soovitatav eralduskaugus
Kiiritatud RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz kuni 2,7 GHz 80 % AM 1 kHz juures	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$

		$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz kuni } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz kuni } 2,7\text{GHz}$ <p>kus P on maksimaalne väljundvõimsus saatja võimsus vattides (W) vastavalt saatja tootjale ja d on soovitatav eralduskaugus meetrites (m). Paiksete RF-saatjate väljatugevused, mis on kindlaks tehtud elektromagnetilise asukoha uuringu alusel.3 peakisid olema igas sagedusvahemikus väiksemad kui vastavustase. Järgmise sümboliga tähistatud seadmete läheduses võib esineda häireid:  ME-seadmete ja ME-süsteemide ÜMBRUSPORTI katsetatakse vastavalt standardi IEC 60601-1-2 tabelile 9, kasutades standardis IEC 61000-4-3 sätestatud katsemeetodeid.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideadmete ja seadmete vahel soovitatavad eralduskaugused.

Kiirgiline ultraheli seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kontrollitakse kiirguslikke raadiohäireid. Klient või seadme kasutaja võib aidata vältida elektromagnetilisi häireid, säilitades minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete RF-sideadmete (saatjate) ja seadme vahel, nagu soovitatakse järgmiselt. vastavalt sideadmete maksimaalsele väljundvõimsusele.

Saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus (w)	Eralduskaugus vastavalt saatja sagedusele /m		
	150 kHz kuni 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{v1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz kuni 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz kuni 2,7 GHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

MÄRKUS: Need suunised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilise kiirguse levikut mõjutavad neeldumine ja peegeldumine struktuuridest, objektidest ja inimestest.

Tehnilised tingimused

Süsteemi toimimiseks vajalikud komponendid: Elektrokirurgiline instrument, Muundur, Ultraheli jalglüli, Elektrokirurgiline jalglüli, Ultraheli käärid või Elektrokirurgia käsiinstrumendid, elektrokirurgiline bipolaarne ühendus Bipolaarne instrument.


Vt selle komponendi tootekirjeldust.

Kaitseaste elektrilöögi vastu	Ultraheli:  CF-tüüpi rakendatav osa; bipolaarne elektrokirurgiline 
Kaitseaste elektrilöögi vastu	I klass
Generaator kahjulikele infusioonidele	Tavalised seadmed
Kaitseaste kahjuliku vee sissetungi vastu	Jalalüliti: IP68
Juhtimiskategooria	IIb klass
Ultraheli režiimi parameetrite nõuded:	
Sisendvõimsus	Toiteping: 100-240V
	Toitesagedus: 50Hz/60Hz Võimsus: 400VA
Ultraheli režiimi parameetrite nõuded:	
Ergutussagedus	54 kHz - 57 kHz
Esmane tipu vibratsiooni ekskursioon	25 µm ~ 110 µm
Ultraheli käärid tipu peamine akustiline väljundpind Toode:	1.53~2.75 mm ²
Sekundaarne ristlülitlusakustika Ultraheli käärid tipus Väljundpiirkond:	19,32~35,88 mm ²
Tuletatud väljundheli Ultraheli käärid tipu juures võrdlusotsas Esmase amplituudvõimsus Võimsus	< 30W
Süsteemi sageduse reguleerimise tüüp	Sõltumata koormusest reguleeritakse ergutussagedust automaatselt ja pidevalt.
Võimsusreservi indeks	Vähemalt 2,5
Elektrokirurgiliste parameetrite nõuded:	
Töösagedus	400KHz ± 5%
Maksimaalne väljundpinge	≤ 250V
Täiustatud bipolaarne režiim Maksimaalne väljundvool	≤ 5.5A
Põhiline bipolaarne režiim Maksimaalne väljundvool	≤ 2.2A
Maksimaalne väljundpinge tipust tippu	≤ 500Vpk
Tipptegur	1.6 ± 0.4
Nimivõimsus	Raadiosagedus arenenud bipolaarne: 270 W Raadiosagedus Basic bipolar: 95W
Nimikoormus	Raadiosageduslik täiustatud bipolaarne: 30Ω Raadiosagedus Põhiline bipolaarne: 200Ω

Töökeskkonna tingimused	Temperatuur: Temperatuur: 10 ° C kuni 30 ° C
	Suhteline õhuniiskus: ≤ 70%
	Atmosfäärirõhu vahemik: 800 hPa kuni 1060 hPa
Transpordi- ja ladustamistingimused	Temperatuur: -30 ° C kuni + 55 ° C (Generaator, jalalüliti, adapter) Temperatuur: -10 ° C kuni + 55 ° C (Ultraheli käärid)
	Niiskus: ≤ 80%
	Atmosfäärirõhu vahemik: 800 hPa kuni 1060 hPa
Valmistamise kuupäev	Valmistamise kuupäeva saab kindlaks teha Generaator tagapaneelil oleva seerianumbri järgi.
Toitejuhe	Vastavus CCC sertifitseerimisnõuetele Praegune hinnang: 10A
Püsivusmäär	Määratletud Muundur käsiseadme ja Ultraheli käärid kasutatava seadme järgi. Püsivuse määra kohta vt teavet kohaldatavatest Ultraheli käärid ja Ultraheli käärid. Muundur käsiseadme juhised või 7. peatükk - Hoiatused ja ettevaatusabinõud.
Kaitsmed	€5 * 20 T8AH250V
Kaal (ilma pakendita)	Generaator: nominaal 8 kg
Kogumaht	OP9 Generaator: (pikkus * laius * kõrgus): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispositsioon	Mõned Generaator sisekomponendid, jalalüliti ja jalalüliti kaabel sisaldavad pliidi. Vastavalt kohalikule Kõrvaldamise nõue ja määrus. Hävitaged patareid vastavalt asjakohastele jäätmekehtlustavadele.
AP/APG klassifikatsioon	Mitte AP/APG seadmed.
Kasutusiga:	Kasutusiga: 7 aastat
Tarkvara versioon	V01.01

Bipolaarne väljundlaineline kuju


Täiustatud bipolaarne väljundvõimsuse-koormuse kõver

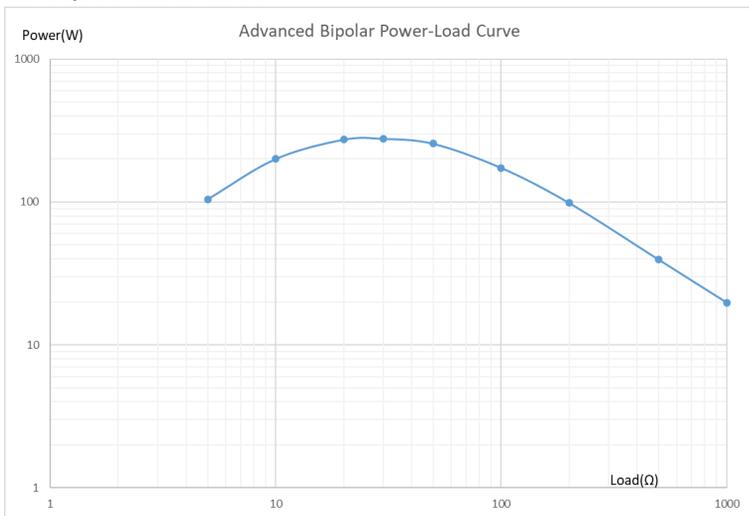

VÕIMAKURVULA piirmäär Max. võimsus: 270[W]			
Koormus (Ω)	Alumine piir	Nominaalne	Ülempiir
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Nominaalne võimsuskõver 270 vati väljundvõimsus nimikoormuse juures vastavalt võimsuskõvera mõõtja voolu/pinge piirväärtusele. Võimsuskõver kujutab ümbrikku, mis varieerub töitingimustes.


Põhiline bipolaarne väljund täisvõimsuse-koormuse kõver

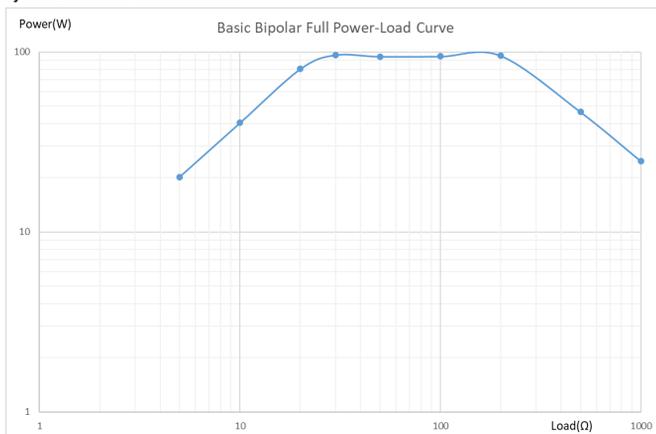

Täieliku võimsuskõvera piirväärtus [W]: Võimsus 95 W

Koormus (Ω)	Alumine piir	Nominaalne	Ülempiir
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Põhiline bipolaarne väljund pool võimsuse ja koormuse kõveraga

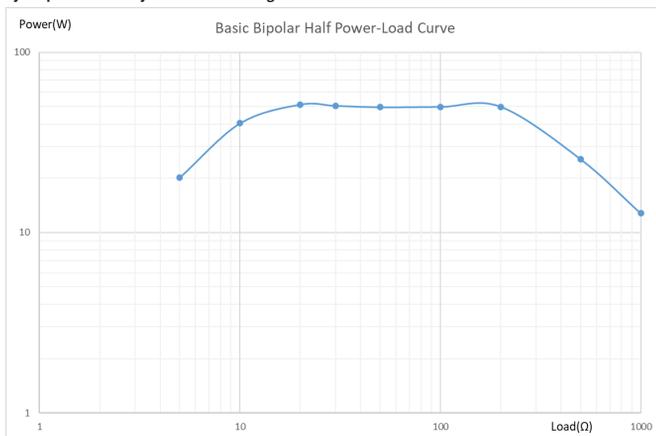

Poole võimsuskõvera piirväärtus [W]: Võimsus 50 W

Koormus (Ω)	Alumine piir	Nominaalne	Ülempiir
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Võimsuse väljundvõimsus vs. võimsuse seaded tavalises bipolaarses seisundis

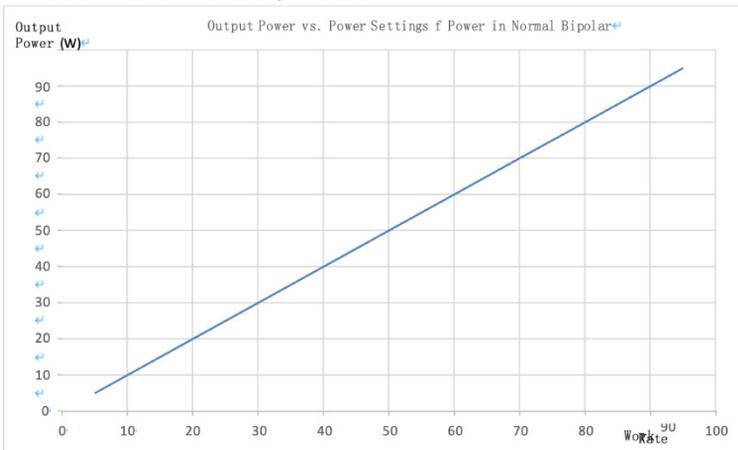

Väljundvõimsus vs. võimsuse seadistatud väärtus tavalise bipolaarse võimsuse korral [W]; koormus: 200Ω

Seadistatud võimsus (W)	Väljundvõimsuse alumine piir (W)	Nimivõimsus (W)	Ülemine väljundvõimsuse piirväärtus (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Teenindus ja garantii

Reach Surgical, Inc. garanteerib, et see toode ei sisalda materjali- ja töövigu tavapärase kasutamise ja ennetava hoolduse korral allpool nimetatud garantiiperioodi jooksul. Reach Surgical'i kohustus käesoleva garantii alusel piirub oma äranägemise järgi iga defektse toote või osa parandamise või asendamisega, mis on tagastatud Reach Surgical, Inc. või selle volitatud edasimüüjale kohaldatava garantiiaja jooksul ja mille defekt on Reach Surgical'ile rahuldavalt tuvastatud. See garantii ei kehti toodete või osade suhtes, mis on:

- Kahjustatud, kuna seda on kasutatud koos lubamatute seadmetega, mida on tootnud või levinud isikud, kes ei ole Reach Surgical, Inc. poolt volitatud.
- Väljaspool Reach Surgical'i tehas parandatud või muudetud, kui see mõjutab seadme stabiilsust või usaldusväärsust Reach Surgical'i hinnangul.
- Ebaõige kasutamise, hooletuse või õnnetusjuhtumi tagajärjel.
- Kasutatakse viisil, mis ei ole kooskõlas toote konstruktsiooni, kasutamise parameetrite, juhiste ja suunistega või sarnaste toodete jaoks vastuvõetud funktsionaalsete, töö- või keskkonnastandarditega.

Garantiiperioodid

Põhiline bipolaarne energiaühendus (OP-BPC): 1 aasta komponentide ja tööjõu eest.

Generaator (OP9): 1 aasta komponentide ja tööjõu eest.

Jalalüliti/toitejuhe: 1 aasta komponentidele ja tööjõule.

Käesolev garantii on algse ostja ainuõiguslik õiguskaitsevahend ja asendab kõik muud otsesed või kaudsed garantiid, sealhulgas garantiid kaubakõlblikkuse ja sobivuse kohta teatud otstarbeks. Reach Surgical, Inc. ei vastuta mis tahes erilise, juhusliku või kaudse kahju eest, sealhulgas kahju eest, mis tuleneb kasutuse, kasumi, äritegevuse või firmaväärtuse kaotusest, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt sätestatud kohaldatavas seaduses.

Reach Surgical, Inc. ei luba ühelgi isikul võtta täiendavat vastutust seoses oma toodete müügi või kasutamisega. Ei ole garantiid, mis ulatuvad kaugemale siinkohal esitatud tingimustest.

Reach Surgical, Inc. jätab endale õiguse teha oma toodetes muudatusi, ilma et ta oleks kohustatud neid muudatusi tagasiulatavalt kohaldama varem müüdüd või toodetud toodete suhtes.

Vue d'ensemble

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser cet appareil. Elles fournissent des instructions importantes concernant le bon fonctionnement, les risques potentiels et les dommages éventuels au produit ou aux personnes. En cas de situation anormale, suivez les instructions spécifiques pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité, les performances, la garantie ou l'entretien, et le fabricant ne peut en être tenu pour responsable. Veuillez lire également les instructions relatives au Transducteur et aux Ciseaux À Ultrasons avant d'utiliser l'appareil.

Ce document est destiné à faciliter l'utilisation de ce dispositif. Il ne s'agit pas d'une référence pour les techniques chirurgicales.

Conventions standard utilisées : ATTENTION, AVERTISSEMENTS et REMARQUES

Veillez prendre note des énoncés suivants, classés dans les catégories ATTENTION, AVERTISSEMENT ou REMARQUE, qui fournissent des conseils essentiels pour effectuer les tâches en toute sécurité et de manière approfondie. Ces mentions se trouvent tout au long de la documentation et doivent être lues avant de passer à l'étape suivante d'une procédure.

AVERTISSEMENT: Cette déclaration met l'accent sur une procédure, une pratique ou une condition de fonctionnement ou d'entretien qui, si elle n'est pas strictement respectée, peut entraîner des blessures corporelles ou des pertes de vie.

ATTENTION: Cette mention avertit l'utilisateur d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées pour l'utilisateur ou le patient, ainsi que des dommages à l'équipement ou à d'autres biens. Elle peut également servir d'avertissement contre des pratiques dangereuses. Il s'agit notamment des précautions nécessaires à l'utilisation sûre et efficace de l'instrument et des soins requis pour prévenir les dommages résultant d'une utilisation correcte ou incorrecte.

REMARQUE: Cette mention indique une pratique ou une condition d'exploitation essentielle à l'exécution efficace d'une tâche.

Description

L'instrument électrochirurgical ENER REACH (ci-après dénommé "l'appareil") est utilisé dans les salles d'opération médicales pour les procédures chirurgicales de coupe, de coagulation des tissus humains et de ligature des vaisseaux. Il comporte deux fentes distinctes : l'une pour l'énergie ultrasonique et l'autre pour la sortie de la forme d'onde radiofréquence.

En mode radiofréquence, le Générateur délivre différents schémas d'énergie en fonction de l'instrument/appareil d'électrochirurgie connecté. Lorsqu'un instrument bipolaire avancé est connecté, le générateur délivre des formes d'ondes RF pour sceller les vaisseaux artériels et veineux, les lymphatiques et les faisceaux de tissus jusqu'à 7 mm de diamètre. Lorsqu'un instrument bipolaire de base est connecté, une énergie à puissance constante est émise pour la coupe et la coagulation des tissus mous.

En mode de production d'énergie ultrasonique, en utilisant le transducteur TRA6 en combinaison avec les Bistouris à usage unique CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, l'appareil coupe les tissus mous nécessitant un contrôle des saignements et des dommages thermiques minimaux, et scelle les vaisseaux jusqu'à un diamètre maximum de 5 mm. Lorsqu'il est connecté aux Ciseaux Ultrasons uniques SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, et SRE45, l'appareil coupe les tissus mous nécessitant un contrôle des saignements et des dommages thermiques minimaux, et scelle les vaisseaux jusqu'à un diamètre maximum de 7 mm.

Utilisation prévue

L'appareil fournit une puissance de radiofréquence pour alimenter les pièces à main électrochirurgicales qui sont destinées à être utilisées pour couper et sceller les vaisseaux et pour couper, saisir et disséquer les tissus.

En outre, le Générateur fournit une puissance ultrasonique pour actionner les instruments chirurgicaux ultrasoniques qui sont indiqués pour les incisions des tissus mous lorsque l'on souhaite contrôler les saignements et minimiser les lésions thermiques.

Indications

L'appareil fournit une puissance de radiofréquence pour alimenter les pièces à main électrochirurgicales qui sont utilisées pendant les chirurgies ouvertes ou laparoscopiques en chirurgie générale, pédiatrique, gynécologique, urologique et thoracique pour couper et sceller les vaisseaux jusqu'à 7 mm inclus, et pour couper, saisir et disséquer les tissus.

En outre, le Générateur fournit l'énergie nécessaire à l'entraînement des instruments chirurgicaux à ultrasons qui sont indiqués pour les incisions des tissus mous lorsque l'on souhaite contrôler les saignements et minimiser les lésions thermiques. Les instruments chirurgicaux à ultrasons peuvent être utilisés en complément ou en remplacement de l'électrochirurgie, des lasers et des scalpels en acier pour couper et/ou coaguler les tissus dans les chirurgies ouvertes ou laparoscopiques générales, pédiatriques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, ainsi que pour sceller et transgresser les vaisseaux lymphatiques.

Utilisateur prévu

Le dispositif est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé pour des applications chirurgicales.

Utilisation prévue Environnement

Le dispositif est destiné à être utilisé dans un hôpital.

Population de patients visée

Ce dispositif convient aux patients âgés de 3 ans et plus qui doivent subir des interventions chirurgicales impliquant des incisions dans les tissus mous avec un contrôle des saignements et des lésions thermiques minimales.


Avantages cliniques

Le dispositif peut être utilisé de manière sûre et efficace pour la ligature et la division des vaisseaux, des faisceaux de tissus et des lymphatiques.

Contre-indications

Ce dispositif est contre-indiqué pour les incisions osseuses, l'occlusion des trompes de Fallope et les procédures de coagulation. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé en neurochirurgie.

Composition du système

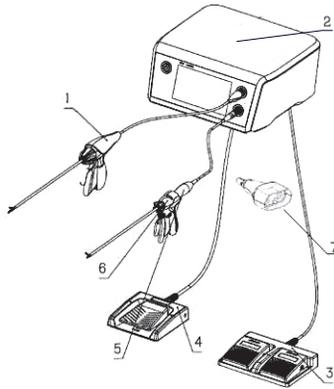

[01] Pièces à main d'électrochirurgie	[02] Générateur OP9
[03] Pédale à ultrasons	[04] Pédale électrochirurgicale
[05] Transducteur	[06] Ciseaux À Ultrasons
[07] Connecteur bipolaire pour l'électrochirurgie	

[01] Pièce à main électrochirurgicale

La pièce à main électrochirurgicale, reliée à un générateur, est actionnée par le chirurgien pendant l'intervention. Elle applique l'énergie électrochirurgicale par radiofréquence aux tissus situés entre ses Mors pour les coaguler ou les sceller. L'instrument comprend également une lame pour la division des tissus. Modèles : OSA23, OSA37, OSA44. Se référer aux instructions pour des informations détaillées.

[02] Générateur OP9

Le Générateur fournit à la fois de l'énergie électrochirurgicale et de l'énergie thérapeutique ultrasonique par l'intermédiaire de ports de connexion d'instruments distincts. Il se compose d'un châssis, d'une coque, d'une carte électronique, d'un écran tactile LCD, d'un interrupteur d'alimentation et d'interfaces pour la connexion des accessoires.

Modèle : OP9

[03] Pédale à ultrasons

Utilisé pour contrôler la sortie marche/arrêt de l'énergie ultrasonique avec deux interrupteurs ("MIN" et "MAX"). Modèle : OP-FSD

[04] Pédale électrochirurgicale

Utilisé pour contrôler la sortie marche/arrêt de l'énergie à haute fréquence à l'aide d'un seul interrupteur.

Modèle : OP-FSS

[05] Transducteur

Le transducteur convertit l'énergie électrique d'un générateur compatible en mouvement mécanique pour les lames de l'instrument. Il s'agit d'un instrument réutilisable dont la durée de vie est limitée. Le transducteur n'est pas stérile et doit être stérilisé conformément aux instructions avant utilisation. Se référer aux instructions du Transducteur TRA6 pour des informations détaillées.

Modèle : TRA6.

[06] Ciseaux À Ultrasons

Les Ciseaux À Ultrasons utilisent le mouvement mécanique du transducteur et délivrent une énergie ultrasonique pour la coupe ou la coagulation des tissus. Il convient d'être prudent car la vibration mécanique n'est pas détectable et pourrait affecter involontairement des zones non ciblées. Les Ciseaux À Ultrasons sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Si la durée de conservation est dépassée ou si l'emballage de stérilisation est endommagé, les Ciseaux À Ultrasons ne doivent pas être utilisés et doivent être éliminés. Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi des Ciseaux À Ultrasons.

Les Ciseaux À Ultrasons suivants sont compatibles avec le Générateur OP9 :

Série PD : CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Série SRB : SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Série SRE : SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Connecteur bipolaire pour l'électrochirurgie

Utilisé pour connecter les instruments électrochirurgicaux bipolaires de base au Générateur pour la coagulation des tissus.

Modèle : OP-BPC

Face avant du Générateur

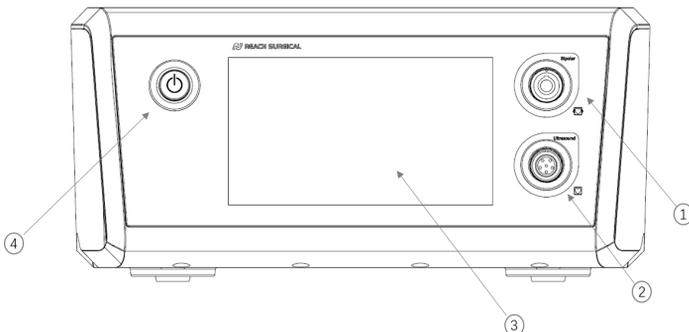

[01] Emboîture électrochirurgicale

Utilisé pour connecter des instruments électrochirurgicaux bipolaires avancés ou un connecteur bipolaire d'électrochirurgie.

[02] Prise du transducteur

Connecte le Transducteur au Générateur.


[03] Écran tactile LCD

Affiche des informations sur le système et sert d'interface pour régler les commandes et les paramètres.

[04] Bouton de l'interrupteur d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour mettre le Générateur sous tension ; maintenez-la enfoncée pour le mettre hors tension.

Panneau arrière du Générateur

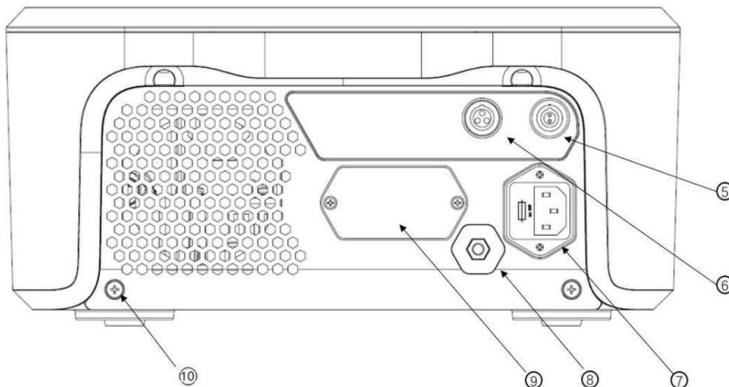

[05] Prise de pédale électrochirurgicale

Prise ronde pour connecter l'interrupteur au pied électrochirurgical

[06] Interrupteur à pédale à ultrasons

Interrupteur à pédale rond pour le raccordement de la pédale à ultrasons.

[07] Prise de courant

Permet de connecter le cordon d'alimentation au Générateur.

[08] Port d'égalisation potentielle

Si la mise à la terre de la prise de courant est incertaine, ce port permet de se connecter à la terre protégée.

[09] Interface d'extension

Utilisé pour l'extension et la maintenance des fonctions.

[10] Trou de montage

Mode d'emploi

Se référer aux directives fournies pour l'environnement d'exploitation.

Déballage

Veillez suivre les instructions ci-dessous lors de la réception des composants.

- Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles dus au transport. Si des dommages sont constatés, veuillez contacter Reach Surgical, Inc. ou l'agent local pour obtenir de l'aide.

Composants inclus dans le (Pour les spécifications techniques détaillées et les codes des produits, voir le chapitre "Conditions techniques du système") :

Modèle	Description	Composant
OP9	Générateur	Générateur, cordon d'alimentation, instructions
TRA6	Transducteur	Transducteur avec câble
OP-FSD	Interrupteur à pédale à ultrasons	/
OP-FSS	Interrupteur à pédale bipolaire	/
OP-BPC	Connecteur d'énergie bipolaire de base	/

Précautions de sécurité

- Lors de l'inspection du matériel, l'extrémité distale de l'instrument doit être maintenue à l'écart des autres appareils, des champs opératoires, du patient ou de tout autre objet afin d'éviter toute blessure.
- Mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires en présence de vapeurs, conformément aux procédures et réglementations de l'hôpital.

Énergie ultrasonique avec les Ciseaux À Ultrasons de la série PD

- Connecter le transducteur, la pédale et la Ciseaux À Ultrasons série PD au Générateur.
- Après avoir passé le test du transducteur et du Ciseaux À Ultrasons, régler le niveau de puissance (1-5) à l'aide des icônes +/- sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le bouton "Min" sur le Ciseaux À Ultrasons ou la pédale "Min" sur la pédale de commande pour activer l'énergie ultrasonique au niveau de puissance préréglé.
- Appuyez sur le bouton "Max" de la Ciseaux À Ultrasons ou de la pédale pour obtenir le niveau d'énergie maximal.
- Relâcher la clé ou l'interrupteur à pédale pour arrêter la production d'énergie.

Ciseaux À Ultrasons Ciseaux À Ultrasons SRB/SRE

- Après avoir passé le test du transducteur et du Ciseaux À Ultrasons, régler le niveau de puissance (1-5) à l'aide des icônes +/- sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le bouton Énergie de l'instrument ou sur le bouton Min de la pédale pour activer l'énergie ultrasonique au niveau de puissance préréglé.
- Appuyez sur le bouton Énergie avec hémostase avancée sur l'instrument pour activer le mode hémostase avancée.
- Relâcher le bouton des Ciseaux À Ultrasons ou le bouton de la pédale de commande pour arrêter l'administration d'énergie.

Énergie électrochirurgicale bipolaire avec advanced bipolar instruments

- L'écran LCD affiche l'icône bipolaire avancée et l'icône de commande manuelle réglable.
- Tirez le Levier de l'instrument ou appuyez sur la pédale de commande pour activer la fréquence radio.
- Le Générateur arrêtera la production d'énergie lorsque la fermeture sera terminée, indiquée par l'icône complète sur l'écran.
- Si la ligature est incomplète, un signal sonore d'avertissement est émis et une icône d'avertissement s'affiche.

Énergie électrochirurgicale bipolaire avec instrument électrochirurgical bipolaire

- L'écran LCD affiche la valeur de la puissance, les icônes de réglage et les barres de niveau de puissance.
- Les réglages de puissance vont de 1 à 95 watts, avec des incréments réglables.
- Sélectionnez la puissance de sortie souhaitée : Faible (15 watts), Moyenne (30 watts) ou Élevée (60 watts).
- Appuyez sur le bouton de la télécommande ou de la pédale pour activer la fréquence radio.
- Relâchez le bouton pour désactiver la sortie d'énergie.

Recommandations

Réglages de l'effet	Plage de réglage de la puissance	Application clinique	Dispositif optimisé
Faible	1-15 watts	Comme les nerfs/la colonne vertébrale, les mains et la chirurgie faciale.	- Dispositifs à surface réduite - Pince à micro-pointes (0,4 - 2,2 mm)
Moyen	16-40 watts	Comme la coagulation lors des examens de la tête et du cou, de la colonne vertébrale et de l'anatomie.	- Appareils à surface moyenne - Pince à micro-pointes (1,0 - 2,2 mm) - Petite pince laparoscopique à tête plate - Ciseaux bipolaires
Haut	45-95 watts (par incréments de 5 watts)	Comme la chirurgie de la tête et du cou et la chirurgie plastique (similaire à l'effet moyen, mais avec un effet plus rapide).	- Appareils à grande surface - Grande pince laparoscopique à tête plate

REMARQUE: Cet appareil n'est pas compatible avec l'électrode neutre.

REMARQUE : les Ciseaux À Ultrasons et le bistouri électrique à radiofréquence sont des pièces appliquées en contact avec le patient.


Utilisation du Générateur

Allumer l'appareil

- Le système est prêt à fonctionner une fois qu'il a été mis en marche. Lorsque le Générateur est branché sur le secteur et que le voyant de l'interrupteur de veille est allumé, le système est prêt à fonctionner.
- Après avoir appuyé sur le bouton Veille, l'image suivante s'affiche :




- Si aucun Transducteur ou Ciseaux À Ultrasons n'est connecté au Générateur, ou s'ils sont mal connectés, l'image suivante s'affiche :

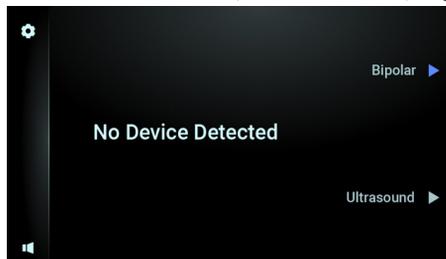


Utilisation Ciseaux À Ultrasons (Transducteur et Cisaille à Ultrasons)


Lorsque le transducteur et les Ciseaux À Ultrasons sont détectés, l'image suivante s'affiche.

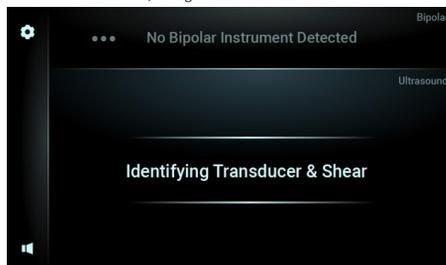


REMARQUE : si le nombre d'utilisations restantes du Transducteur est inférieur à 10, l'image suivante s'affiche. Veuillez faire attention au nombre d'utilisations restantes car le Transducteur doit être remplacé lorsque le nombre devient nul.

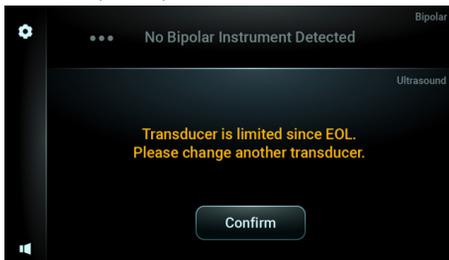


Ensuite, l'image suivante s'affiche, il vous est demandé d'appuyer sur n'importe quel bouton de la Ciseaux À Ultrasons pour démarrer l'essai de cisaillement avec les mâchoires ouvertes.

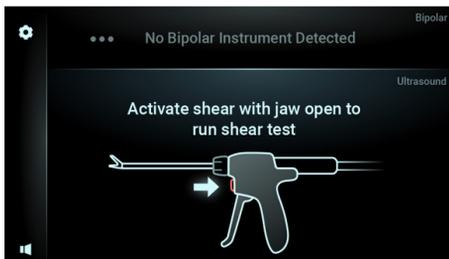


Appuyez sur n'importe quel bouton et l'image suivante s'affichera.

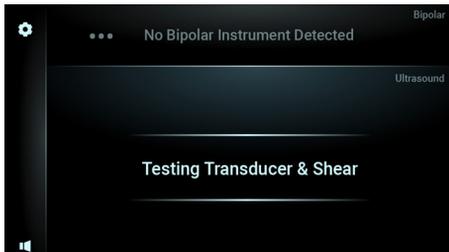


Lorsque le test du transducteur échoue, l'image suivante s'affiche :

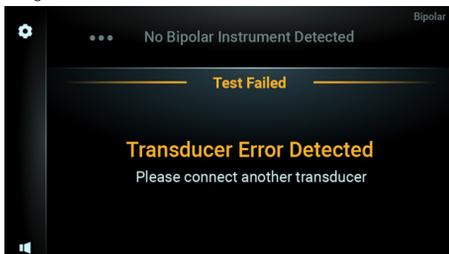

Lorsque le test de Ciseaux À Ultrasons échoue, l'image suivante s'affiche

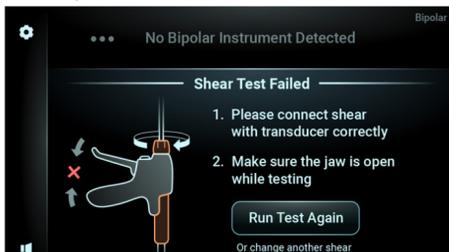

Lorsque le transducteur et le test de Ciseaux À Ultrasons ont réussi, l'image suivante s'affiche :

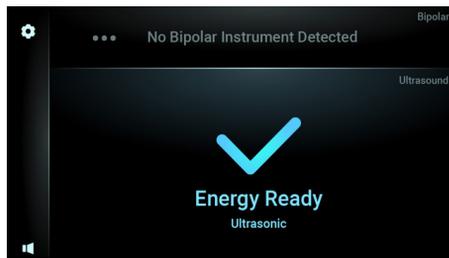

L'écran de travail suivant s'affiche lors de la connexion de Ciseaux À Ultrasons sans fonction d'hémostase avancée.




L'écran de travail suivant s'affiche lors de la connexion des Ciseaux À Ultrasons SRE avec Advanced Hemostasis.




Le mode de sortie est mis en évidence lorsqu'il est activé.

Utilisation d'instruments électrochirurgicaux


Lorsque le transducteur et les Ciseaux À Ultrasons sont détectés, l'image suivante s'affiche.

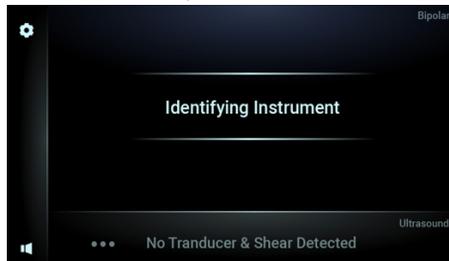

Lorsque le test de l'instrument électrochirurgical est réussi, l'image suivante s'affiche :

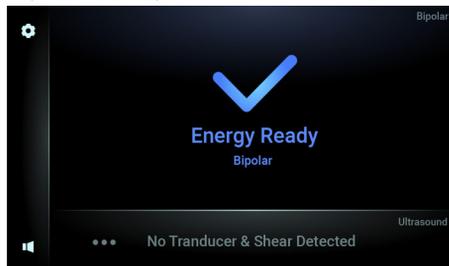

L'écran de travail suivant s'affiche lors de la connexion à un instrument bipolaire avancé.

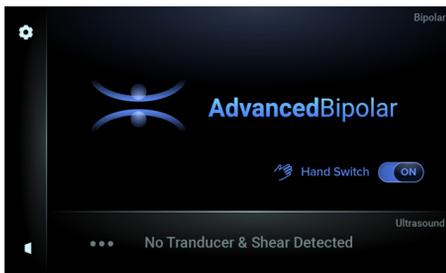

L'écran de travail suivant s'affiche lors de la connexion à un instrument bipolaire ordinaire.




Ciseaux électrochirurgicaux À Ultrasons

Veillez noter que lorsque le Générateur est connecté à la fois à un instrument électrochirurgical bipolaire et à une Ciseaux À Ultrasons, le système fonctionne en mode écran partagé pour afficher l'état actuel. Le dispositif prioritaire sera le premier à activer l'énergie. Cet état d'écran partagé est illustré ci-dessous :



Paramètres du système


Pour accéder aux paramètres du système, cliquez sur l'icône des paramètres située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Les options de réglage du système suivantes sont disponibles :

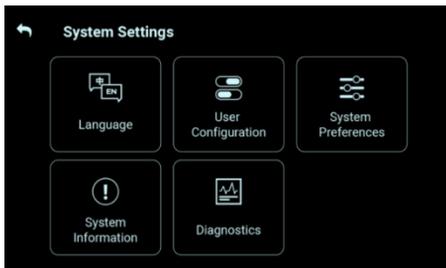

Langue : En cliquant sur l'élément Langue, l'écran de sélection de la langue s'affiche :




Configuration de l'utilisateur : En cliquant sur l'élément Configuration de l'utilisateur, l'écran de configuration de l'utilisateur s'affiche :

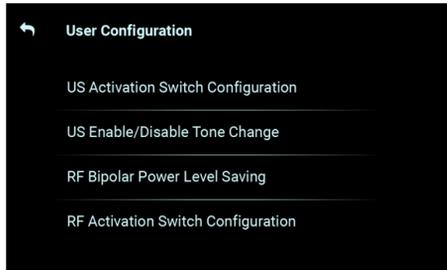


Préférences système : En cliquant sur l'élément Préférences du système, l'écran des préférences du système s'affiche :



Info système : Cliquez doucement sur l'élément System Info pour afficher l'écran d'information sur le système :



Diagnostics : En cliquant sur l'élément Diagnostics, l'écran de diagnostic s'affiche :



Pour quitter les paramètres du système et revenir au mode veille du système, appuyez sur l'icône "Retour" située dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Arrêt du système

Suivez les étapes ci-dessous pour arrêter le système en toute sécurité :

Appuyez sur le bouton de mise en veille : Localisez le bouton de veille sur le Générateur et appuyez dessus pour lancer le processus d'arrêt.

Déconnecter le Transducteur et le Ciseaux À Ultrasons : Déconnecter avec précaution le Transducteur et la Ciseaux À Ultrasons du système. Se reporter aux instructions d'utilisation pour une manipulation correcte du Transducteur et de la Ciseaux À Ultrasons.

Nettoyage : Nettoyez le Générateur, l'Interrupteur à pédale et le Transducteur conformément aux procédures spécifiées dans le chapitre 'Entretien'.

Dépannage

Le Générateur intègre divers signaux d'alerte et codes d'erreur pour faciliter l'identification et le diagnostic des défaillances des composants. Il est important de noter que ces signaux et codes sont conçus pour appuyer le jugement et l'observation cliniques, et non pour les remplacer.

Alerte sonore

Statut de travail	Type de son	Cause possible et action
Autocontrôle de l'état	Son normal	/
	Son anormal	Une erreur matérielle a été détectée. Veuillez contacter le fabricant pour obtenir une aide à la réparation.
Utilisation d'un instrument à ultrasons	Niveau sonore maximal	/
	Niveau sonore minimal	/
	Son anormal	La Ciseaux À Ultrasons est entrée en contact avec une quantité excessive de tissu. Réduire le contact des tissus avec la ciseaux À Ultrasons. Si un son continu persiste, retirez soigneusement les tissus qui peuvent s'accumuler autour de l'extrémité de la Ciseaux À Ultrasons. Un défaut a été détecté au niveau du Transducteur et/ou de la Ciseaux À Ultrasons. Veuillez consulter le fabricant ou contacter le service d'assistance pour obtenir de l'aide.
	son AVANCÉ	/
	Son ITS	/
Activation de l'instrument électrochirurgical	Tonalité d'avertissement bipolaire avancée	/
	Son bipolaire normal	/
	Son anormal	Coupe non réussie : Si le tissu en contact avec l'instrument ne répond pas aux exigences de coupe, réduire la quantité de tissu en contact avec l'instrument. Si la tonalité d'erreur persiste, éliminez soigneusement tout tissu susceptible de s'accumuler à l'extrémité de l'instrument. Défaillance matérielle : Cette erreur indique une défaillance potentielle du circuit ou du connecteur. En cas de panne ou d'erreur, il est recommandé de consulter le fabricant ou de demander de l'aide pour obtenir des conseils et une solution appropriés.

Codes d'erreur

Le Générateur de la plateforme énergétique est équipé d'un système complet d'identification des défaillances composé d'alertes et d'erreurs système. Lorsqu'un défaut est détecté, le générateur émet une tonalité d'avertissement, affiche un signal d'avertissement sur le panneau de commande et affiche un code de défaut correspondant sur l'écran LCD. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour résoudre le problème :

Tableau des codes d'erreur

Code d'erreur	Message d'erreur correspondant
Avertissement	Veuillez connecter correctement la Ciseaux À Ultrasons au Transducteur.
Avertissement	Veillez à ce que les Mors soient ouverts pendant l'essai.
Avertissement	Ciseaux À Ultrasons Erreur détectée
Avertissement	Le temps restant du Transducteur est de zéro
Avertissement	Veillez n'activer qu'un seul bouton à la fois
Avertissement	Veillez réduire la force appliquée à la Ciseaux À Ultrasons
Avertissement	La touche Ciseaux À Ultrasons et la pédale ne peuvent pas être fermées simultanément.
Avertissement	Bouton bloqué, veuillez vérifier et continuer
Avertissement	Ajuster les Mors ou serrer moins de tissu
Avertissement	Retirer le dispositif des tissus
Erreur du système	Erreur du système
Erreur du système	Échec de l'autocontrôle

Si une erreur apparaît à l'écran pendant le test, effectuez les actions suivantes :



- Assurez-vous que le câble du Transducteur est entièrement inséré dans le bon sens.

- Vérifier si la Ciseaux À Ultrasons a été correctement serrée ou si des tissus se sont accumulés autour de l'extrémité de la Ciseaux À Ultrasons. Ajuster le serrage de la Ciseaux À Ultrasons et retirer avec précaution toute accumulation de tissu autour du boîtier de la Ciseaux À Ultrasons. (Si le test est lancé avant l'opération, s'assurer que la Ciseaux À Ultrasons est orientée vers l'air. Si des Ciseaux À Ultrasons sont utilisés, s'assurer que la Mors est ouverte et n'est pas en contact avec des objets).
- Si le problème persiste, envisagez de remplacer le Transducteur ou la Ciseaux À Ultrasons.
- Passer au mode de fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE : Le Transducteur peut ne pas fonctionner correctement si sa température dépasse la limite spécifiée. Dans ce cas, utilisez immédiatement un autre Transducteur pour la récupération ou suivez les étapes ci-dessous pour déterminer la cause de l'erreur et explorer les méthodes de récupération optionnelles :

- Laissez le Transducteur refroidir à température ambiante pendant au moins 45 minutes. Cette méthode de refroidissement s'applique également si le Transducteur devient chaud après un fonctionnement prolongé à haute puissance.
- Si la surchauffe du Transducteur n'est pas évidente et que le problème n'est pas résolu, contactez les représentants de la maintenance du fabricant pour obtenir de l'aide.
- Hormis les fusibles, le Générateur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute demande de remplacement ou d'entretien, veuillez contacter le personnel d'entretien formé et autorisé par Reach Surgical, Inc. ou votre représentant local.

L'entretien et les mises à niveau du Générateur doivent être exclusivement effectués par un personnel de service formé et autorisé par Reach Surgical.

Des précautions en matière de cybersécurité doivent être prises pour prévenir les menaces potentielles. Les incidents suivants présentent des risques pour la cybersécurité :

- Accès non autorisé à des produits non liés à l'appareil.
- Toute communication réseau non autorisée avec l'appareil.
- Les mises à jour de micrologiciels ou de logiciels qui n'ont pas été autorisées par Reach Surgical.

Dans l'éventualité de l'un des incidents susmentionnés, veuillez contacter le représentant commercial de Reach Surgical, Inc. ou directement Reach Surgical, Inc. à l'adresse Reachquality@reachsurgical.com.

Maintenance

Nettoyage et désinfection du Générateur et du Basic Bipolar Energy Connecteur

Nettoyage

Nettoyez l'écran LCD du Générateur et le connecteur bipolaire de base conformément aux procédures et réglementations de l'hôpital. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'alimentation principale du Générateur est déconnectée et que le cordon d'alimentation est retiré de l'unité de sortie.

AVERTISSEMENT : Les procédures de nettoyage doivent être suivies scrupuleusement afin d'éviter d'endommager le Générateur, de provoquer un choc électrique ou de créer un risque d'incendie. Ne pas renverser ou éclabousser de liquides sur ou dans le Générateur, ni l'immerger dans un liquide. Suivez les étapes suivantes pour le nettoyage :

- Préparer un détergent à pH neutre ou un détergent enzymatique à pH neutre selon les indications du fabricant du détergent.
- À l'aide d'un chiffon propre et doux imbibé d'une petite quantité de solution de nettoyage, essuyez manuellement toutes les surfaces, y compris l'écran du Générateur.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre et doux imbibé d'eau chaude du robinet.
- Enfin, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre et doux pour vous assurer qu'elles sont sèches.

Désinfection

- Si le générateur est contaminé par du sang ou des fluides corporels, il doit être désinfecté avant d'être réutilisé. Les désinfectants chimiques suivants ont été validés pour une utilisation sur le générateur : alcool isopropylique à 70 %, hypochlorite de sodium à 6 %, peroxyde d'hydrogène à 10 %.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant l'utilisation, la concentration et le temps de contact des désinfectants.
- Veiller à ce que les désinfecteurs soient configurés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage de l'Interrupteur à pédale

Nettoyez l'Interrupteur à pédale et le câble après chaque utilisation en suivant la procédure suivante :

- Déconnectez l'Interrupteur à pédale du Générateur.
- Préparer un détergent enzymatique à pH neutre selon les instructions du fabricant.
- Connectez fermement le câble à l'Interrupteur à pédale et immergez-les dans la solution de nettoyage pendant 2 minutes.

REMARQUE : Assurez-vous que le câble de l'Interrupteur à pédale utilisé pour connecter le Générateur est complètement sec afin d'éviter toute activation accidentelle.

- Après l'immersion, frottez manuellement l'Interrupteur à pédale et le câble avec une brosse à poils doux dans la solution de nettoyage.
- Rincez soigneusement l'Interrupteur à pédale et le câble à l'eau chaude du robinet pendant au moins 1 minute.

ATTENTION : Maintenez le câble et l'Interrupteur à pédale bien connectés pendant le rinçage.

- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre et doux.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à ultrasons pour nettoyer l'Interrupteur à pédale.

AVERTISSEMENT : Ne pas mettre le Générateur sous tension avant d'avoir branché le câble d'alimentation CA. S'assurer que toutes les connexions sont sèches avant l'assemblage.

Nettoyage et désinfection du transducteur

Les transducteurs sont livrés non stériles et doivent être nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation.

Nettoyage:

Nettoyez soigneusement les transducteurs en suivant les étapes suivantes :

- Rincez le transducteur avec la vis vers le haut et nettoyez avec une brosse à poils doux avec de l'eau purifiée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches sur la surface ;
- Le transducteur peut être trempé dans un détergent enzymatique au pH neutre (Ingrédients principaux : protéase lipase amylase cellulase pectinase et autres enzymes biologiques, tensioactif respectueux de l'environnement, facteur de prévention de la rouille et stabilisant) pendant une période allant jusqu'à 10 minutes et à une température appropriée 15° C ~ 65°C. Le rapport de détergent et d'eau purifiée est de 1 : 400 ;
- Rincer le transducteur avec la vis vers le haut avec de l'eau purifiée pendant 2 minutes ;
- Nettoyez la vis de connexion, la surface de montage du bistouri et le connecteur avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Trempez le transducteur dans de l'alcool médical à 75 %, maintenez-le et secouez-le 30 fois ;
- Rincez le transducteur avec la vis vers le haut avec de l'eau purifiée pendant 2 minutes.

Remarque : L'utilisation de nettoyeurs à ultrasons n'est pas recommandée pour le transducteur.

Séchage:

Température de séchage : 50-70 °C, Temps de séchage : 30 min.

Stérilisation du transducteur :

Après les étapes de nettoyage et de séchage ci-dessus, le transducteur doit être stérilisé par l'une des méthodes énumérées ci-dessous.

Stérilisation à la vapeur (121 °C)

- Installer les gaines avant la stérilisation. Les transducteurs doivent être enveloppés pendant la stérilisation. Mettez les transducteurs dans un pot de stérilisation à vapeur à haute température avec une température de 121 °C et pour une durée de 30 minutes.

- Température de séchage : 50-70°C, Temps de séchage : 30 min.

Stérilisation à la vapeur (134°C)

- Installer les gaines avant la stérilisation. Les transducteurs doivent être enveloppés pendant la stérilisation. Mettez les transducteurs dans un pot de stérilisation à vapeur à haute température avec une température de 134 °C et pour une durée de 10 minutes.
- Température de séchage : 50-70°C, Temps de séchage : 30 min.

Essais de sécurité et de fonctionnement

Veillez à la mise en œuvre des tests de sécurité et de fonctionnement pour le Transducteur, le Générateur et l'Interrupteur à pédale conformément aux procédures et réglementations de l'hôpital. Pour les tests de sécurité et de fonctionnement des autres composants utilisés par plusieurs patients, reportez-vous aux instructions d'utilisation spécifiques à chaque composant.

Test de sécurité

Générateur : Des techniciens hospitaliers certifiés doivent effectuer un test de courant de fuite.

Interrupteur à pédale : Inspectez la pédale, le connecteur du câble et le câble pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages. Remplacez les composants endommagés.

Autres composants : Vérifiez tous les autres composants conformément aux instructions de leur mode d'emploi respectif.

Test fonctionnel

Mode ultrasons

- Préparer l'ensemble complet de Ciseaux À Ultrasons PD et connecter le Transducteur en suivant les instructions fournies au chapitre II - Installation et fonctionnement de l'équipement.
- Vérifier s'il est possible d'accéder à l'état de fonctionnement. Les Ciseaux À Ultrasons peuvent avoir des interfaces d'entrée différentes. Se reporter à la partie 1, section 3 du chapitre 2 pour des instructions détaillées.
- Confirmer l'affichage du niveau de puissance MIN 3 et du niveau de puissance MAX 5.
- Appuyez sur les boutons d'augmentation et de diminution de la puissance pour vous assurer que le niveau de puissance MIN peut être réglé entre les niveaux 1 et 5.
- Mettez le Générateur sous tension et passez-le en mode de fonctionnement ultrasonique. Vérifier la connexion correcte du transducteur et de la Ciseaux À Ultrasons.
- Mors ouvert, appuyez sur le bouton "MAX" de l'interrupteur à pédale. L'écran LCD doit afficher le niveau de puissance MAX "5" et un signal sonore d'activation doit retentir.
- Mors ouvert, appuyez sur le bouton "MIN" de l'interrupteur à pédale. L'écran LCD doit afficher le niveau de puissance MIN et un signal sonore d'activation doit retentir.

AVERTISSEMENT : Avant d'activer le système, assurez-vous que la Mors est tenue à l'écart des tissus, d'autres instruments ou de tout autre objet afin d'éviter que l'instrument ne se blesse.

Mode électrochirurgical bipolaire

- Connecter l'instrument électrochirurgical bipolaire avancé/l'instrument bipolaire de base conformément aux instructions.
- Vérifiez que le système peut entrer dans l'interface de travail. Le mode bipolaire de base doit afficher l'icône du niveau de puissance 30, tandis que le mode bipolaire avancé doit afficher l'icône "bipolaire avancé".
- Touchez légèrement les touches d'incrément et de décrément de la puissance en mode bipolaire de base pour confirmer que le niveau de puissance peut être réglé entre 1 et 95. Touchez les barres Low, Medium et High pour passer directement à 15, 30 et 60.
- Mettez le générateur hors tension et attendez 5 secondes. Ensuite, mettez le générateur sous tension et attendez 10 secondes. Vérifiez que le mode bipolaire de base affiche l'interface des 30 niveaux de puissance et que le mode bipolaire avancé affiche l'interface "bipolaire avancé". Vérifiez si le générateur est activé conformément aux exigences prédéterminées.
- Interrupteur à pédale pour les instruments électrochirurgicaux bipolaires avancés et de base. Vérifier que les indications de niveau de puissance clignotent sur le panneau de commande et écouter le son d'activation.

AVERTISSEMENT : Avant d'activer le système, il est strictement interdit de permettre tout contact de la Ciseaux À Ultrasons avec des tissus, d'autres instruments ou tout autre objet afin d'éviter toute blessure à l'utilisateur.

Avertissements et précautions

Relatif au système

- Lire les instructions avant l'utilisation et suivre les directives hospitalières pour la pratique clinique de la chirurgie ultrasonique, de l'électrochirurgie, de la gynécologie et de la laparoscopie.
- Les dispositifs mini-invasifs peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Si des instruments mini-invasifs et des accessoires de différents fabricants sont utilisés en même temps lors d'une intervention chirurgicale, il convient de vérifier la compatibilité des instruments et des accessoires avant l'intervention et de vérifier si les accessoires insérés dans le corps humain présentent une surface rugueuse, un bord tranchant ou une protubérance susceptible d'entraîner des risques pour la sécurité.
- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par des chirurgiens formés et agréés. N'utilisez pas de dispositifs électrochirurgicaux si vous n'avez pas été correctement formé à leur utilisation pour l'intervention spécifique que vous devez effectuer. L'utilisation de ce dispositif par des personnes non formées peut provoquer des lésions graves et involontaires chez le patient, notamment une perforation de l'intestin et une nécrose inconsciente et irréparable des tissus.
- N'ouvrez pas le boîtier du Générateur sans autorisation afin d'éviter tout risque d'électrocution. Toute réparation ou mise à niveau de l'instrument doit être effectuée par un technicien formé et autorisé par Reach Surgical, Inc. Ne pas utiliser cet instrument à d'autres fins que la chirurgie médicale.
- Une compréhension approfondie des principes et des techniques impliqués dans les procédures laser, électrochirurgicales et ultrasoniques est essentielle pour éviter les risques de choc et de brûlure pour le patient et le personnel médical, ainsi que les dommages à cet appareil ou à d'autres dispositifs médicaux. L'isolation électrique ou la mise à la terre ne doivent pas être compromises. Ne pas immerger les appareils électrochirurgicaux dans des liquides, sauf si la conception l'exige et si l'étiquetage indique qu'ils doivent être immergés.
- La sécurité et l'efficacité de la chirurgie ultrasonique et de l'électrochirurgie dépendent non seulement de la conception de l'équipement, mais aussi, dans une large mesure, de nombreux facteurs contrôlés par l'opérateur. Pour améliorer la sécurité et l'efficacité, il convient de lire, de comprendre et de suivre le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
- Comme pour toutes les sources d'énergie (électrochirurgie, laser ou ultrasons), il convient de tenir compte des risques cancérigènes et infectieux que peuvent présenter de nombreux sous-produits tissulaires, tels que la fumée et les aérosols. Des précautions appropriées telles que des lunettes de sécurité, des masques de filtration et un équipement efficace d'évacuation de la fumée doivent être observées à la fois dans les procédures ouvertes et endoscopiques.
- Après avoir retiré le dispositif, vérifier l'hémostase du tissu. En l'absence d'hémostase, des méthodes appropriées doivent être utilisées pour obtenir l'hémostase.
- Les produits fabriqués ou distribués par des sociétés non autorisées par Reach Surgical, Inc. peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation de tels produits peut conduire à des résultats inattendus et peut blesser l'utilisateur ou le patient.
- Pour réduire le risque d'interférence, l'appareil et la coque doivent être connectés à un circuit électrique indépendant.

- L'appareil ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux. Risque de formation d'étincelles en cas de collision avec d'autres appareils métalliques. Les étincelles peuvent enflammer des gaz inflammables, tels que les gaz de champ.
- Le doit fonctionner dans la plage de température ambiante requise.
- La tension de la prise de sortie doit être conforme aux exigences du générateur (chapitre "Conditions techniques du système"). Si l'alimentation n'est pas correctement connectée, elle peut endommager le générateur et provoquer des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de rallonges pour éviter les risques d'incendie.
- Ne pas régler la tonalité d'activation sur un niveau inaudible. Les tonalités d'activation peuvent être remarquées par le personnel de l'équipe chirurgicale pendant que le Générateur délivre de l'énergie.
- Il a été démontré que la fumée générée pendant l'électrochirurgie pouvait blesser les patients ou le personnel de l'équipe chirurgicale. Suggérer une ventilation adéquate à l'aide d'un évacuateur de fumée chirurgical ou d'autres moyens.
- Certains composants du Générateur intégré de chirurgie à ultrasons sont expédiés non stériles (par exemple, le Transducteur). Stériliser le produit selon les besoins avant de commencer l'installation du système. Pour les instructions de nettoyage et de stérilisation, se référer à chaque instruction pertinente.
- Pour éviter de blesser les utilisateurs ou les patients, la Ciseaux à Ultrasons doit éviter les autres appareils, les champs opératoires, les patients ou d'autres objets avant d'appuyer sur le bouton de test et pendant la vérification du système. Les mesures de sécurité en cas d'aérosol (conformément à la réglementation de l'hôpital) doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'inspection du système et de la méthode d'essai.
- N'appliquez pas une pression trop forte sur la Mors pour éviter d'inhiber la délivrance de l'énergie ultrasonique.
- Pour éviter toute blessure à l'utilisateur, la lame doit éviter tout contact avec les tissus, d'autres dispositifs ou d'autres objets avant d'activer le système.
- Si un liquide est projeté ou versé sur ou dans le générateur, ou si le générateur est renversé ou versé dans le liquide, cela peut endommager le générateur et provoquer des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Les étincelles et l'échauffement associés aux techniques de fermeture de vaisseaux peuvent tous deux constituer des sources d'inflammation. La gaze et l'éponge doivent rester humides. Tenir les électrodes électrochirurgicales à l'écart des matériaux combustibles et des environnements riches en oxygène (O2).
- Lorsque le Transducteur est fortement endommagé ou si des pièces présentent des signes d'endommagement après l'entretien de nettoyage et de désinfection, mettez-les au rebut. Les pièces endommagées sont clairement marquées afin d'éviter toute mauvaise utilisation avant toute manipulation ultérieure.
- Les déchets jetables et les déchets électroniques doivent être éliminés conformément à la réglementation de l'hôpital et ne doivent pas être jetés à volonté afin d'éviter la pollution de l'environnement.
- Évitez d'utiliser le Générateur à proximité ou empli sur d'autres équipements. Si une utilisation adjacente ou empliée est nécessaire, surveillez le générateur et les autres équipements pour assurer leur bon fonctionnement.
- L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'opérateur. Pour toute réparation, contactez votre représentant commercial ou le personnel de service de Reach Surgical.
- Vérifier tous les appareils connectés au système et les connexions avant l'utilisation. Vérifier que le dispositif fonctionne comme prévu. Une mauvaise connexion peut provoquer des arcs électriques, des étincelles, un dysfonctionnement du dispositif ou des résultats chirurgicaux inattendus.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, cet appareil ne doit être connecté qu'à une alimentation dotée d'une mise à la terre.
- Maintenez une distance aussi grande que possible entre le Générateur et les autres appareils électroniques (par exemple, les moniteurs). Ne pas croiser ou attacher les fils électriques aux appareils électroniques. Le Générateur peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- Le système doit être utilisé avec prudence en présence de stimulateurs cardiaques internes et externes. Les interférences causées par l'utilisation d'instruments électrochirurgicaux peuvent faire entrer le stimulateur cardiaque dans un état asynchrone ou l'empêcher complètement de fonctionner. Lorsque des dispositifs d'électrochirurgie ou de scellement des tissus sont destinés à être utilisés chez des patients porteurs de stimulateurs cardiaques, il convient de contacter le fabricant du stimulateur ou le service de cardiologie de l'hôpital pour obtenir des informations complémentaires.
- Soyez prudent si vous empilez des instruments sur le Générateur ou si vous placez le Générateur sur des instruments électriques. Cette configuration est instable et ne permet pas un refroidissement adéquat.
- Une défaillance du Générateur peut entraîner une interruption chirurgicale. Un système de secours doit être disponible.
- Si la réglementation locale l'exige, le Générateur doit être raccordé au connecteur équipotentiel de l'hôpital à l'aide d'un câble équipotentiel.
- Lorsque le système et l'équipement de surveillance physiologique sont utilisés simultanément sur le même patient, toute électrode de surveillance doit être placée aussi loin que possible de l'instrument.
- En mode bipolaire de base, choisissez la puissance de sortie la plus faible possible pour obtenir l'effet désiré.
- La défaillance d'un équipement chirurgical à haute fréquence peut entraîner une augmentation inattendue de la puissance de sortie.
- Le Générateur et le connecteur électrochirurgical bipolaire de base peuvent être envahis par de l'eau ou des particules. Lors de l'utilisation et du nettoyage, il est nécessaire d'éviter l'invasion d'eau ou de particules.
- Lorsque le système est utilisé en combinaison avec un endoscope, il peut augmenter le courant de fuite sur le corps du patient. Faites attention pendant la procédure.
- Un avis à l'utilisateur et/ou au patient indiquant que tout incident grave lié au dispositif doit être signalé à Reach Surgical, Inc. par l'intermédiaire de Reachquality@reachsurgical.com. et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instrument connexe

Pendant les interventions chirurgicales, il est important de savoir que la partie terminale de l'instrument Ciseaux à Ultrasons, le tampon de l'instrument Ciseaux à Ultrasons et l'Axe peuvent subir des températures élevées lorsque des ultrasons ou des électrocautères bipolaires sont appliqués sur les tissus pendant des périodes prolongées. Pour garantir la sécurité, il est essentiel d'éviter tout contact accidentel entre ces composants de l'instrument et les tissus, les draps chirurgicaux, les blouses chirurgicales ou toute autre zone non apparentée pendant la procédure.

En outre, il est essentiel de faire preuve de prudence lors du positionnement de l'instrument bipolaire. En particulier, il ne doit pas être placé à proximité ou en contact avec des matériaux combustibles tels que des gazes ou des champs opératoires. Les instruments bipolaires utilisés dans ce contexte peuvent générer de la chaleur pendant leur utilisation, ce qui pourrait potentiellement entraîner un risque d'incendie. Lorsque le générateur électrochirurgical bipolaire n'est pas utilisé, il doit être correctement rangé dans la gaine de protection ou maintenu à une distance sûre du patient, des membres de l'équipe chirurgicale et de tout matériau combustible.

REMARQUE: Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation respectives pour des avertissements et des précautions supplémentaires.

Informations sur la CEM

Le produit a passé le test de compatibilité électromagnétique, qui répond aux exigences de limitation de la norme IEC60601-1-2 pour les équipements médicaux. Ces restrictions offrent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations médicales normales.

Composition du produit

Numéro de série	Nom de la pièce	Modèle/Version No.	Remarques
1	Instruments électrochirurgicaux	OP9	/
2	Transducteur d'équipement de chirurgie ultrasonique	TRA6	Utilisation compatible
3	Ciseaux à Ultrasons à usage unique Ciseaux à Ultrasons	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Utilisation compatible

4	Unité de chirurgie ultrasonique à haute fréquence à usage unique Scellant pour tissus	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Pédale à ultrasons	OP-FSD	/
6	Pédale électrochirurgicale	OP-FSS	/
7	Connecteur bipolaire pour l'électrochirurgie	OP-BPC	/

Câble du produit

Numéro de série	Nom du câble	Longueur (m)	Blindé
1	Câble de commande au pied	3	Oui
2	Cordon d'alimentation	5	Non
3	Câble électrochirurgical bipolaire	3	Non
4	Le câble du Transducteur	2.9	Oui

Performances CEM

Cet appareil peut être soumis à des interférences de radiofréquence causées par d'autres appareils médicaux et des communications radio. Pour éviter de telles interférences, ce produit a été testé conformément à la norme IEC 60601-1-2 et répond à ses exigences. Cependant, Reach Surgical, Inc. ne garantit pas l'absence totale d'interférences dans les environnements d'installation individuels.

S'il s'avère que l'appareil subit des interférences (ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur (ou le personnel d'entretien approuvé par Reach Surgical, Inc.) doit essayer de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour résoudre le problème d'interférence :

Ajuster la direction ou la position du dispositif qui l'affecte.

Augmenter la distance entre cet appareil et l'appareil émetteur.

Utilisez d'autres sources d'alimentation (plutôt que l'alimentation utilisée pour affecter l'équipement) pour alimenter cet équipement.

Consulter le fournisseur ou le représentant du service après-vente pour d'autres suggestions.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences causées par les situations suivantes : utilisation de câbles d'interconnexion autres que les câbles recommandés ; altération ou modification de cet équipement sans autorisation. Les changements ou modifications non autorisés peuvent entraîner une perte d'efficacité de l'équipement.

Tous les types d'appareils électroniques peuvent provoquer des interférences électromagnétiques avec d'autres appareils par l'intermédiaire de l'air ou d'autres câbles qui y sont connectés. N'utilisez pas d'appareils pouvant émettre des signaux RF, tels que des téléphones cellulaires, des émetteurs-récepteurs radio ou des produits de radiocommande, à proximité de cet appareil, car les performances de ce dernier risqueraient de ne pas être conformes aux spécifications indiquées. Lorsque de tels appareils se trouvent à proximité de l'appareil, il convient de les mettre hors tension. Le personnel médical responsable de cet appareil doit demander aux techniciens, aux patients et aux autres personnes susceptibles de se trouver à proximité de l'appareil de se conformer pleinement aux exigences susmentionnées.

Pour atteindre les performances CEM spécifiées, l'utilisateur doit installer le produit correctement en suivant les étapes décrites dans le manuel. En cas de problèmes liés à la CEM, veuillez contacter le personnel de maintenance agréé par Reach Surgical, Inc.

Le Transducteur (avec câble) et les Ciseaux À Ultrasons sont définis comme la partie appliquée de l'ensemble du système.

Précautions pour l'installation du produit

L'équipement peut être utilisé dans un environnement hospitalier, mais ne comprend pas de salles de blindage contre les radiofréquences autour des équipements chirurgicaux actifs à radiofréquences ou dans les endroits où sont placés les équipements à résonance magnétique, car l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée dans ces endroits.

Distance de séparation et impact des équipements de radiocommunication fixes : l'intensité du champ magnétique généré par les émetteurs fixes, tels que les stations de base des téléphones sans fil (cellulaires/sans fil), les récepteurs de radio mobile terrestre, les récepteurs de radio amateur, les émissions de radio AM et FM, et les émissions de télévision Générateurs, etc. ne peut être mesurée avec précision de manière théorique. Pour évaluer l'environnement électromagnétique généré par les émetteurs RF fixes, il faut envisager de mesurer le champ électromagnétique. Si la valeur mesurée de l'intensité du champ magnétique à l'emplacement de l'appareil dépasse le niveau de radiofréquence correspondant spécifié dans la "déclaration anti-brouillage", l'appareil doit être inspecté pour s'assurer qu'il peut fonctionner normalement. Si des conditions de fonctionnement anormales sont constatées, des mesures supplémentaires doivent être envisagées, telles que la réorientation ou le déplacement de l'équipement, ou l'utilisation d'une pièce anti-fréquences radio.

1) Utiliser le cordon d'alimentation fourni ou désigné par Reach Surgical, Inc. Les produits équipés d'une fiche d'alimentation doivent être branchés sur une prise de courant fixe avec mise à la terre. N'utilisez aucun type d'adaptateur ou de connecteur pour brancher la fiche d'alimentation.

2) Éloignez autant que possible cet appareil des autres appareils électroniques.

3) Suivre les étapes pour connecter l'appareil.

Notes générales

(1) La spécification du câble.

L'utilisation des câbles fournis par Câble, Inc. n'endommagera pas les performances CEM de ce produit. Si des câbles non spécifiés sont utilisés, les performances CEM de cet équipement peuvent être considérablement réduites.

(2) Précautions à prendre en cas de modifications non autorisées

L'utilisateur ne doit pas modifier ce produit, sous peine d'en diminuer les performances CEM.

La modification du produit comprend les changements suivants :

a. Câble (longueur, matériau et câblage, etc.).

b. Installation et disposition de l'équipement.

c. Configuration/composants de l'équipement.

d. Pièces de protection de l'équipement (ouverture/fermeture du couvercle et pièces de fixation du couvercle).

(3) Toutes les protections doivent être fermées lors de l'utilisation de l'équipement.

Ce produit est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous, et l'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement électromagnétique.

Performances essentielles

1. Pour la production d'énergie radioélectrique à haute fréquence avancée, le système doit garantir que l'écart de la puissance de sortie nominale ne dépasse pas 20 % de la valeur standard.

2. Pour la production d'énergie radioélectrique de base à haute fréquence, le système doit garantir que l'écart par rapport à la puissance de sortie nominale ne dépasse pas 20 % de la valeur standard.

Guide et déclaration du fabricant - ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES		
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié comme suit. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - orientations
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	L'appareil n'utilise l'énergie RF que pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF	Classe A	Les caractéristiques d'émission de cet appareil lui permettent d'être utilisé dans les zones industrielles et les hôpitaux.
Courant harmonique IEC 61000-3-2	Classe A	
Variations de tension / fluctuations de tension / scintillement IEC 61000-3-3	Conforme	

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié comme suit. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	IEC 60601 niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - orientations
Électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	Contact ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV air	Contact ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, L'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transit/éclatement électrique rapide IEC 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtempérature IEC 61000-4-5	± 1 kV ligne(s) à ligne(s) Ligne(s) ± 2 kV à la terre	± 1 kV ligne(s) à ligne(s) Ligne(s) ± 2 kV à la terre	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Creux de tension, court-circuit interruptions sur les lignes d'entrée de l'alimentation IEC 61000-4-11	0 % UT ; 0,5 cycle à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°. 0 % UT ; 1 cycle et 70 % UT ; 25/30 cycles Monophasé : à 0 0 % UT ; cycle 250/300	0 % UT ; 0,5 cycle A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°. 0 % UT ; 1 cycle et 70 % UT ; 25/30 cycles Monophasé : à 0 0 % UT ; cycle 250/300	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de l'appareil à ultrasons chirurgical Si l'équipement chirurgical à ultrasons doit continuer à fonctionner pendant les coupures de courant, il est recommandé d'utiliser l'équipement chirurgical à ultrasons. L'équipement doit être alimenté par une alimentation sans interruption ou une batterie.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) Champ magnétique IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Fréquence d'alimentation magnétique doivent être au niveau caractéristique. D'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
IMMUNITÉ test	Test IEC 60601 niveau	Conformité niveau	Environnement électromagnétique orientation
RF par conduction IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz 6 V dans les bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz	3V	Communications RF portables et mobiles L'équipement ne doit pas être utilisé plus près d'une partie quelconque de l'appareil, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation de la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée
RF rayonnée IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz à } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz à } 2,7\text{GHz}$ <p>où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminées par une étude électromagnétique du site.3 doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués du symbole suivant :</p>  <p>Le PORT D'ENCLOSURE de l'ÉQUIPEMENT ME et des SYSTÈMES ME doit être testé comme spécifié dans le tableau 9 de la CEI 60601-1-2 en utilisant les méthodes d'essai spécifiées dans la CEI 61000-4-3.</p>

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et les appareils.

L'équipement chirurgical à ultrasons vise une application dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil selon les recommandations suivantes, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur (w)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur / m		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

REMARQUE : ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Conditions techniques

Composants nécessaires au fonctionnement du système : Instrument électrochirurgical, Transducteur, Pédale à ultrasons, Pédale à Ultrasons, Ciseaux Ultrasons ou Pièces main d'électrochirurgie Connecteur électrochirurgical à ultrasons Instrument électrochirurgical.

Se référer à la description du produit pour ce composant.


Degré de protection contre les chocs électriques	Ultrasons :  Type CF Applied Part ; Bipolar Electrochirurgical 
Degré de protection contre les chocs électriques	Defibrillation-proof Type CF Applied Part
Degré de protection contre les infiltrations d'eau nocives	Classe I
Générateur d'infusions nocives	Équipement normal
Degré de protection contre les infiltrations d'eau nocives	Pédale de commande : IP68
Catégorie de gestion	Classe IIb
Exigences relatives aux paramètres du mode ultrason :	
Puissance d'entrée	Tension d'alimentation : 100-240V Fréquence d'alimentation : 50Hz/60Hz Puissance d'entrée : 400VA
Exigences relatives aux paramètres du mode ultrason :	
Fréquence d'excitation	54 kHz - 57 kHz
Excursion vibratoire de la pointe primaire	25 µm ~ 110 µm
Ciseaux À Ultrasons surface de sortie acoustique principale Produit :	1,53-2,75 mm2
Ciseaux À Ultrasons Acoustique de la réticulation secondaire à la pointe des ciseaux Ultrasons Zone de sortie :	19,32~35,88 mm2
Son de sortie dérivé à la pointe Ciseaux À Ultrasons à la pointe de référence Amplitude primaire Puissance	< 30W
Type de contrôle de la fréquence du système	Indépendamment de la charge, la fréquence d'excitation est automatiquement ajustée en continu.
Indice de réserve de marche	Pas moins de 2,5
Exigences en matière de paramètres électrochirurgicaux :	
Fréquence de travail	400KHz ± 5%
Tension de sortie maximale	≤ 250V
Mode bipolaire avancé Courant de sortie maximal	≤ 5.5A
Mode bipolaire de base Courant de sortie maximal	≤ 2.2A
Tension maximale de sortie crête à crête	≤ 500Vpk
Facteur de crête	1.6 ± 0.4
Puissance nominale	Radiofréquence avancée bipolaire : 270 W Radiofréquence Bipolaire de base : 95W
Charge nominale	Radiofréquence bipolaire avancée : 30Ω Radiofréquence Bipolaire de base : 200Ω

Conditions de l'environnement opérationnel	Température : 10 ° C à 30 ° C
	Humidité relative : ≤ 70%
	Plage de pression atmosphérique : 800 hPa à 1060 hPa
Conditions de transport et de stockage	Température : -30°C à + 55°C (Générateur, Interrupteur à pédale, adaptateur) Température : -10 ° C à + 55 ° C (Ciseaux À Ultrasons)
	Humidité : ≤ 80%
	Plage de pression atmosphérique : 800 hPa à 1060 hPa
Date de fabrication	La date de fabrication peut être déterminée par le numéro de série figurant sur le panneau arrière du Générateur.
Cordon d'alimentation	Conformité avec les exigences de certification de la CCC
	Courant nominal : 10A
Taux de persistance	Déterminé par la pièce à main du transducteur et la Ciseaux À Ultrasons utilisés. Pour obtenir des informations sur le taux de persistance, se référer aux Ciseaux À Ultrasons applicables et à la section Instructions relatives à la pièce à main du transducteur ou Chapitre 7 - Avertissements et précautions.
Fusible	45 * 20 T8AH250V
Poids (sans emballage)	Générateur : 8 kg nominal

Volume total	Générateur OP9 : (longueur * largeur * hauteur) : 34 cm-34 cm-16 cm
Disposition	Certains composants internes du Générateur, de l'interrupteur à pédale et du câble de l'interrupteur à pédale contiennent du plomb. Selon les normes locales Exigences et réglementations en matière d'élimination. Éliminer les piles conformément aux pratiques d'élimination des déchets appropriées.
Classification AP/APG	Pas d'équipement AP/APG.
Durée de vie :	Durée de vie : 7 ans
Version du logiciel	V01.01

Forme d'onde de sortie bipolaire

Courbe de puissance de sortie bipolaire avancée

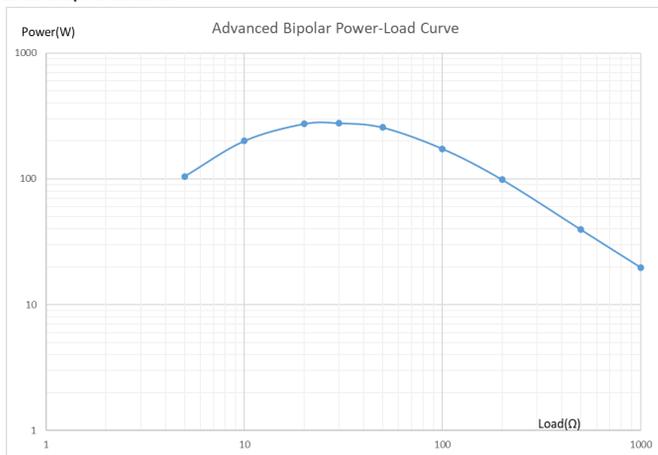


LIMITE DE LA COURBE DE PUISSANCE Sortie max : 270[W]

Charge (Ω)	Limite inférieure	Nominal	Limite supérieure
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Courbe de puissance nominale de 270 watts à la charge nominale conformément à la limite courant/tension de l'appareil de mesure de la courbe de puissance. La courbe de puissance représente l'enveloppe qui varie en fonction des conditions de fonctionnement.

Courbe de base de la sortie bipolaire à pleine puissance

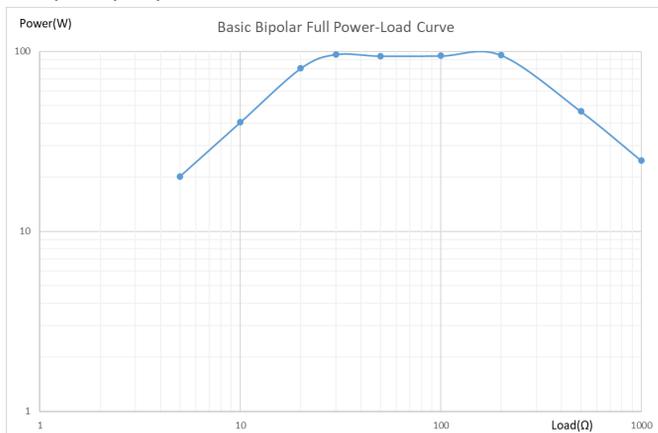


Limite de la courbe de pleine puissance [W] : Puissance maximale 95 Watts			
Charge (Ω)	Limite inférieure	Nominal	Limite supérieure
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Courbe de base de demi-puissance et de charge de la sortie bipolaire

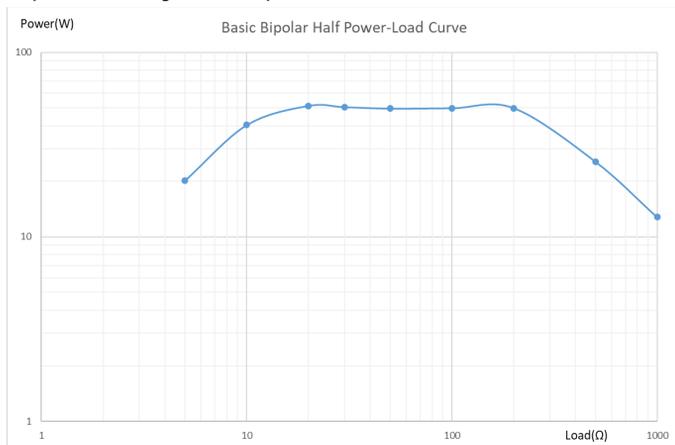

Limite de la courbe de demi-puissance [W] : Puissance maximale 50 Watts			
Charge (Ω)	Limite inférieure	Nominal	Limite supérieure
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Puissance de sortie en fonction des réglages de puissance pour la puissance en mode bipolaire normal

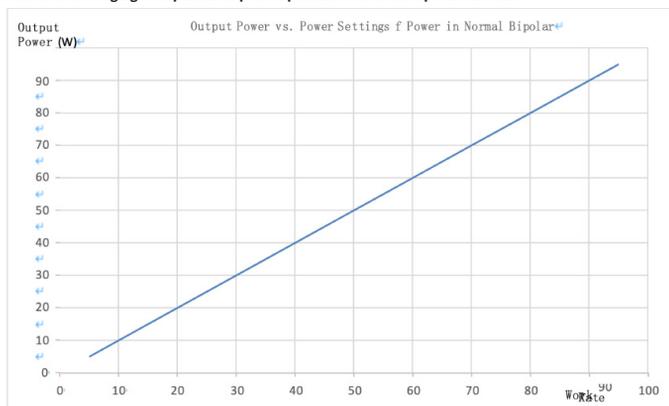

Puissance de sortie en fonction de la valeur de réglage de la puissance pour un fonctionnement bipolaire normal [W] ; charge : 200Ω			
Puissance réglée (W)	Limite inférieure de la puissance de sortie (W)	Puissance nominale (W)	Limite supérieure de puissance de sortie (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Service et garantie

Reach Surgical, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien préventif pendant la période de garantie spécifiée ci-dessous. L'obligation de Reach Surgical dans le cadre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, de tout produit ou pièce défectueux qui a été retourné à Reach Surgical, Inc. ou à son distributeur agréé pendant la période de garantie applicable et qui s'avère défectueux à la satisfaction de Reach Surgical. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ou pièces qui ont été :

- Affectés par l'utilisation de dispositifs non autorisés fabriqués ou distribués par des parties non autorisées par Reach Surgical, Inc.
- Réparé ou modifié en dehors de l'usine de Reach Surgical, si cela affecte la stabilité ou la fiabilité de l'appareil selon Reach Surgical.
- Soumis à une utilisation inappropriée, à la négligence ou à un accident.
- Utilisé d'une manière incompatible avec la conception, les paramètres d'utilisation, les instructions et les lignes directrices du produit ou avec les normes fonctionnelles, opérationnelles ou environnementales acceptées par l'industrie pour des produits similaires.

Périodes de garantie

Connecteur d'énergie bipolaire de base (OP-BPC) : 1 an pour les composants et la main d'œuvre.

Générateur (OP9) : 1 an pour les composants et la main d'oeuvre.

Interrupteur à pédale/Cordon d'alimentation : 1 an pour les composants et la main d'oeuvre.

Cette garantie est le recours exclusif de l'acheteur initial et remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Reach Surgical, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, y compris les dommages résultant d'une perte d'utilisation, de bénéfices, d'affaires ou de clientèle, sauf dans les cas expressément prévus par la loi applicable.

Reach Surgical, Inc. n'autorise personne à assumer une responsabilité supplémentaire en rapport avec la vente ou l'utilisation de ses produits. Aucune garantie ne s'étend au-delà des conditions énoncées dans le présent document.

Reach Surgical, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans être tenu d'appliquer rétroactivement ces modifications aux produits vendus ou fabriqués antérieurement.

Pregled

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije prije korištenja ovog uređaja. Pruža važne upute u vezi s pravilnim radom, potencijalnim rizicima i mogućim oštećenjima proizvoda ili pojedinaca. U slučaju bilo kakve neuobičajene situacije, slijedite navedene upute kako biste spriječili ozljedu sebe ili štetu na opremi. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do ugrožavanja sigurnosti, performansi, jamstva ili održavanja, za što se proizvođač ne može smatrati odgovornim. Prije uporabe uređaja također pročitajte upute za Transductor i Ultrazvučni škare. Ovaj je dokument osmišljen kao pomoć pri korištenju ovog uređaja. Nije referenca za kirurške tehnike.

Korištene standardne konvencije: Oprez, UPOZORENJE i Napomena

Imajte na umu sljedeće izjave, kategorizirane kao OPREZ, UPOZORENJE ili NAPOMENA, koje daju bitne smjernice za sigurno i temeljito izvršavanje zadataka. Ove se izjave mogu pronaći u cijeloj dokumentaciji i treba ih pročitati prije nego što prijedete na sljedeći korak u postupku.

UPOZORENJE : Ova izjava naglašava radni postupak ili postupak održavanja, praksu ili uvjete koji bi, ako se striktno ne poštuju, mogli dovesti do osobnih ozljeda ili gubitka života.

OPREZ : Ova izjava upozorava korisnika na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjom ili umjerenom ozljedom korisnika ili pacijenta, kao i oštećenjem opreme ili druge imovine. Također može poslužiti kao upozorenje protiv nesigurnih postupaka. To uključuje potrebne mjere opreza za sigurnu i učinkovitu upotrebu instrumenta i brigu potrebnu za sprječavanje oštećenja koja proizlaze iz pravilne ili nepravilne uporabe.

NAPOMENA : Ova izjava ukazuje na radnu praksu ili stanje koje je bitno za učinkovito izvršavanje zadatka.

Opis

Elektrokirurški instrument ENER REACH (u daljnjem tekstu "uređaj") koristi se u medicinskim operacijskim dvoranama za kirurške postupke rezanja, koagulacije ljudskog tkiva i povezivanja krvnih žila. Sadrži dva odvojena utora: jedan za ultrazvučnu energiju, a drugi za radiofrekvencijski valni izlaz.

U radiofrekvencijskom načinu rada, Generator isporučuje različite energetske sheme ovisno o spojenom instrumentu/elektrokirurškom uređaju. Kada se poveže napredni bipolarni instrument, Generator isporučuje RF valne oblike za brtvljenje arterijskih i venskih žila, limfnih žila i snopova tkiva promjera do 7 mm. Kada je osnovni bipolarni instrument spojen, konstantna energija izlazi za rezanje mekog tkiva i koagulaciju.

U načinu ultrazvučnog izlaza energije, koristeći TRA6 Transductor u kombinaciji s Jednokratni ultrazvučni skalpel CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, uređaj reže meka tkiva zahtijevajući kontrolu krvarenja i minimalno toplinsko oštećenje, te brtvi krvne žile do maksimalnog promjera od 5 mm. Kada je povezan s Jednokratni ultrazvučni škare SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 i SRE45, uređaj reže meka tkiva zahtijevajući kontrolu krvarenja i minimalno toplinsko oštećenje, te brtvi krvne žile do maksimalnog promjera od 7 mm.

Namjena

Uređaj daje radiofrekvencijsku snagu za pokretanje elektrokirurških nasadnika koji su namijenjeni za rezanje i brtvljenje krvnih žila te za rezanje, hvatanje i seciranje tkiva.

Uz to, Generator pruža ultrazvučnu snagu za pokretanje ultrazvučnih kirurških instrumenata koji su indicirani za rezove mekog tkiva kada je poželjna kontrola krvarenja i minimalna toplinska ozljeda.

Indikacije

Uređaj daje radiofrekvencijsku snagu za pokretanje elektrokirurških nasadnika koji se koriste tijekom otvorenih operacija ili laparoskopskih operacija u općoj, pedijatrijskoj, ginekološkoj, urološkoj, torakalnoj kirurgiji za rezanje i brtvljenje žila do i uključujući 7 mm, te za rezanje, hvatanje i seciranje tkiva.

Osim toga, Generator daje snagu za pokretanje ultrazvučnih kirurških instrumenata koji su indicirani za rezove mekog tkiva kada je poželjna kontrola krvarenja i minimalna toplinska ozljeda. Ultrazvučni kirurški instrumenti mogu se koristiti kao dodatak ili zamjena za elektrokirurgiju, lasere i čelične skalpele za rezanje i/ili koagulaciju tkiva u otvorenim operacijama ili laparoskopskim operacijama općenito, pedijatrijskim, ginekološkim, urološkim, torakalnim te pečenjem i transekcijom limfne žile.

Predviđeni korisnik

Uređaj je namijenjen za korištenje od strane zdravstvenih radnika za kirurške primjene.

Okruženje namijenjeno uporabi

Uređaj je namijenjen za korištenje u bolnici.

Predviđena populacija pacijenata

Ovaj je uređaj prikladan za pacijente u dobi od 3 godine i starije koji zahtijevaju kirurške zahvate koji uključuju rezove mekog tkiva uz kontrolu krvarenja i minimalnu toplinsku ozljedu.


Klinička korist

Uređaj se može sigurno i učinkovito koristiti u podvezivanju i podjeli krvnih žila, snopova tkiva i limfnih žila.

Kontraindikacije

Ovaj uređaj je kontraindiciran za rezove kostiju, kontracepcijske okluzije jajovoda i postupke koagulacije. Također nije namijenjen za korištenje u neurokirurgiji.

Sastav sustava

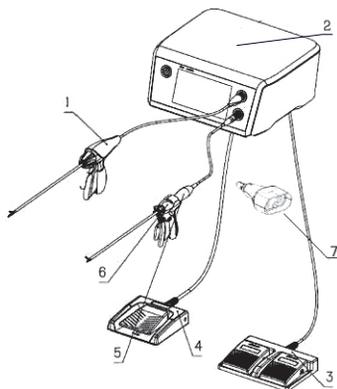

[01] Elektrokirurški nasadnici	[02] OP9 Generator
[03] Ultrazvučni nožni prekidač	[04] Elektrokirurški nožni prekidač
[05] Transductor	[06] Ultrazvučni škare
[07] Elektrokirurški bipolarni pretvarač	

[01] Elektrokirurški nasadnik

Kirurg tijekom postupka upravlja elektrokirurškim nasadnikom, spojenim na Generator. Primjenjuje RF elektrokiruršku energiju na tkivo između svojih Čeljusti radi koagulacije ili brtvljenja. Instrument također uključuje oštricu za dijeljenje tkiva. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Detaljne informacije potražite u uputama.

[02] OP9 Generator

Generator osigurava i elektrokiruršku energiju i energiju ultrazvučne terapije putem zasebnih priključnih priključaka za instrumente. Sastoji se od kućišta, školjke, elektroničke ploče, LCD zaslona osjetljivog na dodir, prekidača napajanja i sučelja za spajanje dodatne opreme.

Model: OP9

[03] Ultrazvučni nožni prekidač

Koristi se za kontrolu izlaza ultrazvučne energije za uključivanje/isključivanje s dva prekidača ("MIN" i "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrokirurški nožni prekidač

Koristi se za upravljanje uključivanjem/isključivanjem izlaza visokofrekventne energije jednim prekidačem.

Model: OP-FSS

[05] Transductor

Transductor pretvara električnu energiju iz kompatibilnog Generatora u mehaničko kretanje za oštricu instrumenta. To je instrument za višekratnu upotrebu s ograničenim vijekom trajanja. Transductor nije sterilan i mora se sterilizirati prema uputama prije uporabe. Za detaljne informacije pogledajte upute TRA6 Transductor.

Model: TRA6.

[06] Ultrazvučni škare

Ultrazvučni škare koriste mehanički pokret iz Transductor i isporučuje ultrazvučnu energiju za rezanje tkiva ili koagulaciju. Treba biti oprezan jer se mehanička vibracija ne može otkriti i mogla bi nenamjerno utjecati na neciljana područja. Ultrazvučni škare su sterilizirani etilen oksidom. Ako je rok trajanja prekoračen ili je paket za sterilizaciju oštećen, Ultrazvučni škare se ne smije koristiti i treba ga baciti. Za detaljne informacije pogledajte upute za Ultrazvučni škare.

Sljedeći Ultrazvučni škare su kompatibilni s OP9 Generator:

PD serije: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB serija: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Serije SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Bipolarni konektor za elektrokirurgiju

Koristi se za spajanje osnovnog bipolarnog Elektrokirurški instrumenti na Generator za koagulaciju tkiva.

Model: OP-BFC

Generator Prednja ploča

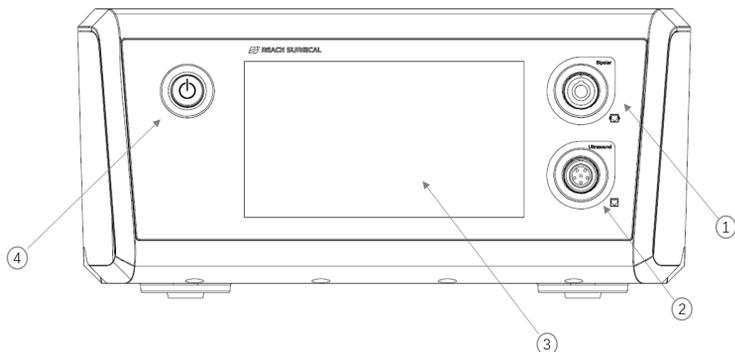

[01] Elektrokirurška utičnica

Koristi se za spajanje naprednog bipolarnog Elektrokirurški instrumenti ili elektrokirurškog bipolarnog konektora.

[02] Transductor utičnica


Povezuje Transductor s Generator.

[03] LCD zaslon osjetljiv na dodir

Prikazuje informacije o sustavu i služi kao sučelje za podešavanje kontrola i postavki.

[04] Snaga gumb prekidača

Pritisnite za uključivanje Generator; pritisnite i držite za isključivanje.

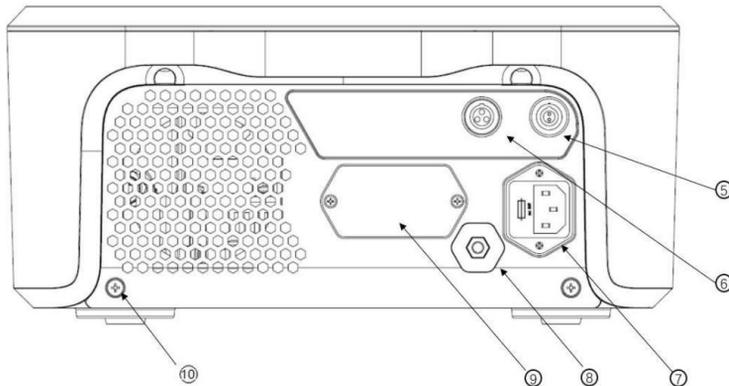Generator Stražnja ploča**[05] Elektrokirurška utičnica za pješavanje**

Okrugla utičnica za spajanje elektrokirurškog nožnog prekidača.

[06] Utičnica ultrazvučne nožne sklopke

Okrugla utičnica za spajanje ultrazvučne nožne sklopke.

[07] Utičnica za napajanje

Spaja kabel za napajanje na Generator.

[08] Priključak za izjednačavanje potencijala

Ako uzemljenje utičnice nije sigurno, ovaj priključak omogućuje spajanje na zaštićeno uzemljenje.

[09] Sučelje proširenja

Koristi se za proširenje funkcija i održavanje.

[10] Montažna rupa**Upute za korištenje**

Pogledajte priložene smjernice za radno okruženje.

Raspakiranje

Molimo slijedite upute nakon što primite komponente u nastavku.

- Provjerite postoje li vidljiva oštećenja tijekom transporta. Ako se pronađe bilo kakvo oštećenje, kontaktirajte Reach Surgical, Inc ili lokalnog agenta za pomoć.

Komponente uključene u (Za detaljne tehničke specifikacije i kodove proizvoda, pogledajte poglavlje 'Tehnički uvjeti sustava'):

M odel	Opis	C komponenta
OP9	Generator	Generator , Kabel za napajanje , Upute
TRA6	Transductor	Transductor sa kablom
OP-FSD	Ultrazvučni nožni prekidač	/
OP-FSS	Bipolarni nožni prekidač	/
OP-BPC	Osnovni bipolarni energetske konektor	/

Sigurnosne mjere opreza

- Tijekom pregleda opreme, držite distalni kraj instrumenta podalje od drugih aparata, kirurških zastora, pacijenta ili bilo kojih drugih predmeta kako biste izbjegli ozljede.
- Provedite potrebne sigurnosne mjere u prisutnosti para, slijedeći bolničke procedure i propise.

Ultrazvučna energija s PD serijom Ultrazvučni škare

- Spojite Transductor , nožni prekidač i PD seriju Ultrazvučni škare na Generator.
- Nakon prolaska testa Transductor i Ultrazvučni škare, podesite razinu snage (1-5) pomoću ikona +/- na LCD zaslonu.
- Pritisnite tipku 'Min' na Ultrazvučni škare ili Min pedalu na nožnom prekidaču za aktiviranje ultrazvučne energije na unaprijed postavljenoj razini snage.
- Pritisnite tipku 'Max' na Ultrazvučni škare ili Min pedali na nožnom prekidaču za isporuku maksimalne razine snage energije.
- Otpustite tipku ili nožni prekidač za zaustavljanje proizvodnje energije.

Ultrazvučna energija sa SRB/SRE serijom Ultrazvučni škare

- Nakon prolaska testa Transductor i Ultrazvučni škare, podesite razinu snage (1-5) pomoću ikona +/- na LCD zaslonu.
- Pritisnite Gumb za energiju na instrumentu ili gumb Min na papučici za aktiviranje ultrazvučne energije na prethodno postavljenoj razini snage.
- Pritisnite Gumb za energiju s naprednom hemostazom na instrumentu za aktiviranje naprednog načina hemostaze.
- Otpustite gumb na Ultrazvučni škare ili gumb na Nožni prekidač kako biste zaustavili isporuku energije.

Elektrokirurška bipolarna energija s naprednim bipolarnim instrumentima

- LCD zaslon prikazuje naprednu bipolarnu ikonu i ikonu podesive ručne kontrole.
- Povucite Poluga na instrument ili pritisnite papučicu nožnog prekidača za aktiviranje radiofrekvencije.
- Generator će zaustaviti izlaz energije kada se zatvaranje dovrši, što je označeno ikonom za kompletno na zaslonu.
- Ako podvezivanje nije dovršeno, oglasit će se ton upozorenja i prikazati ikona upozorenja.

Elektrokirurška bipolarna energija s bipolarnim elektrokirurškim instrumentom

- LCD zaslon prikazuje vrijednost snage, podesive ikone i stupce razine snage.
- Postavke snage se kreću od 1-95 vata, s podesivim koracima.
- Odaberite željenu postavku izlazne snage: niska (15 vata), srednja (30 vata) ili visoka (60 vata).
- Pritisnite tipku na ručnom prekidaču ili papučici nožnog prekidača kako biste aktivirali radio frekvenciju.
- Otpustite tipku da deaktivirate izlaz energije.

Preporuke za postavljanje

Postavke efekta	Raspon postavki napajanja	Klinička primjena	Optimiziran uređaj
Niska	1-15 vata	Kao što su živci/kralježnica, ruke i kirurgija lica	· Uređaji s manjim površinama · Microtip pinceta (0,4 – 2,2 mm)
Sredina	16-40 watta _	Kao što je koagulacija tijekom glave/vrata, kralježnice i anatomije	· Uređaji srednje površine · Microtip pinceta (1,0 – 2,2 mm) · Mala laparoskopska pinceta s ravnom glavom · Bipolarne škare
visoko	45-95 vata (u koracima od 5 vata)	Kao što su glava/vrat i plastična kirurgija (slično srednjem učinku, ali s bržim učinkom)	· Uređaji s velikim površinama · Velika laparoskopska pinceta s ravnom glavom

NAPOMENA : Ovaj uređaj nije kompatibilan s neutralnom elektrodom.

NAPOMENA : Ultrazvučni škare i RF električni skalpel dijelovi su koji se primjenjuju u kontaktu s pacijentom

Pjevaš Generator


Uključite uređaj _

- Sustav je spreman za rad nakon što je uključen. Kada je Generator spojen na napajanje i svijetli svjetlo prekidača za stanje pripravnosti, sustav je spreman za upotrebu.

- Nakon pritiska na gumb Standby, prikazat će se sljedeća slika:




- Ako Transductor ili Ultrazvučni škare nisu spojeni na Generator ili ako su neispravno povezani, prikazat će se sljedeća slika:

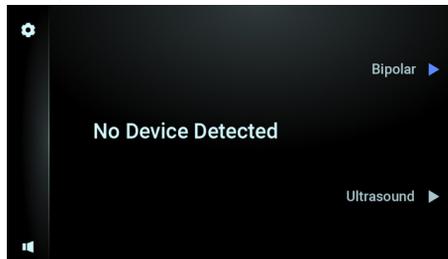

Korištenje ultrazvučnog instrumenta (Transductor i Ultrazvučni škare)

Kada se otkriju Transductor i Ultrazvučni škare, prikazat će se sljedeća slika.

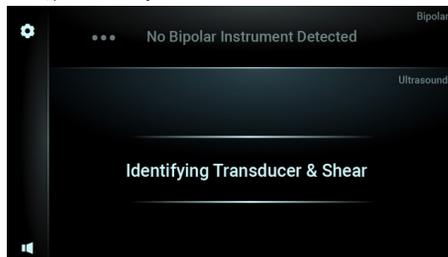


NAPOMENA : ako je preostalo korištenje Transductor manje od 10, prikazat će se sljedeća slika. Obratite pozornost na broj preostalih upotreba jer


Transductor treba zamijeniti kada broj postane nula.




Zatim će se prikazati sljedeća slika, od vas će se tražiti da pritisnete bilo koji gumb na Ultrazvučni škare za početak testiranja Ultrazvučni škare s otvorenim Čeljusti.

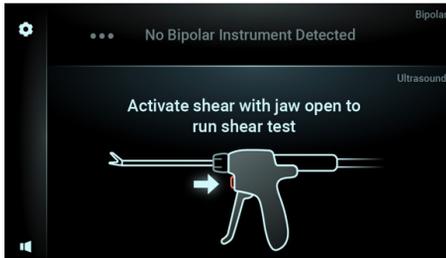


Pritisnite bilo koji gumb i prikazat će se sljedeća slika.

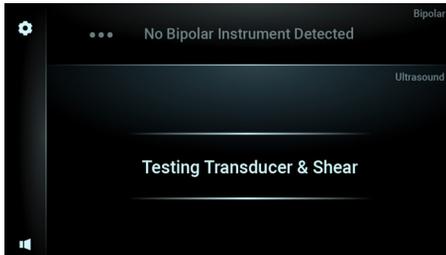


Kada test Transductor ne uspije, prikazat će se sljedeća slika:

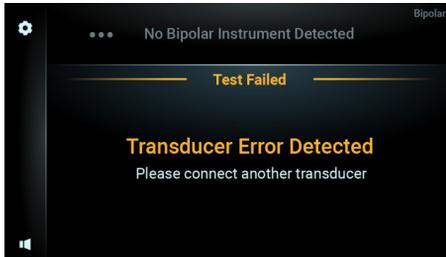

prikazat će se sljedeća slika

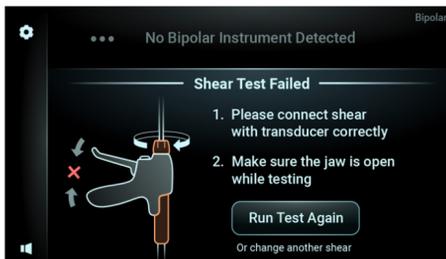

Kada test Transductor i Ultrazvučni škare prođe, prikazat će se sljedeća slika:

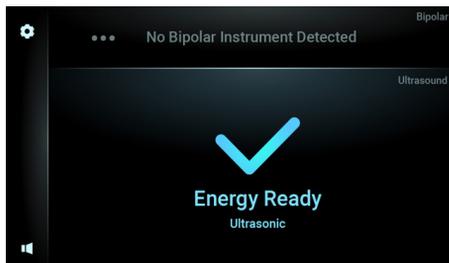

Sljedeći radni zaslon prikazat će se kada povežete Ultrazvučni škare bez napredne funkcije hemostaze.




Sljedeći radni zaslon prikazat će se pri povezivanju SRE Ultrazvučni škare s Advanced Hemostasis.




Način rada izlaza bit će istaknut ako je aktiviran.

Korištenje elektrokirurškog instrument


Kada se otkrije Transducer i Ultrazvučni škare, prikazat će se sljedeća slika.

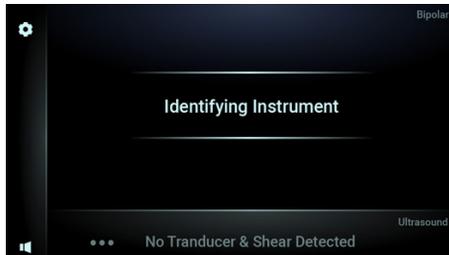

Kada test elektrokirurškog instrumenta prođe, prikazat će se sljedeća slika:

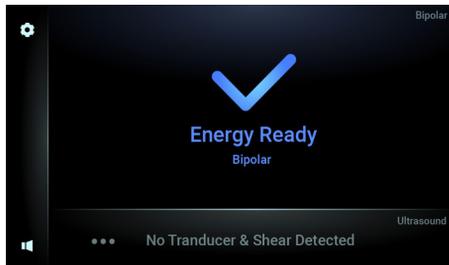

Prilikom spajanja na napredni bipolarni instrument prikazat će se sljedeći radni zaslon.

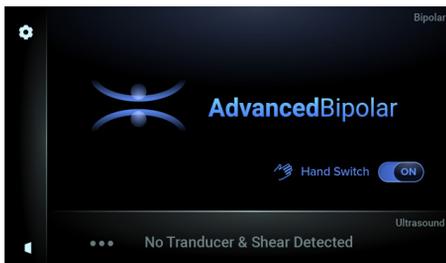


Sljedeći radni zaslon prikazat će se prilikom spajanja na uobičajeni bipolarni instrument.




Korištenje elektrokirurškog instrument i Ultrazvučni škare

Imajte na umu da kada je Generator spojen i na bipolarni elektrokirurški instrument i na Ultrazvučni škare, sustav radi u načinu podijeljenog zaslona za prikaz trenutnog stanja. Uređaj koji ima prioritet prvi će aktivirati energiju. Ovo stanje podijeljenog zaslona prikazano je u nastavku:

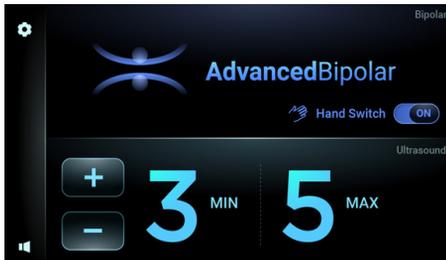

Postavke sustava

Za pristup postavkama sustava kliknite na ikonu postavki koja se nalazi u gornjem lijevom kutu ekrana. Dostupne su sljedeće opcije postavki sustava:

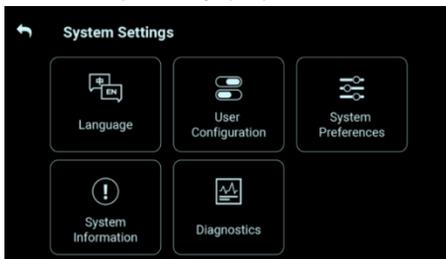


Jezik : Klikom na stavku Jezik prikazat će se zaslon za odabir jezika:




Korisnička konfiguracija: Klikom na stavku Korisnička konfiguracija prikazat će se zaslon korisničke konfiguracije:




Postavke sustava: Klikom na stavku Postavke sustava prikazat će se ekran postavki sustava:



Informacije o sustavu: Lagano kliknite na stavku Informacije o sustavu za prikaz zaslona s informacijama o sustavu:

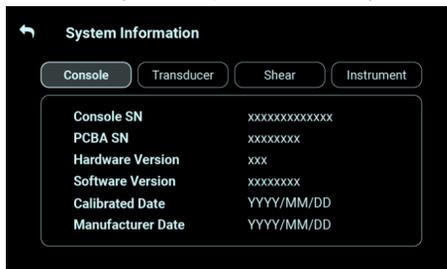

Dijagnostika: Klikom na stavku Dijagnostika prikazat će se dijagnostički zaslon:

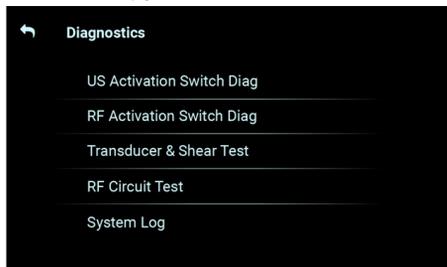

Za izlaz iz postavki sustava i povratak u stanje pripravnosti sustava pritisnite ikonu 'Povratak' koja se nalazi u gornjem lijevom kutu zaslona.

Gašenje sustava

Za sigurno isključivanje sustava slijedite korake u nastavku:

Pritisnite gumb za stanje pripravnosti: Pronađite gumb za stanje pripravnosti na Generator i pritisnite ga za pokretanje postupka isključivanja.

Odspojite Transducer i Ultrazvučni škare: Pažljivo odspojite Transducer i Ultrazvučni škare od sustava. Za pravilno rukovanje Transducer i Ultrazvučni škare pogledajte upute za uporabu.

Čišćenje: Očistite Generator, nožni prekidač i Transducer u skladu s navedenim postupcima navedenim u poglavlju 'Održavanje'.

Rješavanje problema

Generator uključuje različite signale upozorenja i kodove grešaka za pomoć u identifikaciji i dijagnozi kvarova komponenti. Važno je napomenuti da su ovi signali i kodovi osmišljeni da podrže kliničku prosudbu i promatranje, a ne da ih zamijene.

Zvučno upozorenje

Radni status	Vrsta zvuka	Mogući uzrok i djelovanje
Status samoprovjere	Normalan zvuk	/
	Neormalan zvuk	Otkrivena je hardverska greška. Obratite se proizvođaču za pomoć pri popravku.
Korištenje ultrazvučnog instrumenta	Maksimalna razina zvuka	/
	Minimalna razina zvuka	/
	Neormalan zvuk	Ultrazvučni škare je došao u kontakt s prekomjernim tkivom. Smanjite kontakt tkiva s Ultrazvučni škare. Ako kontinuirani zvuk i dalje postoji, pažljivo uklonite svako tkivo koje bi se moglo nakupiti oko kraja Ultrazvučni škare. Otkrivena je pogreška s Transductor i/ili Ultrazvučni škare. Obratite se proizvođaču ili kontaktirajte podršku za daljnju pomoć.
	NAPREDNI zvuk	/
	NJEGOVI zvuk	/
Aktiviranje elektrokirurškog instrumenta	Napredni bipolarni ton upozorenja	/
	Normalan bipolarni zvuk	/
	Neormalan zvuk	Neuspješno rezanje: Ako tkivo koje je u kontaktu s instrumentom ne zadovoljava zahtjeve rezanja, smanjite količinu tkiva u kontaktu s instrumentom. Ako se ton greške nastavi, pažljivo očistite svako tkivo koje bi se moglo nakupiti na kraju instrumenta. Kvar hardvera: Ova pogreška ukazuje na potencijalni kvar u potencijalnoj kvaru u krugu ili konektoru. U slučaju bilo kakvog kvara ili pogreške, preporuča se konzultirati proizvođača ili potražiti podršku za odgovarajuće smjernice i rješenja.

Kodovi grešaka

Energy Platform Generator opremljena je sveobuhvatnim sustavom identifikacije grešaka koji se sastoji od upozorenja i grešaka u sustavu. Kada se detektira greška, Generator emitira ton upozorenja, prikazuje signal upozorenja na upravljačkoj ploči i prikazuje odgovarajući kod greške na LCD zaslonu. Slijedite korake navedene u nastavku da biste riješili problem:

Tablica kodova grešaka

Kod pogreške	Odgovarajuća poruka greške
Upozorenje	Ispravno povežite Ultrazvučni škare s Transductor
Upozorenje	Provjerite jesu li Čeljusti otvoreni tijekom testiranja
Upozorenje	Ultrazvučni škare Otkrivena pogreška
Upozorenje	Preostalo vrijeme od Transductor je nula
Upozorenje	Molimo aktivirajte samo jednu tipku odjednom
Upozorenje	Smanjite silu koja se primjenjuje na Ultrazvučni škare
Upozorenje	Ultrazvučni škare gumb i nožni prekidač ne mogu se zatvoriti istovremeno
Upozorenje	Gumb se zaglavio, provjerite i nastavite
Upozorenje	Podesite Čeljusti ili stegnite manje tkiva
Upozorenje	Uklonite uređaj s tkiva
Greška sustava	Greška sustava
Greška sustava	Samoprovjera nije uspjela

Ako se tijekom testiranja na zaslonu pojavi pogreška, učinite sljedeće:



- Provjerite je li kabel Transductor potpuno umetnut u ispravnom smjeru.
- Provjerite je li Ultrazvučni škare ispravno zategnut ili se oko kraja Ultrazvučni škare nakupilo bilo kakvo tkivo. Podesite zategnutost Ultrazvučni škare i pažljivo uklonite nakupljanje tkiva oko kućišta Ultrazvučni škare. (Ako je test započeo prije operacije, provjerite je li Ultrazvučni škare usmjeren prema zraku. Ako se koristi Ultrazvučni škare, potvrdite da je stezna čeljust otvorena i da nije u kontaktu s bilo kakvim objektima.)
- Ako se problem nastavi, razmislite o zamjeni Transductor ili Ultrazvučni škare.
- Prijedite na način rada opreme.

NAPOMENA: Transductor možda neće ispravno funkcionirati ako njegova temperatura premaši navedeno ograničenje. U takvim slučajevima odmah upotrijebite drugi Transductor za oporavak ili slijedite korake u nastavku kako biste utvrdili uzrok pogreške i istražili neobavezne metode oporavka:

- Ostavite Transductor da se ohladi na sobnoj temperaturi najmanje 45 minuta. Ova metoda hlađenja također se primjenjuje ako se Transductor zagrije nakon duljeg rada pri visokoj snazi.
- Ako Transductor pregrijavanje nije vidljivo i problem ostaje neriješen, kontaktirajte predstavnike održavanja proizvođača za pomoć.
- Osim osigurača, u Generator nema dijelova koje može servisirati korisnik. Za bilo kakvu zamjenu ili zahtjeve za servisiranjem obratite se servisnom osoblju koje je obučeno i ovlastilo Reach Surgical, Inc. ili vaš lokalni predstavnik.

Održavanje i nadogradnju uređaja Generator treba obavljati isključivo servisno osoblje koje je obučeno i ovlastilo Reach Surgical.

Trebalo bi razmotriti mjere predostrožnosti kibernetičke sigurnosti kako bi se spriječila potencijalne prijetnje. Sljedeći incidenti predstavljaju rizike za kibernetičku sigurnost:

- Neovlašteni pristup svim proizvodima koji nisu povezani s uređajem.

- Svaka neovlaštena mrežna komunikacija s uređajem.
 - Firmware ili nadogradnje softvera koje nije odobrio Reach Surgical.
- U slučaju bilo kojeg od gore navedenih incidenata, obratite se prodajnom predstavniku tvrtke Reach Surgical, Inc. ili se izravno obratite tvrtki Reach Surgical, Inc. na Reachquality@reachsurgical.com.

Održavanje

Čišćenje i dezinfekcija Generator i osnovnog bipolarnog energetskeg konektora

Čišćenje

Očistite Generator LCD zaslon i bipolarni konektor Basic u skladu s bolničkim postupcima i propisima. Prije čišćenja provjerite je li glavno napajanje uređaja Generator isključeno i je li kabel za napajanje uklonjen iz izlazne jedinice.

UPOZORENJE : Postupci čišćenja moraju se pažljivo slijediti kako bi se izbjeglo oštećenje Generatora, izazivanje strujnog udara ili stvaranje opasnosti od požara. Nemojte proljevati ili prskati tekućine na ili u Generator, niti ga uranjati u tekućinu.

Slijedite ove korake za čišćenje:

- Pripremite neutralni pH deterdžent ili neutralni pH enzimski deterdžent prema specifikaciji proizvođača deterdženta.
- Čistom, mekom krpom natopljenom malom količinom otopine za čišćenje ručno obrišite sve površine, uključujući Generator zaslon.
- Obrišite sve površine čistom, mekom krpom namočenom u toplu vodu iz slavine.
- Na kraju obrišite sve površine čistom, mekom krpom kako biste bili sigurni da su suhe.

Dezinfekcija

- Ako Generator postane kontaminiran krvlju ili tjelesnim tekućinama, mora se dezinficirati prije ponovne uporabe. Sljedeći kemijski dezinficijensi potvrđeni su za upotrebu na Generator: 70% izopropilni alkohol, 6% natrijev hipoklorit, 10% vodikov peroksid .
- Slijedite preporuke proizvođača za pravilnu upotrebu, koncentraciju i vrijeme kontakta dezinficijensa.
- Provjerite jesu li dezinficijenski uređaji konfigurirani i korišteni u skladu s uputama proizvođača.

Čišćenje nožnog prekidača

Očistite nožni prekidač i kabel nakon svake uporabe sljedeći postupak:

- Odvojite nožni prekidač od Generatora.
 - Pripremite deterdžent s neutralnim pH enzimom prema uputama proizvođača.
 - Čvrsto spojite kabel s nožnim prekidačem i uronite ih u otopinu za čišćenje na 2 minute.
- NAPOMENA** : Provjerite je li kabel nožne sklopke koji se koristi za spajanje Generatora potpuno suh kako biste spriječili slučajno aktiviranje.
- Nakon uranjanja, ručno oribajte nožni prekidač i kabel mekom četkom u otopini za čišćenje.
 - Temeljito ispirite nožni prekidač i kabel toplom vodom iz slavine najmanje 1 minutu.

OPREZ : Neka kabel i nožni prekidač budu dobro povezani tijekom ispiranja.

- Obrišite sve površine čistom, mekom krpom.

UPOZORENJE : Ne koristite ultrazvučni stroj za čišćenje za čišćenje nožnog prekidača.

UPOZORENJE : Nemojte uključivati napajanje Generatora prije spajanja AC kabela za napajanje. Provjerite jesu li svi spojevi suhi prije sastavljanja.

Čišćenje i dezinfekcija Transductor

Transductor se isporučuju nesterilni i zahtijevaju temeljito čišćenje i sterilizaciju prije svake uporabe.

Čišćenje:

Temeljito očistite pretvarače prema sljedećim koracima:

- Isperite pretvarač s vijkom okrenutim prema gore i čistite mekom četkom s pročišćenom vodom dok se s površine ne uklone sve mrlje;
- Pretvarač se može namočiti u pH neutralni enzimski deterdžent (Glavni sastojci: proteaza lipaza amilaza celulaza pektinaza i drugi biološki enzimi, površinski aktivne tvari koje ne štete okolišu, faktor za sprječavanje hrđe i stabilizator) u razdoblju do 10 minuta i na odgovarajućoj temperaturi 15 °C ~ 65 °C. Odnos deterdženta i pročišćene vode je 1:400;
- Isperite pretvarač vijkom okrenutim prema gore, primjenom pročišćene vode tijekom 2 minute;
- Očistite spojni vijak, površinu nosača skalpela i priključak alkoholnom maramicom.
- Namočite pretvarač 75 %-tni medicinski alkohol, držite ga i protresite 30 puta;
- Isperite pretvarač s vijkom okrenutim prema gore primjenom pročišćene vode tijekom 2 minute.

Napomena: za pretvarač se ne preporučuje uporaba ultrazvučnih sredstava za čišćenje.

Sušenje:

Temperatura sušenja: 50 ~ 70 °C, Vrijeme sušenja: 30 min.

Sterilizacija pretvarača:

Nakon navedenih koraka čišćenja i sušenja, pretvarač se mora sterilizirati jednim od načina koji se navode u nastavku.

Sterilizacija parom (121 °C)

- Plašt treba postaviti prije sterilizacije. Pretvarači trebaju biti omotani tijekom sterilizacije. Postavite pretvarače u posudu za sterilizaciju parom na visokoj temperaturi radi sterilizacije, s temperaturom od 121 °C i tijekom 30 minuta.
- Temperatura sušenja: 50 ~ 70 °C, Vrijeme sušenja: 30 min.

Sterilizacija parom (134 °C)

- Plašt treba postaviti prije sterilizacije. Pretvarači trebaju biti omotani tijekom sterilizacije. Postavite pretvarače u posudu za sterilizaciju parom na visokoj temperaturi radi sterilizacije, s temperaturom od 134 °C i tijekom 10 minuta.
- Temperatura sušenja: 50 ~ 70 °C, Vrijeme sušenja: 30 min.

Sigurnosna i funkcionalna ispitivanja

Osigurajte provedbu sigurnosnih i funkcionalnih testova za Transductor , Generator i nožni prekidač u skladu s bolničkim postupcima i propisima. Za sigurnosna i funkcionalna ispitivanja drugih komponenti koje koristi više pacijenata, pogledajte upute za uporabu specifične za svaku komponentu.

Test sigurnosti

Generator : Ovlašteni bolnički tehničari trebali bi provesti ispitivanje struje curenja.

Nožni prekidač : Provjerite ima li na papučici, konektoru kabela i kabelu bilo kakvih pukotina ili oštećenja. Zamijenite sve oštećene komponente.

Ostale komponente : Provjerite sve ostale komponente prema uputama u odgovarajućim uputama za rad.

Funkcionalni test

Način rada ultrazvuka

- Pripremite kompletan set PD Ultrazvučni škare i povežite Transductor prema uputama danim u Poglavlju II - Instalacija i rad opreme.
- Provjerite je li moguće ući u radno stanje. Različiti Ultrazvučni škare mogu imati različita ulazna sučelja. Pogledajte 1. dio, 3. odjeljak 2. poglavlja za detaljne upute.
- Potvrdite prikaz MIN razine snage 3 i MAX razine snage 5.
- Pritisnite tipke za povećanje i smanjenje snage kako biste bili sigurni da se MIN razina snage može podesiti od razine 3 do 5.

- Uključite Generator i prebacite ga na ultrazvučni način rada. Provjerite ispravnu vezu Transductor i Ultrazvučni škare.
- S otvorenom čeljusti pritisnite gumb "MAX" na nožnom prekidaču. LCD zaslon bi trebao prikazati MAKSIMALNU razinu snage "5" i trebao bi se oglasiti ton za aktiviranje.

- S otvorenom čeljusti pritisnite tipku "MIN" na nožnom prekidaču. LCD zaslon bi trebao prikazati MIN razinu snage i trebao bi se oglasiti ton za aktiviranje.
- UPOZORENJE** : Prije aktiviranja sustava, osigurajte da se čeljust drži podalje od maramica, drugih instrumenata ili bilo kojih drugih predmeta kako biste spriječili ozljede korisnika.

Bipolarni elektrokirurški način

- Spojite napredni bipolarni elektrokirurški instrument/osnovni bipolarni instrument prema uputama.
- Provjerite može li sustav učiti u radno sudjelovanje. Osnovni bipolarni način rada trebao bi prikazivati ikonu razine snage 30 , dok bi napredni bipolarni način trebao prikazivati ikonu "napredni bipolarni".
- Lagano dodirnite tipke za povećanje i smanjenje snage pod Osnovnim bipolarnim načinom rada kako biste potvrdili da se razina snage može podesiti između 1 i 95. Dodirnite trake Niska, Srednja i Visoka za izravan prelazak između 15, 30 i 60.

- Isključite Generator i pričekajte 5 sekundi. Zatim uključite napajanje Generatora i pričekajte 10 sekundi. Provjerite prikazuje li osnovni bipolarni način sučelje s 30 razina snage, a napredni bipolarni način prikazuje sučelje "napredno bipolarno". Provjerite je li Generator aktiviran prema unaprijed određenim zahtjevima.

- Spojite napredni i osnovni bipolarni Elektrokirurški instrumenti i pritisnite jednostruki prekidač. Provjerite trepću li indikatori razine snage na upravljačkoj ploči i poslušajte zvuk aktivacije.

UPOZORENJE : Prije aktiviranja sustava, strogo je zabranjeno dopustiti bilo kakav kontakt Ultrazvučni škare s maramicama, drugim instrumentima ili bilo kojim drugim predmetima kako bi se spriječila ozljede korisnika.

Upozorenja i mjere opreza

Povezano sa sustavom

- Pročitajte upute prije uporabe i slijedite bolničke smjernice za kliničku praksu za ultrazvučno kirurgiju, elektrokirurgiju, ginekologiju i laparoskopiju.
- Minimalno invazivni uređaji mogu se razlikovati od proizvođača do proizvođača. Ako se u ordinaciji istodobno koriste minimalno invazivni instrumenti i pribor različitih proizvođača, prije operacije provjerite kompatibilnost instrumenata i pribora te provjerite imaju li pribor umetnut u ljudsko tijelo hrapavu površinu, oštar rub ili izbočinu koja može uzrokovati sigurnosne opasnosti.
- Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje samo obučeni i licencirani kirurzi. Nemojte koristiti elektrokirurške uređaje osim ako niste pravilno obučeni za njihovo korištenje za određeni postupak koji ćete morati izvršiti. Nestručna uporaba ovog uređaja može izazvati nenamjernu ozbiljnu ozljedu pacijenta, uključujući perforaciju crijeva i nesvjesnu i nepopravljivu nekrozu tkiva.
- Ne otvarajte kućište Generator bez dopuštenja kako biste izbjegli moguće opasnosti od strujnog udara. Svaki popravak i nadogradnju instrumenta mora obaviti servisna osoba obučena i ovlaštena od strane Reach Surgical, Inc. Nemojte koristiti ovaj instrument ni u koju drugu svrhu osim medicinske kirurgije.
- Temeljito razumijevanje principa i tehnika uključenih u laserske, elektrokirurške i ultrazvučne postupke neophodno je za sprječavanje opasnosti od šoka i opekлина za pacijenta i medicinsko osoblje te oštećenja ovog uređaja ili drugih medicinskih uređaja. Električna izolacija ili uzemljenje ne smiju biti ugroženi. Ne uranjajte elektrokirurške uređaje u tekućine osim ako to nije potrebno dizajnom i ako na etiketi ne stoji da ih treba uroniti.
- Sigurno i učinkovito ultrazvučna kirurgija i elektrokirurgija ovise ne samo o dizajnu opreme, već u velikoj mjeri o mnogim čimbenicima koje kontrolira operater. Kako biste poboljšali sigurnost i učinkovitost, pročitajte, razumite i slijedite upute za uporabu koje ste dobili s uređajem.
- Kao i sa svim izvorima energije (elektrokirurški, laser ili ultrazvuk), treba uzeti u obzir kancerogene i infektivne rizike koje mogu predstavljati mnogi nusprodukti tkiva, kao što su dim i aerosoli. Odgovarajuće mjere opreza kao što su sigurnosne naočale, maske za filtriranje i učinkovita oprema za odvod dima moraju se pridržavati i otvorenih i endoskopskih postupaka.
- Nakon uklanjanja uređaja provjerite tkivo na hemostazu. Ako hemostaza izostane, potrebno je upotrijebiti odgovarajuće metode za postizanje hemostaze.
- Proizvodi koje proizvode ili distribuiraju tvrtke koje nije ovlastio Reach Surgical, Inc. možda neće biti kompatibilni s uređajem. Korištenje takvih proizvoda može dovesti do neočekivanih rezultata i ozlijediti korisnika ili pacijenta.
- Kako bi se smanjio rizik od smetnji, uređaj i kućište moraju biti spojeni na neovisni strujni krug.
- Oprema nije prikladna za upotrebu u prisutnosti zapaljive mješavine anestetika sa zrakom ili dušikovim oksidom. Mogućnost iskenjenja zbog sudara s drugim metalnim uređajima. Iskre mogu zapaliti zapaljive plinove, poput plinova iz polja.
- Mora raditi unutar potrebnog raspona radne temperature okoline.
- Izlazni napon utičnice mora zadovoljavati zahtjeve Generatora (poglavlje "Tehnički uvjeti sustava"). Ako napajanje nije pravilno spojeno, može oštetiti Generator i izazvati strujni udar ili opasnost od požara.
- Nemojte koristiti produžne kabele kako biste izbjegli opasnost od požara.
- Ne pretvarajte aktivacijski ton na nečujnu razinu. Osoblje kirurškog tima može primijetiti aktivacijske tonove dok Generator isporučuje energiju.
- Pokazalo se da dim koji nastaje tijekom elektrokirurgije može biti štetan za pacijente ili osoblje kirurškog tima. Predložite odgovarajuću ventilaciju pomoću kirurškog odvoda dima ili na neki drugi način.
- Postoje neke komponente u Ultrasonic Surgical Integrated Generator koje se isporučuju nesterilne (npr. Transductor). Sterilizirajte proizvod prema potrebi prije početka instalacije sustava. Za upute o čišćenju i sterilizaciji pogledajte svaku relevantnu uputu.
- Kako bi se izbjegle ozljede korisnika ili pacijenata, Ultrazvučni škare mora izbjegavati druge uređaje, kirurške zastore, pacijente ili druge objekte prije pritiska na gumb za testiranje i tijekom provjere sustava. Sigurnosne mjere u slučaju aerosola (prema bolničkim propisima) moraju se primijeniti u pregledu sustava i metodi ispitivanja.
- Nemojte previše pritisnuti čeljust kako biste izbjegli sprječavanje isporuke ultrazvučne energije.
- Kako biste izbjegli ozljede korisnika, oštrica mora izbjegavati kontakt s tkivom, drugim uređajima ili drugim predmetima prije aktiviranja sustava.
- Ako se tekućina porska ili izlije na ili u Generator, ili se Generator prolje ili ulije u tekućinu, to može oštetiti Generator i izazvati strujni udar ili opasnost od požara.
- Iskenje i zagrijavanje povezano s tehnikama zatvaranja posude mogu poslužiti kao izvori paljenja. Gaza i spužva trebaju ostati vlažne. Držite elektrokirurške elektrode dalje od zapaljivih materijala i okruženja bogatih kisikom (O2).
- Ako dođe do značajnog oštećenja na Transductor ili ako neki dijelovi pokazuju znakove oštećenja nakon održavanja čišćenja i dezinfekcije, bacite ih. Oštećeni dijelovi su jasno označeni kako bi se izbjegla zlouporaba prije naknadnog rukovanja.
- Otpad koji se može odložiti i elektronički otpad treba odlagati u skladu s bolničkim propisima i ne smije se bacati po želji kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša.
- Izbjegavajte korištenje Generator u blizini ili naslaganog na drugu opremu. Ako je potrebno korištenje u susjedstvu ili na više, nadzirite Generator i drugu opremu kako biste osigurali pravilan rad.
- Uređaj ne sadrži dijelove koje servisira operater. Za servis se obratite prodajnom predstavniku tvrtke Reach Surgical ili servisnom osoblju.
- Prije uporabe provjerite sve uređaje spojene na sustav i veze. Potvrdite da uređaj radi kako je predviđeno. Neispravno spajanje može dovesti do luka, iskenjenja, kvara uređaja ili neželjenih kirurških rezultata.
- Kako bi se izbjegao rizik od električnog udara, ova oprema mora biti spojena samo na napajanje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Držite se što dalje između Generatora i drugih elektroničkih uređaja (npr. monitora). Nemojte križati ili vezati električne žice za elektroničke uređaje. Generator može uzrokovati smetnje s drugim elektroničkim uređajima.
- Sustav treba koristiti s oprezom u prisutnosti unutarnjih i vanjskih srčanih stimulatora. Smetnje uzrokovane upotrebom Elektrokirurški instrumenti mogu uzrokovati ulazak srčanog stimulatora u asinkrono stanje ili potpuno onemogućiti rad srčanog stimulatora. Ako su uređaji za elektrokirurgiju ili brtvljenje tkiva namijenjeni za upotrebu kod pacijenata sa srčanim stimulatorima, obratite se proizvođaču srčanih stimulatora ili kardiološkom odjelu bolnice za dodatne informacije.

- Budite oprezni ako slažete instrumente na Generator ili stavljate Generator na vrhu električnih instrumenata. Ovo je nestabilna konfiguracija i ne osigurava odgovarajuće hlađenje.
- Ako Generator ne uspije, to može uzrokovati kirurški prekid. Sigurnosni sustav mora biti dostupan.
- Ako to zahtijevaju lokalni propisi, Generator treba spojiti na bolnički ekvipotencijalni konektor pomoću kabela za izjednačavanje potencijala.
- Kada se sustav i oprema za fiziološki nadzor koriste istovremeno na istom pacijentu, sve elektrode za nadzor moraju biti postavljene što je dalje moguće od instrumenta.
- U osnovnom bipolarnom načinu rada odaberite najnižu moguću izlaznu snagu za željeni učinak.
- Kvar visokofrekventne kirurške opreme može uzrokovati neočekivano povećanje izlazne snage.
- Generator i osnovni bipolarni elektrokirurški konektor mogu biti napadnuti vodom ili česticama. U procesu korištenja i čišćenja potrebno je izbjegavati prodiranje vode ili čestica.
- Kada se sustav koristi u kombinaciji s endoskopom, može povećati struju curenja na tijelu pacijenta. Obratite pozornost tijekom postupka.
- Obavijest korisniku i/ili pacijentu da svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s uređajem treba prijaviti tvrtki Reach Surgical, Inc. putem adrese Reachquality@reachsurgical.com. i nadležno tijelo države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima poslovni nastan.

Povezano s instrumentima

Tijekom kirurških zahvata važno je biti svjestan da krajnji dio instrumenta Ultrazvučni škare, Ultrazvučni škare jastučića i Osovina može doživjeti povišene temperature kada se ultrazvuk ili bipolarni elektrokoater primjenjuju na tkivo dulje vrijeme. Kako bi se osigurala sigurnost, ključno je izbjegavati svaki slučajni kontakt između ovih komponenti instrumenta i tkiva, kirurških zastora, kirurških mantila ili bilo kojih nepovezanih područja tijekom postupka. Nadalje, bitno je biti oprezan pri postavljanju bipolarnog instrumenta. Točnije, ne smije se stavljati u blizinu ili u dodir s zapaljivim materijalima poput gaze ili kirurških zastora. Bipolarni instrumenti koji se koriste u ovom kontekstu mogu stvarati toplinu tijekom upotrebe, što potencijalno može dovesti do opasnosti od požara. Kada se bipolarni elektrokirurški uređaj Generator ne koristi, treba ga pravilno pohraniti u zaštitnu navluku ili držati na sigurnoj udaljenosti od pacijenta, članova kirurškog tima i svih zapaljivih materijala.

NAPOMENA: Dodatna upozorenja i mjere opreza potražite u odgovarajućim Uputama za uporabu.

EMC informacije

Proizvod je prošao test elektromagnetske kompatibilnosti, što zadovoljava zahtjeve ograničenja standarda IEC60601-1-2 za medicinsku opremu. Ova ograničenja pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u normalnim medicinskim instalacijama.

Sastav proizvoda

Serijski broj	Naziv dijela	Model/Br. verzije	Opaske
1	Elektrokirurški instrument	OP9	/
2	Pretvarač za ultrazvučnu kiruršku opremu	TRA6	Kompatibilna uporaba
3	Ultrazvučni škare Sustav za jednokratnu upotrebu Ultrazvučni škare	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatibilna uporaba
4	Jednokratna ultrazvučna visokofrekventna kirurška jedinica Tissue Sealer	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrazvučni nožni prekidač	OP-FSD	/
6	Elektrokirurški nožni prekidač	OP-FSS	/
7	Bipolarni konektor za elektrokiruriju	OP-BPC	/

Kabel proizvoda

Serijski broj	Naziv kabela	Duljina (m)	Oklopljeno
1	Kabel za nožnu kontrolu	3	Da
2	Kabel za napajanje	5	Ne
3	Bipolarni elektrokirurški kabel	3	Ne
4	Kabel od Transductor	2,9	Da

EMC performanse

Ova oprema može biti podložna radiofrekventnim smetnjama uzrokovanim drugom medicinskom opremom i radio komunikacijama. Kako bi se spriječile takve smetnje, ovaj proizvod je testiran prema IEC 60601-1-2 i ispunjava njegove zahtjeve. Međutim, Reach Surgical, Inc. ne jamči da neće biti apsolutno nikakvih smetnji u pojedinačnim instalacijskim okruženjima.

Ako se utvrdi da uređaj ima smetnje (što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja), korisnik (ili osoblje za održavanje odobreno od strane Reach Surgical, Inc.) trebao bi pokušati poduzeti jednu ili više sljedećih mjera za rješavanje problem smetnji:

Podesite smjer ili položaj uređaja koji na njega utječe.

Povećajte udaljenost između ovog uređaja i uređaja koji šaljete.

Koristite druge izvore napajanja (umjesto struje koja se koristi za utjecaj na opremu) za napajanje ove opreme.

Za druge prijedloge obratite se dobavljaču ili predstavniku servisa.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve smetnje uzrokovane sljedećim situacijama: koristite druge spojne kabele koji nisu preporučeni; mijenjati ili modificirati ovu opremu bez dopuštenja. Neovlaštene promjene ili preinake mogu uzrokovati gubitak učinkovitosti opreme.

Sve vrste elektroničke opreme mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje drugoj opremi putem zraka ili drugih kabela povezanih s njom. Ne koristite uređaje koji mogu emitirati RF signale, kao što su mobilni telefoni, radio primopredajnici ili proizvodi za radio kontrolu, u blizini ovog uređaja, jer to može uzrokovati neuspjeh rada ovog uređaja u skladu s navedenim specifikacijama. Kada su takvi uređaji blizu ovog uređaja, isključite napajanje tih uređaja. Medicinsko osoblje koje je zaduženo za ovu opremu trebalo bi uputiti tehničare, pacijente i druge osoblje koje je moglo biti u blizini ove opreme da se u potpunosti pridržavaju gore navedenih zahtjeva.

Kako bi se u potpunosti postigla navedena EMC izvedba, korisnik bi trebao pravilno instalirati proizvod prema koracima opisanom u priručniku. Ako postoje bilo kakvi problemi povezani s EMC-om, obratite se osoblju za održavanje koje je odobrila Reach Surgical, Inc.

Transductor (s kablom) i Ultrazvučni škare definirani su kao primijenjeni dio cijelog sustava.

Mjere opreza za instalaciju proizvoda

Oprema se može koristiti u bolničkom okruženju, ali ne uključuje prostorije za zaštitu od radijskih frekvencija oko aktivne radiofrekvencijske kirurške opreme ili gdje je postavljena oprema za udarce magnetskog rezonancijom, jer je intenzitet elektromagnetskih smetnji na tim lokacijama visok.

Udaljenost razdvajanja i utjecaj fiksne radiokomunikacijske opreme: jakost magnetskog polja koju stvaraju kirurški fiksni odašiljači, kao što su bazne stanice bežičnih (mobilnih/bežičnih) telefona, kopneni mobilni radio prijamnici, amaterski radio prijamnici, AM i FM radio emisije i TV emisije Generators, itd., ne mogu se teoretski točno izmjeriti. Za procjenu elektromagnetskog okruženja koje stvaraju fiksni RF odašiljači, potrebno je razmotriti mjerenje elektromagnetskog polja. Ako izmjerena vrijednost jakosti magnetskog polja na mjestu uređaja premašuje odgovarajuću radiofrekvencijsku razinu

navedenu u "Izjavi o smetnjama", uređaj treba pregledati kako bi se osiguralo da može normalno raditi. Ako se pronađu neuobičajeni radni uvjeti, potrebno je razmotriti dodatna mjerenja, kao što je preusmjerenje ili premještanje opreme ili korištenje prostorije za zaštitu od radio frekvencija.

1) Upotrijebite kabele za napajanje koji je isporučio ili odredio Reach Surgical, Inc. Proizvodni opremljeni utikačem za napajanje trebaju biti uključeni u fiksnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem. Ne koristite nikakvu vrstu adaptera ili konektora za spajanje utikača.

2) Držite ovaj uređaj što je više moguće dalje od drugih elektroničkih uređaja.

3) Slijedite korake za povezivanje uređaja.

Općenite bilješke

(1) Specifikacija kabela.

Korištenje kabela koje isporučuje tvrtka Reach Surgical, Inc neće oštetiti EMC performanse ovog proizvoda. Ako se koriste neodređeni kabele, EMC performanse ove opreme mogu biti znatno smanjene.

(2) Mjere opreza za neovlaštene izmjene

Korisnik ne smije modificirati ovaj proizvod jer bi se u protivnom EMC učinak ovog proizvoda mogao smanjiti.

Modifikacija proizvoda uključuje sljedeće promjene:

a. Kabel (duljina, materijal i ožičenje, itd.).

b. Instalacija/izgled opreme.

c. Konfiguracija/komponente opreme.

d. Zaštitni dijelovi opreme (dijelovi za otvaranje/zatvaranje poklopca i pričvršćivanje poklopca).

(3) Svi zaštitni poklopci trebaju biti zatvoreni tijekom rada s opremom.

Očekuje se da će se ovaj proizvod koristiti u dolje navedenom elektromagnetskom okruženju, a kupac i korisnik ovog proizvoda trebaju osigurati da se koristi u ovom elektromagnetskom okruženju.

Bitna izvedba

1. Za napredni visokofrekventni radijski izlaz energije, sustav mora osigurati da odstupanje nazivne izlazne snage ne prelazi 20 % standardne vrijednosti

2. Za osnovnu visokofrekventnu izlaznu radio energiju, sustav mora osigurati da odstupanje nazivne izlazne snage ne prelazi 20 % standardne vrijednosti

Smjernice i izvjava PROIZVOĐAČA - ELEKTROMAGNETSKA EMISIJA		
Uređaj je namijenjen za korištenje u elektromagnetskom okruženju navedenom kako slijedi. Kupac ili korisnik Uređaj a trebao bi osigurati da se koristi u takvom okruženju.		
Ispitivanje emisija	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje - smjernice
RF emisije CISPR 11	Grupa 1	Uređaj koristi RF energiju samo za svoju unutarnju funkciju. Stoga su njegove RF emisije vrlo niske i vjerojatno neće uzrokovati smetnje u obližnjoj elektroničkoj opremi.
RF emisije	Klasa A	Karakteristike EMISIJE ove opreme čine je prikladnom za upotrebu u industrijskim područjima i bolnicama
Harmonijska struja IEC 61000-3-2	Klasa A	
Promjene napona/Fluktuacije napona/treperenje IEC 61000-3-3	Sukladno	

Smjernice i izvjava proizvođača - elektromagnetska otpornost

Uređaj je namijenjen za korištenje u elektromagnetskom okruženju Specificirano kako slijedi.

Kupac ili korisnik uređaja trebao bi osigurati da se uređaj koristi u takvom okruženju

Test IMUNITETA	IEC 60601 ispitna razina	Razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje - smjernice
Elektrostatički pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV zrak	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV zrak	Podovi trebaju biti drveni, betonski ili keramičke pločice. Ako su podovi prekriveni sintetičkim materijalom, Relativna vlažnost mora biti najmanje 30 %.
Brzi električni prijelaz/prasak IEC 61000-4-4	± 2 kV za vodove napajanja ± 1 kV za ulazno/izlazne vodove	± 2 kV za vodove napajanja ± 1 kV za ulazno/izlazne vodove	Kvaliteta mrežnog napajanja trebala bi biti tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Udar IEC 61000-4-5	± 1 kV vod(ovi) do voda(a) ± 2 kV vod(ovi) prema zemlji	± 1 kV vod(ovi) do voda(a) ± 2 kV vod (s) prema zemlji	Kvaliteta mrežnog napajanja trebala bi biti tipična komercijalna ili bolnička okolina.
Padovi napona, kratki prekidi na ulaznim vodovima napajanja IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciklusa na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0 % UT; 1 ciklus i 70 % UT; 25/30 ciklusa Jednofazni: na 0° 0 % UT; 250/300 ciklus	0 % UT; 0,5 ciklusa na 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0 % UT; 1 ciklus i 70 % UT; 25/30 ciklusa Jednofazni: na 0° 0 % UT; 250/300 ciklus	Kvaliteta mrežnog napajanja trebala bi biti tipična komercijalna ili bolnička okolina. Ako korisnik ultrazvučnog kirurškog Oprema zahtjeva kontinuirani rad tijekom prekida napajanja, preporučuje se ultrazvučni kirurški Oprema se napaja iz neprekidnog izvora napajanja ili baterije.
Frekvencija snage (50/60 Hz) Magnetsko polje IEC 61000-4-8	30 A/min	30 A/min	Magnetska frekvencija snage polja trebaju biti na karakterističnoj razini. Tipične lokacije u tipičnom poslovnom ili bolničkom okruženju.

Smjernice i izvjava proizvođača - elektromagnetska otpornost

Uređaj je namijenjen za primjenu u elektromagnetskom okruženju navedenom kako slijedi.

Kupac ili korisnik uređaja trebao bi osigurati da se koristi u takvom okruženju

IMUNITET test	IEC 60601 test razini	Usklađenost razini	Elektromagnetska sredina- usmjerenje
Proveden RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz 6 V u ISM pojasevima između 0,15 MHz i 80 MHz	3V	Prijenosne i mobilne RF komunikacije Oprema ne smije koristiti bliže bilo kojem dijelu uređaja , uključujući kabele, od preporučene udaljenosti izračunate iz jednadžbe za frekvenciju odašiljača. Preporučena udaljenost razdvajanja
Zračenje RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,7 GHz 80 % AM na 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ <p>gdje je P najveća nazivna izlazna snaga</p>

			<p>odašiljača u vatima (W) prema proizvođaču odašiljača, a d je preporučena udaljenost u metrima (m).</p> <p>Snage polja fiksnih RF odašiljača, kako je utvrđeno ispitivanjem elektromagnetske lokacije,3, trebale bi biti manje od razine usklađenosti u svakom frekvencijskom rasponu.</p> <p>Smetnje se mogu pojaviti u blizini opreme označene sljedećim simbolom:</p>  <p>PRIKLJUČAK KUČIŠTA ME OPREME I ME SUSTAVA ispitat će se kako je navedeno u tablici 9 norme IEC 60601-1-2 korištenjem metoda ispitivanja navedenih u normi IEC 61000-4-3.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preporučene udaljenosti razdvajanja između prijenosne i mobilne RF komunikacijske opreme i uređaja.

Ultrazvučna oprema za kirurgiju ima za cilj primjenu u elektromagnetskom okruženju u kojem su RF smetnje kontrolirane. Kupac ili korisnik uređaja može spriječiti elektromagnetske smetnje održavanjem minimalne udaljenosti između prijenosne i mobilne RF komunikacijske opreme (odašiljača) i uređaja prema sljedećoj preporuci, u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna najveća izlazna snaga odašiljača (w)	Razmak prema frekvenciji odašiljača /m		
	150 kHz do 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{v1}} \right] \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{E1}} \right] \sqrt{P}$	800 MHz do 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{\sqrt{E1}} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,36999	0,36999	0,73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3,69986	3,69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

NAPOMENA: Ove se smjernice možda neće primijeniti u svim situacijama. Na širenje elektromagnetskog zračenja utječe apsorpcija i refleksija od struktura, objekata i ljudi.

Tehnički uvjeti

Komponente potrebne za rad sustava: Elektrokirurški instrument , Transductor , Ultrazvučni nožni prekidač, Elektrokirurški nožni prekidač, Ultrazvučni škare ili Elektrokirurški nasadnici , Bipolarni instrument za elektrokirurgiju s bipolarnim konektorom.


Za ovu komponentu pogledajte opis proizvoda.

Stupanj zaštite od strujnog udara	Ultrazvuk:  Tip CF primijenjeni dio; Bipolarni elektrokirurški  primijenjeni dio otporan na defibrilaciju tipa CF
Stupanj zaštite od strujnog udara	klasa I
Generator do štetnih infuzija	Normalna oprema
Stupanj zaštite od štetnog prodora vode	Nožni prekidač: IP68
Kategorija upravljanja	Razred IIb
Zahtjevi za parametre ultrazvučnog načina rada:	
Ulazna snaga	Napon napajanja: 100-240V Frekvencija napajanja: 50Hz/60Hz Ulazna snaga: 400VA
Zahtjevi za parametre ultrazvučnog načina rada:	
Frekvencija uzbude	54 kHz - 57 kHz
Vibracijski izlet primarnog vrha	25 μm ~ 110 μm
Ultrazvučni škare glavna akustična izlazna površina vrha Proizvod:	1,53-2,75 mm ²
Sekundarna unakrsna vezana akustika na Ultrazvučni škare Savjet Izlazno područje:	19,32-35,88 mm ²
Izvedeni izlazni zvuk na Ultrazvučni škare vrhu na referentnom vrhu Primarna snaga amplitude	< 30 W
Vrsta upravljanja frekvencijom sustava	Neovisno o opterećenju, frekvencija pobude se automatski kontinuirano podešava.
Indeks rezerve snage	Ne manje od 2,5
Zahtjevi za elektrokirurške parametre:	
Radna frekvencija	400 KHz ± 5%
Maksimalni izlazni napon	≤ 250V
Napredni bipolarni način Maksimalna izlazna struja	≤ 5,5 A
Osnovni bipolarni način Maksimalna izlazna struja	≤ 2,2 A
Maksimalni izlazni napon od vrha do vrha	≤ 500Vpk
Vršni faktor	1,6 ± 0,4
Nazivna snaga	Radiofrekvencijski napredni bipolarni: 270 W Radiofrekvencija Basic bipolar: 95W
Nazivno opterećenje	Radiofrekvencijski napredni bipolarni: 30Ω Radiofrekvencija Osnovni bipolarni: 200Ω
Uvjeti radnog okruženja	Temperatura: 10°C do 30°C
	Relativna vlažnost: ≤ 70%
	Raspon atmosferskog tlaka: 800 hPa do 1060 hPa

Uvjeti prijevoza i skladištenja	Temperatura: -30 °C do +55 °C (Generator, nožni prekidač, adapter) Temperatura: -10 °C do +55 °C (Ultrazvučni škare)
	Vlažnost: ≤ 80%
	Raspon atmosferskog tlaka: 800 hPa do 1060 hPa
Datum proizvodnje	Datum proizvodnje može se odrediti prema serijskom broju na stražnjoj ploči Generator.
Kabel za napajanje	Usklađenost sa zahtjevima CCC certifikacije Strujna snaga: 10A
Stopa postojanosti	Određeno Transductor ručnim dijelom i Ultrazvučni škare korištenim. Za informacije o stopi postojanosti, pogledajte primjenjive Ultrazvučni škare i Transductor Upute za nasadnik ili Poglavlje 7 – Upozorenja i mjere opreza.
Osigurač	e5 * 20 T8AH250V
Težina (bez pakiranja)	Generator: nominalno 8 kg
Ukupni volumen	OP9 Generator: (duljina * širina * visina): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispozicija	Neke unutarnje komponente Generator, nožni prekidač i kabel nožnog prekidača sadrže olovo. Prema lokalnim Zahtjevi i propisi za odlaganje. Baterije odložite u skladu s odgovarajućim praksama zbrinjavanja otpada.
AP/APG klasifikacija	Nije AP/APG oprema.
Vijek trajanja:	Vijek trajanja: 7 godina
Verzija izdanja softvera	V01.01

Bipolarni izlazni valni oblik


Napredna bipolarna izlazna krivulja snaga- opterećenje

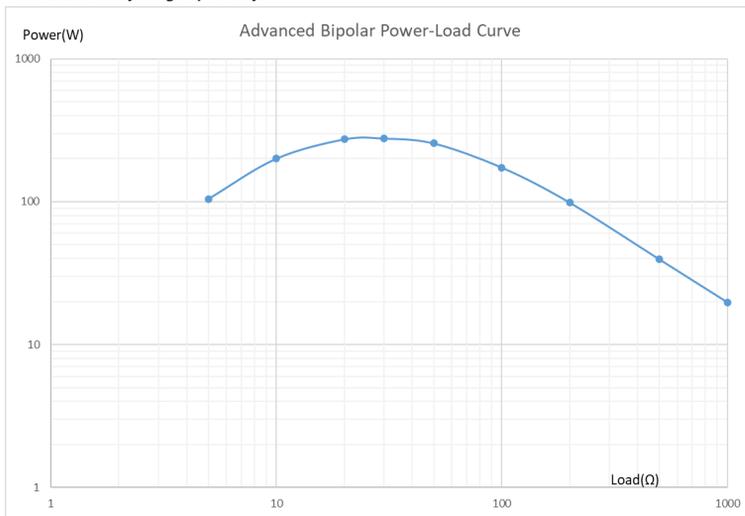

OGRANIČENJE KRIVULJE SNAGE Max Izlazna snaga : 270 [W]			
Opterećenje (Ω)	Donja granica	Nominalni	Gornja granica
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Krivulja nominalne snage od 270 W izlaza pri nazivnom opterećenju u skladu s ograničenjem struje/napona mjerča krivulje snage. Krivulja snage predstavlja omotnicu koja varira ovisno o radnim uvjetima.


Osnovni bipolarni izlaz puna krivulja snaga- opterećenje

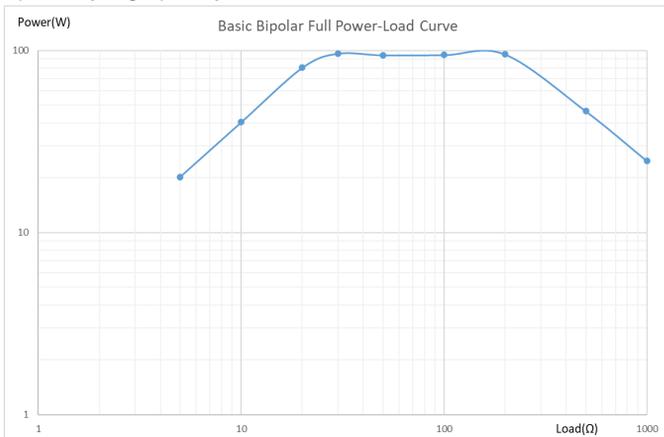

Ograničenje pune krivulje snage [W]: Maksimalna snaga 95 W

Opterećenje (Ω)	Donja granica	Nominalni	Gornja granica
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Osnovna bipolarna izlazna krivulja pola snage i opterećenja

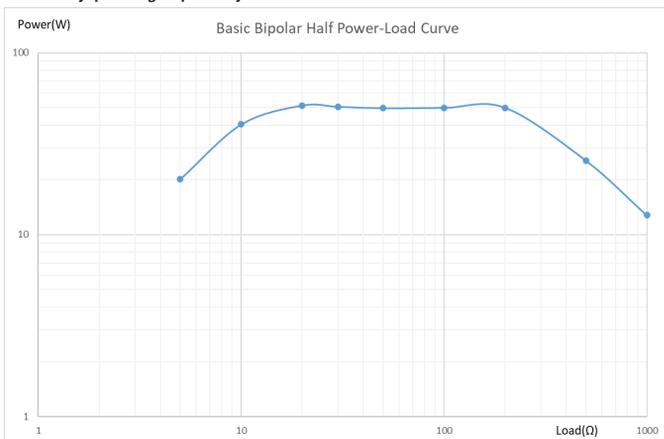

Ograničenje polovične krivulje snage [W]: maksimalna snaga 50 W

Opterećenje (Ω)	Donja granica	Nominalni	Gornja granica
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Izlazna snaga u odnosu na postavke snage za napajanje u normalnom bipolarnom stanju

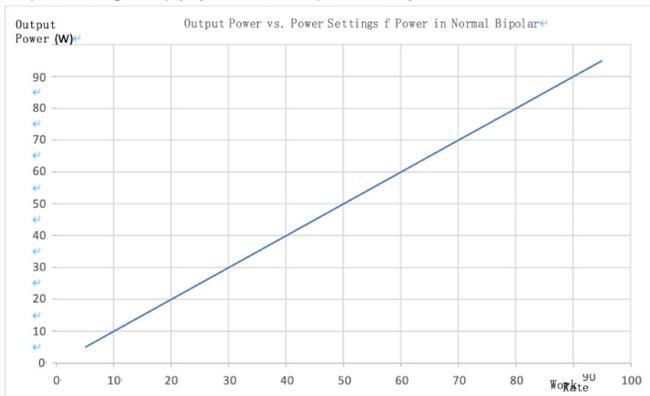

Izlazna snaga u odnosu na zadanu vrijednost snage za normalni bipolarni (W); Opterećenje: 200Ω			
Postavite snagu (W)	Donja granica izlazne snage (W)	Nazivna snaga (W)	Gornja granica izlazne snage (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Servis i jamstvo

Reach Surgical, Inc. jamči da ovaj proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi pod normalnom uporabom i preventivnim održavanjem tijekom jamstvenog razdoblja navedenog u nastavku. Obveza tvrtke Reach Surgical prema ovom jamstvu ograničena je na popravak ili zamjenu, po vlastitom nahođenju, bilo kojeg neispravnog proizvoda ili dijela koji je vraćen tvrtki Reach Surgical, Inc. ili njegovom ovlaštenom distributeru unutar primjenjivog jamstvenog roka i za koji je utvrđeno da je neispravan tvrtki Reach Surgical, Inc. zadovoljstvo. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode ili dijelove koji su:

- Štetno utječe zbog upotrebe s neovlaštenim uređajima koje proizvode ili distribuiraju strane koje nije ovlastio Reach Surgical, Inc.
- Popravljeno ili preinačeno izvan Reach Surgical-a tvornici, ako to utječe na stabilnost ili pouzdanost uređaja kako je utvrdio Reach Surgical.
- Izloženo nepravilnoj uporabi, nemaru ili nezgodi.
- Koristi se na način koji nije u skladu s dizajnom, parametrima uporabe, uputama i smjernicama za proizvod ili s industrijski prihvaćenim funkcionalnim, operativnim ili ekološkim standardima za slične proizvode.

Jamstveni rokovi

Osnovni bipolarni energetski konektor (OP-BPC): 1 godina za komponente i rad.

Generator (OP9): 1 godina za komponente i rad.

Nožni prekidač/kabel za napajanje: 1 godina za komponente i rad.

Ovo jamstvo je isključivi pravni lijek za prvobitnog kupca i zamjenjuje sva druga jamstva, izričita ili prešutna, uključujući jamstva o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu. Reach Surgical, Inc. neće biti odgovoran ni za kakvu posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, uključujući štetu koja proizlazi iz gubitka korištenja, dobiti, poslovanja ili dobre volje, osim kako je izričito određeno primjenjivim zakonom.

Reach Surgical, Inc. ne ovlašćuje nijednu osobu da preuzme bilo kakvu dodatnu odgovornost u vezi s prodajom ili korištenjem svojih proizvoda. Ne postoje jamstva koja se protežu izvan ovdje navedenih uvjeta.

Reach Surgical, Inc. zadržava pravo izmjene svojih proizvoda bez obveze retroaktivne primjene tih promjena na prethodno prodane ili izgrađene proizvode.

Áttekintés

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat. Fontos utasításokat tartalmaz a megfelelő működésre, a lehetséges kockázatokra és a termék vagy személyek esetleges károsodására vonatkozóan. Bármilyen rendellenes helyzet esetén kövesse a megadott utasításokat, hogy elkerülje saját maga vagy a berendezés károsodását. Az utasítások be nem tartása a biztonság, a teljesítmény, a garancia vagy a karbantartás sérülését eredményezheti, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget. Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a Energia-átalakítója és Ultrahangos olló készülékre vonatkozó utasításokat is.

Ez a dokumentum a készülék használatához nyújt segítséget. Nem a műtéti technikák referenciája.

Szabványos konvenciók: Vigyázat, FIGYELMEZTETÉS és Megjegyzés kijelentések

Kérjük, vegye figyelembe a következő, VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS vagy MEGJEGYZÉS kategóriába sorolt kijelentéseket, amelyek alapvető útmutatást nyújtanak a feladatok biztonságos és alapos elvégzéséhez. Ezek a kijelentések az egész dokumentációban megtalálhatók, és el kell olvasni őket, mielőtt az eljárás következő lépésére lépne.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a kijelentés olyan üzemeltetési vagy karbantartási eljárást, gyakorlatot vagy állapotot emel ki, amelynek nem pontos betartása személyi sérüléshez vagy életveszélyhez vezethet.

VIGYÁZAT: Ez a figyelmeztetés egy potenciálisan veszélyes helyzetre hívja fel a felhasználó figyelmét, amely elkerülése esetén a felhasználó vagy a beteg kisebb vagy közepes mértékű sérülése, valamint a berendezés vagy más vagyontárgyak károsodása következhet be. Ez a figyelmeztetés a nem biztonságos gyakorlatok elleni figyelmeztetésként is szolgálhat. Tartalmazza a műszer biztonságos és hatékony használatához szükséges óvintézkedéseket, valamint a helyes vagy helytelen használatból eredő károk megelőzéséhez szükséges gondosságot.

MEGJEGYZÉS: Ez a kijelentés olyan működési gyakorlatot vagy feltételt jelöl, amely elengedhetetlen a feladat hatékony végrehajtásához.

Leírás

Az ENER REACH elektrosebészeti műszert (a továbbiakban: a készülék) az orvosi műtőkben sebészeti beavatkozásokhoz használják emberi szövetek vágására, koagulálására és erek lekötésére. Két külön nyílással rendelkezik: az egyik az ultrahangos energia, a másik a rádiófrekvenciás hullámforma kimenetéhez.

Rádiófrekvenciás üzemmódban a Generátora a csatlakoztatott műszertől/elektroszkópiai eszköztől függően különböző energiasémákat szolgáltat. Ha egy fejlett bipoláris műszer van csatlakoztatva, a Generátora rádiófrekvenciás hullámformákat szolgáltat az artériás és vénás erek, nyirokcsomók és szövetkötetek lezárásához 7 mm átmérőig. Alap bipoláris műszer csatlakoztatásakor állandó teljesítményű energia kerül kibocsátásra lágy szövetek vágásához és koagulációhoz.

Ultrahangos energia kimeneti üzemmódban, a TRA6 Energia-átalakítója és a Egyszer használatos ultrahangos vágóeszközök CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD kombinációjával a készülék vérzéscsillapítást és minimális hőkárosodást igénylő lágy szöveteket vág, és legfeljebb 5 mm átmérőjű ereket zár le. A Eldobható ultrahangos olló SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 és SRE45 készülékkel összekapcsolva a készülék vérzéscsillapítást és minimális hőkárosodást igénylő lágy szöveteket vág, és maximum 7 mm átmérőjű ereket zár le.

Rendeltésszerű használat

A készülék rádiófrekvenciás energiát biztosít az elektrosebészeti kézidarabok meghajtásához, amelyeket az erek vágására és lezárására, valamint a szövetek vágására, megragadására és boncolására használnak.

Ezenkívül a Generátora ultrahangos teljesítményt biztosít az ultrahangos sebészeti eszközök meghajtásához, amelyek lágy szöveti bemetszésekhez javasoltak, amikor a vérzéscsillapítás és a minimális hősrülés a kívánatos.

Jelzések

A készülék rádiófrekvenciás energiát biztosít az elektrosebészeti kézidarabok meghajtásához, amelyeket nyitott műtétek vagy laparoszkópos műtétek során használnak az általános, gyermekgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai és mellkassebészeti műtétek során az erek elvágására és lezárására legfeljebb 7 mm-ig, valamint szövetek vágására, megfogására és boncolására.

Ezenkívül a Generátora áramot biztosít az ultrahangos sebészeti műszerek meghajtásához, amelyek lágy szöveti bemetszésekhez javasoltak, amikor a vérzéscsillapítás és a minimális hősrülés a kívánatos. Az ultrahangos sebészeti műszerek az elektrosebészet, a lézer és az acélszike kiegészítőjeként vagy helyettesítőjeként használhatók a szövetek vágására és/vagy koagulálására nyitott műtéteknél vagy laparoszkópos műtéteknél általános, gyermekgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, mellkasi, valamint a nyirokerek lezárására és átvágására.

Rendeltésszerű felhasználó

A készüléket egészségügyi szakemberek általi sebészeti alkalmazásra szánják.

Rendeltésszerű használat Környezet

A készüléket kórházi használatra szánják.

Tervezett betegpopuláció

Ez az eszköz alkalmas 3 éves és idősebb betegek számára, akiknél lágy szöveti bemetszésekkel járó, vérzéscsillapítással és minimális hősrúléssel járó sebészeti beavatkozásokra van szükség.


Klinikai előny

Az eszköz biztonságosan és hatékonyan használható az erek, szövetkötetek és nyirokerek lekötésére és szétválasztására.

Ellenjavallatok

Ez az eszköz ellenjavallt csontmetszések, fogamzásgátló petevezeték elzárása és vérárvadási eljárások esetén. Idegsebészeti beavatkozásoknál történő használatra szintén nem ajánlott.

A rendszer összetétele

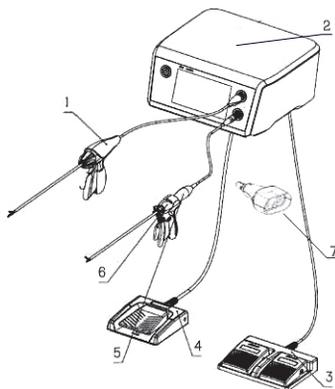

[01] Elektrosebészeti kézídarabok	[02] OP9 Generátora
[03] Ultrahangos lábkapcsoló	[04] Elektrosebészeti lábkapcsoló
[05] Energia-átalakítója	[06] Ultrahangos olló
[07] Elektrosebészeti bipoláris átalakító	

[01] Elektrosebészeti kézíszerszám

Az elektrosebészeti kézíszerszámot, amely egy Generátora-es készülékhez van csatlakoztatva, a sebész kezeli az eljárás során. RF elektrosebészeti energiát alkalmaz a szövetre a Pofák között, hogy koaguláljon vagy lezárjon. A műszer tartalmaz egy pengét is a szövetek felosztásához. Modell: OSA23, OSA37, OSA44. Részletes információkért olvassa el a használati utasítást.

[02] OP9 Generátora

A Generátora mind az elektrosebészeti energiát, mind az ultrahangos terápiás energiát külön műszercsatlakozó portokon keresztül biztosítja. A készülék vázból, burkolatból, elektronikai lapból, LCD érintőképernyőből, hálózati kapcsolóból és a tartozékok csatlakoztatásához szükséges interfészekből áll.

Modell: OP9

[03] Ultrahangos lábkapcsoló

Az ultrahangos energia be- és kikapcsolásának vezérlésére szolgál két kapcsolóval ("MIN" és "MAX"). Modell: OP-FSD

[04] Elektrosebészeti lábkapcsoló

A nagyfrekvenciás energia be- és kikapcsolásának vezérlésére szolgál egyetlen kapcsolóval.

Modell: OP-FSS

[05] Energia-átalakítója

A Energia-átalakítója a kompatibilis Generátora elektromos energiát alakítja át a műszerlapátok mechanikus mozgására. Ez egy korlátozott élettartamú, újrafelhasználható eszköz. A Energia-átalakítója nem steril, és használat előtt az utasításoknak megfelelően sterilizálni kell. Részletes információkért olvassa el a TRA6 Energia-átalakítója használati utasítását.

Modell: TRAG.

[06] Ultrahangos olló

A Ultrahangos olló a Energia-átalakítója mechanikus mozgását használja, és ultrahangos energiát szolgáltat a szövetek vágásához vagy koagulációjához. Óvatosan kell eljárni, mivel a mechanikus rezgés nem érzékelhető, és véletlenül hatással lehet a nem célzott területekre. A Ultrahangos olló-et etilén-oxiddal sterilizálják. Ha az eltarthatósági időt túllépi, vagy a sterilizációsomogolás megsérül, a Ultrahangos olló nem használható fel, és meg kell semmisíteni. Részletes információkért olvassa el a Ultrahangos olló használati utasítását.

A következő Ultrahangos olló kompatibilis az OP9 Generátora-lyel:

PD sorozat: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB sorozat: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE sorozat: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektrosebészeti bipoláris csatlakozó

A Elektrosebészeti műszerek-es bipoláris alapkészülék és a Generátora-es szövetkoagulációs készülék összekapcsolására szolgál.

Modell: OP-BPC

Generátora Előlap

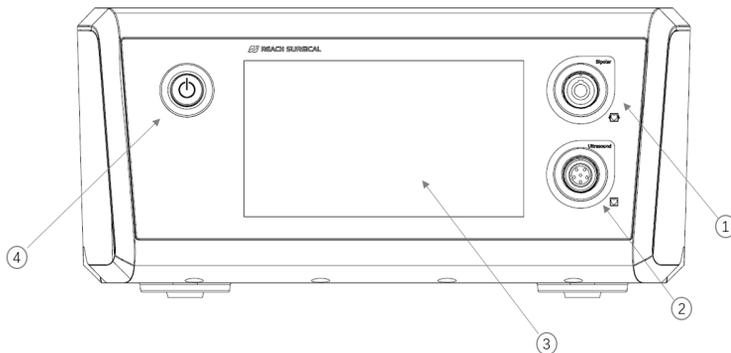

[01] Elektrosebészeti aljzat

A fejtett bipoláris Elektrosebészeti műszerek vagy elektrosebészeti bipoláris csatlakozó csatlakoztatására szolgál.

[02] Energia-átalakítója aljzat

A Energia-átalakítója-et a Generátora-hez csatlakoztatja.


[03] LCD érintőképernyő

Megjeleníti a rendszerinformációkat, és a kezelőszervek és beállítások beállításának felületéért szolgál.

[04] Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a Generátora bekapcsolásához; nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz.

Generátora Hátsó panel

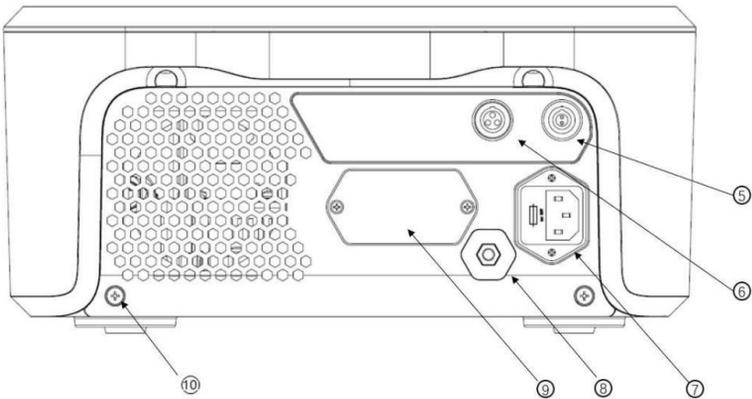

[05] Elektrosebészeti lábkapcsoló aljzat

Kerek aljzat az elektrosebészeti lábkapcsoló csatlakoztatásához.

[06] Ultrahangos lábkapcsoló aljzat

Kerek aljzat az ultrahangos lábkapcsoló csatlakoztatásához.

[07] Elektromos aljzat

Csatlakoztatja a tápkábelt a Generátora készülékhez.

[08] Potenciális kiegyenlítő port

Ha a hálózati aljzat földelése bizonytalan, ez a csatlakozó lehetővé teszi a védett földeléshez való csatlakozást.

[09] Bővítési interfész

Funkcióöbvtésre és karbantartásra szolgál.

[10] Szerelőlyuk

Használati utasítás

A működési környezetre vonatkozóan olvassa el a mellékelt útmutatókat.

Kicsomagolás

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat az alkatrészek átvételkor.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések. Ha bármilyen sérülést talál, kérjük, forduljon a Reach Surgical, Inc.-hez vagy a helyi ügynökhöz segítségért.

A (A részletes műszaki specifikációkat és a termékkódokat lásd a "Rendszer műszaki feltételei" című fejezetben):

Modell	Leírás	Komponens
OP9	Generátora	Generátora, tápkábel, használati utasítás
TRA6	Energia-átalakítója	Energia-átalakítója kábellel
OP-FSD	Ultrahangos lábkapcsoló	/
OP-FSS	Bipoláris lábkapcsoló	/
OP-BPC	Alapvető bipoláris energiacsatlakozó	/

Biztonsági óvintézkedések

- A berendezés ellenőrzése során a sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a műszer disztális végét más készülékektől, sebészeti kendőktől, a betegtől vagy más tárgyaktól.
- Gőzök jelenlétében a szükséges biztonsági intézkedések végrehajtása a kórházi eljárások és előírások betartásával.

Ultrahangos energia PD sorozat Ultrahangos olló

- Csatlakoztassa a Energia-átalakítója-et, a lábkapcsolót és a Ultrahangos olló-as PD-sorozatot a Generátora-hez.
- A Energia-átalakítója és Ultrahangos olló tesztek sikeres elvégzése után állítsa be a teljesítményszintet (1-5) az LCD-képernyőn lévő +/- ikonok segítségével.
- Nyomja meg a "Min" gombot a Ultrahangos olló-on vagy a Min pedált a lábkapcsolón, hogy az ultrahangos energiát az előre beállított teljesítményszinten aktiválja.
- Nyomja meg a "Max" gombot a Ultrahangos olló-on vagy a Min pedált a lábkapcsolón a maximális energiaszint leadásához.
- A kulcs vagy a lábkapcsoló elengedésével állítsa le az energia kimenetet.

Ultrahangos energia az SRB/SRE sorozat Ultrahangos olló-es sorozatával

- A Energia-átalakítója és Ultrahangos olló tesztek sikeres elvégzése után állítsa be a teljesítményszintet (1-5) az LCD-képernyőn lévő +/- ikonok segítségével.
- Nyomja meg a Energialeadó gomb gombot a műszeren vagy a Min gombot a lábpedálón az ultrahangos energia aktiválásához az előre beállított

teljesítményszinten.

- Nyomja meg a Energialeadó gomb Továbbfejlesztett vérzéscsillapítás funkcióval gombot a műszeren a fejlett vérzéscsillapítás üzemmód aktiválásához.
- Az energiellátás leállításához engedje el a Ultrahangos olló vagy a Lábpedálja gombját.

Elektrosebészeti bipoláris energia a fejlett bipoláris műszerekkel.

- Az LCD-kijelzőn a fejlett bipoláris ikon és az állítható kézi vezérlés ikonja jelenik meg.
- A rádiófrekvencia aktiválásához húzza meg a Kar-os gombot a műszeren, vagy nyomja meg a lábkapcsoló pedált.
- A Generátora leállítja az energiakibocsátást, amikor a lezárás befejeződik, amit a képernyőn a befejezett ikon jelez.
- Ha a ligálás nem teljes, figyelmeztető hangjelzés hallható, és egy figyelmeztető ikon jelenik meg.

Elektrosebészeti bipoláris energia bipoláris elektrosebészeti eszközzel

- Az LCD-képernyőn megjelenik a teljesítményérték, az állítható ikonok és a teljesítményszint sávok.
- A teljesítménybeállítások 1-95 watt között mozognak, állítható fokozatban.
- Válassza ki a kívánt kimeneti teljesítménybeállítást: Alacsony (15 watt), Közepes (30 watt) vagy Magas (60 watt).
- A rádiófrekvencia aktiválásához nyomja meg a gombot a kézi kapcsolón vagy a lábkapcsoló pedálon.
- A gomb felengedésével kikapcsolhatja az energiakibocsátást.

Ajánlások beállítása

Hatás beállítások	Teljesítménybeállítások tartománya	Klinikai alkalmazás	Optimalizált eszköz
Alacsony	1-15 watt	Mint például idegek/gerinc, kéz és arcsebészet	- Kisebb felületű eszközök - Mikrocsipesz (0,4-2,2 mm)
Mid	16-40 watt	Mint például a fej/nyak, a gerinc és az anatómia során végzett koaguláció.	- Közepes felületű eszközök - Mikrocsipesz (1,0-2,2 mm) - Kis lapos fejű laparoszkópos csipeszek - Bipoláris olló
Magas	45-95 watt (5 wattos lépésekben)	Például fej/nyak és plasztikai sebészet (a közepes hatáshoz hasonló, de gyorsabb hatású).	- Nagy felületű eszközök - Nagy laposfejű laparoszkópos csipeszek

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék nem kompatibilis a semleges elektródával.

MEGJEGYZÉS: A Ultrahangos olló és az RF elektromos szike a beteggel érintkező alkatrészek.


A Generátora használata

Kapcsolja be a készüléket

- A rendszer bekapcsolás után üzemkész. Amikor a Generátora csatlakoztatva van a hálózati tápellátáshoz és a készenléti kapcsoló fénye világít, a rendszer üzemkész.
- A készenléti gomb megnyomása után a következő kép jelenik meg:




- Ha nincs Energia-átalakítója vagy Ultrahangos olló csatlakoztatva a Generátora-hez, vagy ha rosszul vannak csatlakoztatva, a következő kép jelenik meg:




Ultrahangos műszer használata (Energia-átalakítója és Ultrahangos olló)


A Energia-átalakítója és Ultrahangos olló érzékelésekor a következő kép jelenik meg.

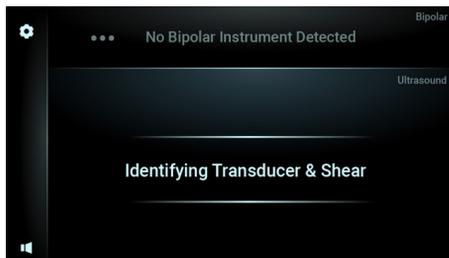


MEGJEGYZÉS: ha a Energia-átalakítója hátralévő felhasználási ideje kevesebb, mint 10, a következő kép jelenik meg. Kérjük, figyeljen a hátralévő felhasználások számára, mivel a Energia-átalakítója-et ki kell cserélni, ha a szám nulla lett.

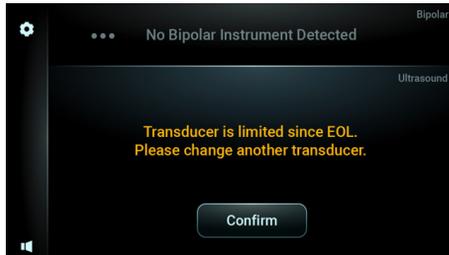


Ezután a következő kép jelenik meg, és megkérjük, hogy nyomja meg a Ultrahangos olló bármelyik gombját a Ultrahangos olló teszt elindításához a nyitott Pofák-vel.

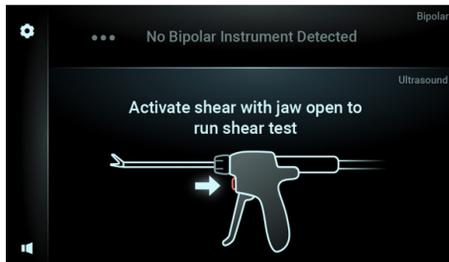

Nyomja meg a Bármelyik gombot, és a következő kép jelenik meg.

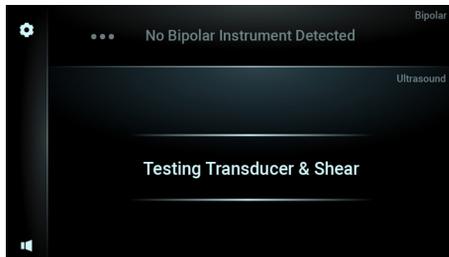


Ha a Energia-átalakítója-es teszt sikertelen, a következő kép jelenik meg:

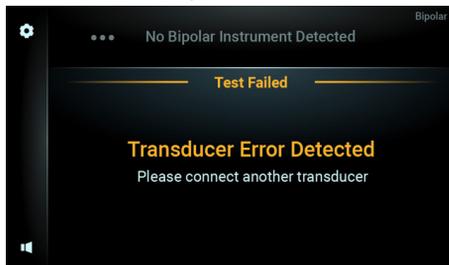


Ha a Ultrahangos olló-as teszt sikertelen, a következő kép jelenik meg



Ha a Energia-átalakítója és Ultrahangos olló teszt sikerül, a következő kép jelenik meg:

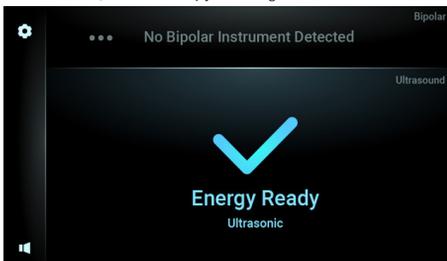

A következő munkaképernyő jelenik meg, ha a Ultrahangos olló készüléket Advanced Hemostasis funkció nélkül csatlakoztatja.

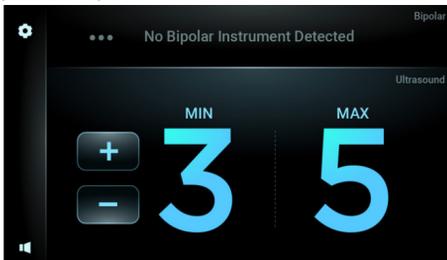


Az SRE Ultrahangos olló és az Advanced Hemostasis összekapcsolásakor a következő munkaképernyő jelenik meg.




A kimeneti üzemmódot kiemeli, hogy aktívva van.

Elektrosebészeti eszköz használata


A Energia-átalakítója és Ultrahangos olló érzékelések a következő kép jelenik meg.

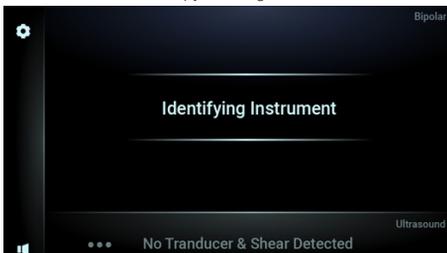

Ha az elektrosebészeti eszköz tesztje sikeres, a következő kép jelenik meg:

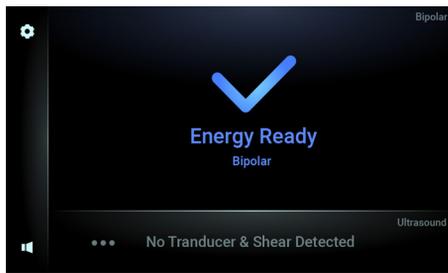

A következő munkaképernyő jelenik meg, amikor csatlakozik a fejlett bipoláris műszerhez.

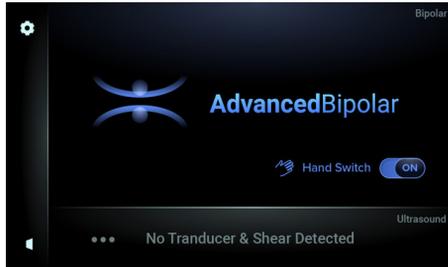

A következő munkaképernyő jelenik meg, amikor csatlakozik a normál bipoláris műszerhez.




Elektrosebészeti eszköz és Ultrahangos olló használata

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a Generátora bipoláris elektrosebészeti műszerhez és Ultrahangos olló-as műszerhez is csatlakoztatva van, a rendszer osztott képernyős üzemmódban működik az aktuális állapot megjelenítésére. Az elsőbbséget élvező eszköz lesz az első, amelyik aktiválja az energiát. Ez az osztott képernyős állapot az alábbiakban látható:



Rendszerbeállítások


A rendszerbeállítások eléréséhez kattintson a képernyő bal felső sarkában található beállítások ikonra. A következő rendszerbeállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

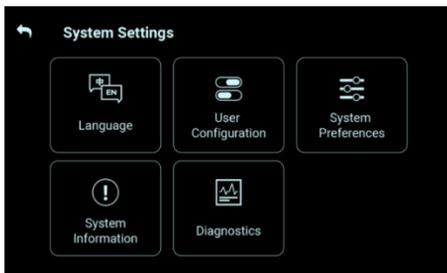


Nyelv: A Nyelv elemre kattintva megjelenik a nyelvválasztó képernyő:




Felhasználói konfiguráció: A Felhasználói konfiguráció elemre kattintva megjelenik a felhasználói konfigurációs képernyő:

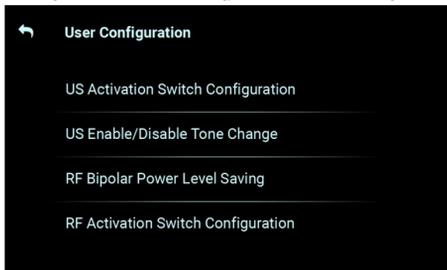

Rendszerbeállítások: A Rendszerbeállítások elemre kattintva megjelenik a rendszerbeállítások képernyője:



Rendszerinformáció: A rendszerinformációs képernyő megjelenítéséhez kattintson óvatosan a Rendszerinfo elemre:

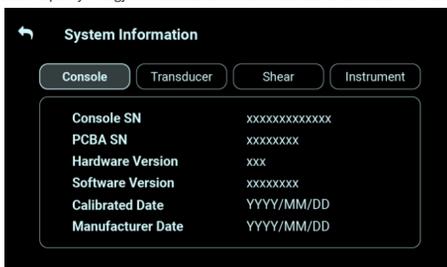

Diagnosztika: A Diagnosztika elemre kattintva megjelenik a diagnosztikai képernyő:



A rendszerbeállításokból való kilépéshez és a rendszer készenléti üzemmódjába való visszatéréshez nyomja meg a képernyő bal felső sarkában található "Vissza" ikont.

A rendszer leállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a rendszer biztonságos leállításához:

Nyomja meg a készenléti gombot: Keresse meg a Készenléti gombot a Generátora készüléken, és nyomja meg a kikapcsolási folyamat elindításához.

Válassza le a Energia-átalakítója és a Ultrahangos olló csatlakozót: Óvatosan válassza le a Energia-átalakítója és a Ultrahangos olló egységet a rendszerről. A Energia-átalakítója és a Ultrahangos olló megfelelő kezeléséhez olvassa el a kezelési útmutatót.

Tisztítás: A Generátora, a lábkapcsoló és a Energia-átalakítója tisztítása a "Karbantartás" fejezetben leírtak szerint.

Hibaelhárítás

A Generátora különböző figyelmeztető jelzésekkel és hibakódokkal segíti az alkatrészhibák azonosítását és diagnosztizálását. Fontos megjegyezni, hogy ezek a jelzések és kódok a klinikai itéletalkotás és megfigyelés támogatására szolgálnak, nem pedig azok helyettesítésére.

Hangjelzés

Munkaállapot	Hang típus	Lehetséges ok és intézkedés
Önellenzés állapota	Normál hang	/
	Rendellenes hang	Hardverhibát észleltek. Kérjük, forduljon a gyártóhoz a javítási segítségért.
Ultrahangos eszköz használata	Maximális hangszint	/
	Min szint hang	/
	Rendellenes hang	A Ultrahangos olló-as készülék túlzottan nagy mennyiségű szövetet érintkezett. Csökkentse a szövetekkel való érintkezést a Ultrahangos olló-mal. Ha a folyamatos hang továbbra is fennáll, óvatosan távolítsa el a Ultrahangos olló vége körül felgyülemlt szövetet. A Energia-átalakítója és/vagy Ultrahangos olló készülékkel kapcsolatban hibát észleltek. Kérjük, forduljon a gyártóhoz, vagy további segítségért forduljon az ügyfélszolgálatához.
	FELEPÍTETT hang	/
	ITS hang	/
Aktíváló elektrosebészeti eszköz	Fejlett bipoláris figyelmeztető hang	/
	Normál kétpólusú hang	/
	Rendellenes hang	Sikertelen vágás: Ha a műszerrel érintkező szövet nem felel meg a vágási követelményeknek, csökkentse a műszerrel érintkező szövet mennyiségét. Ha a hibahang továbbra is fennáll, óvatosan távolítsa el a műszer végén felgyülemlt szövetet. Hardverhiba: Ez a hiba az áramkör vagy a csatlakozó esetleges meghibásodását jelzi. Bármilyen hiba vagy hiba esetén ajánlott a gyártóval konzultálni, vagy megfelelő útmutatásért és megoldásért támogatást kérni.


Hibakódok

Az Energy Platform Generátora átfogó hibaaazonosító rendszerrel van felszerelve, amely riasztásokból és rendszerhibákból áll. Hiba észlelésekor a Generátora figyelmeztető hangjelzést ad, figyelmeztető jelzést jelenít meg a vezérlőpanelen, és a megfelelő hibakódot mutatja az LCD-képernyőn. A hiba elhárításához kövesse az alábbiakban ismertetett lépéseket:

Hibakódok táblázat

Hibakód	Megfelelő hibaüzenet
Figyelmeztetés	A Ultrahangos olló és a Energia-átalakítója helyes összekapcsolása
Figyelmeztetés	Győződjön meg róla, hogy a Pofák nyitva van a tesztelés során
Figyelmeztetés	Ultrahangos olló Hiba észlelve
Figyelmeztetés	A Energia-átalakítója hátralévő ideje nulla
Figyelmeztetés	Kérjük, egyszerre csak egy gombot aktiváljon
Figyelmeztetés	Kérjük, csökkentse a Ultrahangos olló-asra kifejtett erőt.
Figyelmeztetés	Ultrahangos olló gomb és a lábkapcsoló nem zárható egyszerre
Figyelmeztetés	A gomb elakadt, kérjük, ellenőrizze és folytassa
Figyelmeztetés	Állítsa be a Pofák vagy a szorító kevesebb szövetet
Figyelmeztetés	Vegye ki a készüléket a szövetekből
Rendszerhiba	Rendszerhiba
Rendszerhiba	Önellenzés sikertelen

Ha a tesztelés során hiba jelenik meg a képernyőn, végezze el a következő műveleteket:



- Győződjön meg róla, hogy a Energia-átalakítója-es kábel teljesen a megfelelő irányban van behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy a Ultrahangos olló megfelelően van-e meghúzva, vagy nem gyült-e össze szövetet a Ultrahangos olló vége körül. Állítsa be a Ultrahangos olló szorosságát, és óvatosan távolítsa el a Ultrahangos olló burkolata körül felgyülemlt szövetet. (Ha a vizsgálatot a művelet előtt indítja el, győződjön meg arról, hogy a Ultrahangos olló a levegő felé mutat. Ha Ultrahangos olló-et használnak, győződjön meg arról, hogy a szorítófópa nyitva van, és nem érintkezik semmilyen tárggyakkal).

- Ha a probléma továbbra is fennáll, fontolja meg a Energia-átalakítója vagy Ultrahangos olló cseréjét.
- Lépjen a berendezés munkamodjába.

MEGJEGYZÉS: A Energia-átalakítója nem működik megfelelően, ha a hőmérséklet meghaladja a megadott határértéket. Ilyen esetekben azonnal használjon egy másik Energia-átalakítója-et a helyreállításához, vagy kövesse az alábbi lépéseket a hiba okának meghatározásához és a választható helyreállítási módszerek feltárásához:

- Hagyja a Energia-átalakítója-et szobahőmérsékleten legalább 45 percig hűlni. Ez a hűtési módszer akkor is alkalmazható, ha a Energia-átalakítója hosszabb ideig tartó nagy teljesítményű üzem után felforrósodik.
- Ha a Energia-átalakítója túlmelegedés nem észlelhető, és a probléma továbbra sem oldódik meg, forduljon a gyártó karbantartó képviselőjéhez segítségért.
- A biztosítékokon kívül a Generátora-es készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Bármilyen csere- vagy szervizigény esetén forduljon a Reach Surgical, Inc. által képzett és felhatalmazott szervizszemélyzethez vagy a helyi képviselőhöz.

A Generátora karbantartását és frissítését kizárólag a Reach Surgical által képzett és felhatalmazott szervizszemélyzet végezheti.

A potenciális fenyegetések megelőzése érdekében megfontolandóak a kiberbiztonsági óvintézkedések. Az alábbi incidensek kiberbiztonsági kockázatot jelentenek:

- Jogosulatlan hozzáférés a készülékhez nem kapcsolódó termékekhez.
- Bármilyen jogosulatlan hálózati kommunikáció a készülékkel.
- A Reach Surgical által nem engedélyezett firmware- vagy szoftverfrissítések.

A fenti incidensek bármelyike esetén kérjük, forduljon a Reach Surgical, Inc. értékesítési képviselőjéhez, vagy közvetlenül a Reach Surgical, Inc.-hez a Reachquality@reachsurgical.com címen.

Karbantartás

A Generátora és a Bipoláris energia alapcsatlakozó tisztítása és fertőtlenítése

Tisztítás

Tisztítsa meg a Generátora LCD képernyőt és a bipoláris alapcsatlakozót a kórházi eljárásoknak és előírásoknak megfelelően. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a Generátora fő tápellátása le van választva, és a tápkábel ki van húzva a kimeneti egységből.

FIGYELMEZTETÉS: A tisztítási eljárásokat gondosan kell követni a Generátora károsodásának, áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Ne öntsön folyadékot a Generátora-es készülékre vagy a készülékbe, illetve ne merítse azt folyadékba.

A tisztításhoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Készítsen semleges pH-jú mosószeret vagy semleges pH-jú enzimes mosószeret a mosószer gyártója által megadottak szerint.
- Egy kis mennyiségű tisztítószerezrel átitatott tiszta, puha ruhával törölje át kézzel az összes felületet, beleértve a Generátora képernyőt is.
- Töröljön át minden felületet meleg csapvízzel átitatott tiszta, puha ruhával.
- Végül törölje át az összes felületet tiszta, puha ruhával, hogy száraz legyen.

Fertőtlenítés

- Ha a Generátora vérről vagy testnedvekről szennyeződik, újrafelhasználás előtt fertőtleníteni kell. A következő kémiai fertőtlenítőszereket validálták a Generátora-es eszközön való használatra: 70%-os izopropil-alkohol, 6%-os nátrium-hipoklorit, 10%-os hidrogén-peroxid.
- Kövesse a gyártó ajánlásait a fertőtlenítőszer megfelelő használatára, koncentrációjára és az érintkezési időre vonatkozóan.
- Gondoskodjon arról, hogy a fertőtlenítő készülékeket a gyártó utasításai szerint konfigurálja és használja.

A lábkapcsoló tisztítása

Minden használat után tisztítsa meg a lábkapcsolót és a kábelt a következő eljárással:

- Húzza ki a lábkapcsolót a Generátora-esből.
- Készítsen semleges pH-jú enzimes mosószeret a gyártó utasításai szerint.
- Csatlakoztassa a kábelt biztonságosan a lábkapcsolóhoz, és 2 percig merítse a tisztítóoldatba.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a Generátora csatlakoztatásához használt lábkapcsoló kábel teljesen száraz, hogy elkerülje a véletlen aktiválást.

- A bemerítés után kézzel súrolja le a lábkapcsolót és a kábelt egy puha sörtéjű kefével a tisztítóoldatban.
- Alaposan öblítse le a lábkapcsolót és a kábelt meleg csapvízzel legalább 1 percig.

FIGYELMEZTETÉS: Az öblítés során a kábelt és a lábkapcsolót tartsa biztonságosan csatlakoztatva.

- Törölje át az összes felületet tiszta, puha ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon ultrahangos tisztítógépet a lábkapcsoló tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsolja be a Generátora tápegységét a hálózati tápkábel csatlakoztatása előtt. Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás száraz.

A Energia-átalakítója tisztítása és fertőtlenítése

A Energia-átalakítója-eseket nem steril módon szállítják, és minden használat előtt alapos tisztítást és sterilizálást igényelnek.

Tisztítás:

Alaposan tisztítsa meg a jelátalakítókat a következő lépések szerint:

- Rögöria be a jelátalakítókat a csavaros oldalal feléfelé, és tisztítsa meg egy puha sörtéjű kefével tisztított vízzel, amíg a felületen nem maradnak foltok;

- A transzduktor pH-semleges enzimátikus mosószerben lehet áztatni (Fő összetevők: proteáz lipáz amiláz celluláz pektináz és más biológiai enzimek, környezetbarát felületaktív anyag, rozsdát megelőző tényező és stabilizátor) legfeljebb 10 percig és megfelelő hőmérsékleten 15 °C ~ 65 °C. A mosószer és a tisztított víz aránya 1:400;
- Öblítse a jelátalakítót a csavaros oldallal felfelé 2 percig tisztított vízzel;
- Tisztítsa meg a csatlakozócsavart, a szikével szerelt felületet és a csatlakozót alkoholos törölkendővel.
- Áztassa a transzducert 75%-os orvosi alkoholba, majd tartsa és rázza 30-szor;
- Öblítse a jelátalakítót a csavaros oldallal felfelé 2 percig tisztított vízzel.

Megjegyzés: Az ultrahangos tisztítószer használata nem ajánlott a jelátalakítóhoz.

Száritás:

Száritási hőmérséklet: 50-70°C, Száritási idő: 30 perc.

Transzducer sterilizálás:

A fenti tisztítási és száritási lépések követően a jelátalakítót az alábbiakban felsorolt módszerek valamelyikével kell sterilizálni.

Gőzsterilizálás (121 °C)

- A hüvelyeket a sterilizálás előtt kell felszerelni. A transzducereket a sterilizálás során be kell csomagolni. Tegye a transzducereket magas hőmérsékletű gőzsterilizáló edénybe a sterilizáláshoz, 121 °C hőmérsékleten és 30 percig.
- Száritási hőmérséklet: 50 - 70 °C, száritási idő: 30 perc.

Gőzsterilizálás (134 °C)

- A hüvelyeket a sterilizálás előtt kell felszerelni. A transzducereket a sterilizálás során be kell csomagolni. Tegye a transzducereket magas hőmérsékletű gőzsterilizáló edénybe a sterilizáláshoz, 134 °C hőmérsékleten és 10 percig.
- Száritási hőmérséklet: 50 - 70 °C, száritási idő: 30 perc.

Biztonsági és funkcionális tesztek

Biztosítsa a Energia-átalakítója, Generátora és a lábkapcsoló biztonsági és funkcionális tesztjeinek végrehajtását a kórházi eljárásokkal és előírásokkal összhangban. A több beteg által használt egyéb komponensek biztonságj és működési tesztjeit illetően olvassa el az egyes komponensekre vonatkozó használati utasításokat.

Biztonsági teszt

Generátora: Kórházi technikusoknak kell elvégezniük a szívárgási áram vizsgálatát.

Lábkapcsoló: Ellenőrizze a pedált, a kábelcsatlakozót és a kábelt, hogy nincs-e rajta repedés vagy sérülés. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Egyéb összetevők: Ellenőrizze az összes többi alkatrészt a vonatkozó használati utasításban foglaltak szerint.

Funkcionális teszt

Ultrahang üzem mód

- Készítse elő a PD Ultrahangos olló teljes készletét, és csatlakoztassa a Energia-átalakítója-et a II. fejezet - A berendezés telepítése és üzemeltetése című fejezetben megadott utasítások szerint.
- Ellenőrizze, hogy lehetséges-e belépni a munkaállapotba. A különböző Ultrahangos olló-ekes eltérő belépési interfészekkel rendelkezhetnek. A részletes utasításokat lásd a 2. fejezet 1. részének 3. szakaszában.
- Erősítse meg a MIN teljesítményszint 3 és a MAX teljesítményszint 5 kijelzését.
- Nyomja meg a teljesítménynövelő és -csökkentő gombokat, hogy a MIN teljesítményszintet a 1-5. szintek között beállíthassa.
- Kapcsolja be a Generátora-es készüléket, és kapcsolja ultrahangos üzemmódba. Ellenőrizze a Energia-átalakítója és a Ultrahangos olló helyes csatlakoztatását.
- Nyitott állkapocs mellett nyomja meg a lábkapcsoló "MAX" gombját. Az LCD-képernyőn az "5" MAX teljesítményszintnek kell megjelennie, és egy aktíváló hangjelzésnek kell megszólalnia.
- Nyitott állkapocs mellett nyomja meg a lábkapcsoló "MIN" gombját. Az LCD-képernyőn kell megjelenjen a MIN teljesítményszintnek, és egy aktíváló hangjelzésnek kell megszólalnia.

FIGYELMEZTETÉS: A rendszer aktiválása előtt a felhasználó sérülésének elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az állkapocs távol van a szívtől, más műszerektől vagy egyéb tárgyaktól.

Bipoláris elektrobeszeti üzemmód

- Csatlakoztassa a fejlett bipoláris elektrobeszeti műszert/alapvető bipoláris műszert az utasításoknak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer be tud-e lépni a munkafelületre. Az alap bipoláris üzemmódban a 30 teljesítményszint ikonok, míg a haladó bipoláris üzemmódban a "haladó bipoláris" ikonok kell megjelennie.
- Érintse meg enyhén a teljesítménynövelő és csökkentő gombokat a bipoláris alap üzemmódban, hogy megerősítse, hogy a teljesítményszint 1 és 95 között állítható. Érintse meg az Alacsony, Közepes és Magas sávokat a 15, 30 és 60 közötti közvetlen váltáshoz.
- Kapcsolja ki a Generátora készüléket, és várjon 5 másodpercet. Ezután kapcsolja be a Generátora tápegységét, és várjon 10 másodpercet. Ellenőrizze, hogy az alap bipoláris üzemmódban megjelenik-e a 30 teljesítményszintű felület, a haladó bipoláris üzemmódban pedig a "haladó bipoláris" felület. Ellenőrizze, hogy a Generátora az előre meghatározott követelményeknek megfelelően aktiválódott-e.
- Csatlakoztassa a fejlett és a Basic bipoláris Elektrobeszeti műszerek-et, és nyomja meg az egyes lábkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanelen villog-e a teljesítményszint jelzése, és figyeljen az aktiválási hangra.

FIGYELMEZTETÉS: A rendszer aktiválása előtt szigorúan tilos a Ultrahangos olló bármilyen érintkezése a szövetekkel, más műszerekkel vagy más tárgyakkal, hogy a felhasználó sérülését megelőzze.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Rendszerrel kapcsolatos

- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az ultrahangos sebészet, az elektrobeszést, a nőgyógyászat és a laparoszkópia klinikai gyakorlatára vonatkozó kórházi irányelveket.
- A minimálisan invazív eszközök gyártóként eltérőek lehetnek. Ha egy műtét során egyidejűleg különböző gyártók minimálisan invazív műszereit és tartozékait használják, a műtét előtt ellenőrizze a műszerek és tartozékok kompatibilitását, és ellenőrizze, hogy az emberi testbe behelyezett tartozékok nem rendelkeznek-e olyan érdes felülettel, éles peremmel vagy kiemelkedéssel, amely biztonsági kockázatot okozhat.
- Ezt az eszközt csak képzett és engedéllyel rendelkező sebészek használhatják. Ne használjon elektrobeszeti eszközöket, hacsak nem kapott megfelelő képzést azok használatára az adott eljáráshoz, amelyet el kell végeznie. Az eszköz képzetlen használata a betegnél nem szándékos súlyos sérülést okozhat, beleértve a béli perforációját és az eszméletlen és helyrehozhatatlan szövethalált.
- Az esetleges áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa ki a Generátora-es készülékházát engedély nélkül. A műszer bármilyen javítását és frissítését a Reach Surgical, Inc. által képzett és felhatalmazott szervizszakembernek kell elvégeznie. Ne használja ezt a műszert orvosi műtéten kívül más célra.
- A lézerek, elektrobeszeti és ultrahangos eljárások alapos ismerete elengedhetetlen a lézer, az elektrobeszeti és az ultrahangos eljárások alapelveinek és technikáinak megértéséhez, hogy elkerülhető legyen a beteg és az egészségügyi személyzet számára az áramütés és az égési sérülések veszélye, valamint a készülék vagy más orvosi eszközök károsodása. Az elektromos szigetelés vagy földelés nem sérülhet. Ne merítse az elektrobeszeti eszközöket folyadékokba, kivéve, ha a kialakítás ezt előírja, és a címkézés nem jelzi, hogy a készüléknek be kell meríteni.

- A biztonságos és hatékony ultrahangos sebészet és elektrosebészet nemcsak a berendezés kialakításától függ, hanem nagymértékben a kezelő által ellenőrzött számos tényezőtől is. A biztonság és a hatékonyság javítása érdekében olvassa el, értsen meg és kövesse a készülékekhez mellékelte használati utasítást.
- Mint minden energiaforrásnál (elektrosebészeti, lézeres vagy ultrahangos), itt is figyelembe kell venni a rákkeltő és fertőző kockázatokat, amelyeket számos szöveti melléktermék, például a füst és az aeroszol jelenthetnek. Mind a nyíl, mind az endoszkópos eljárásnálól be kell tartani a megfelelő övintézkedéseket, mint például a védőszemüveget, szűrőmaszkot és hatékony füstelvezető berendezést.
- Az eszköz eltávolítása után ellenőrizze a szövetet a vérzéscsillapítás szempontjából. Ha nincs vérzéscsillapítás, megfelelő módszereket kell alkalmazni a vérzéscsillapítás elérésére.
- Előfordulhat, hogy a Reach Surgical, Inc. által nem engedélyezett cégek által gyártott vagy forgalmazott termékek nem kompatibilisek a készülékkel. Az ilyen termékek használata nem várt eredményekhez vezethet, és sérülést okozhat a felhasználónak vagy a betegnek.
- Az interferencia kockázatának csökkentése érdekében a készüléket és a burkolatot független áramkörhöz kell csatlakoztatni.
- A berendezés nem alkalmas levegővel, oxigénnel vagy dinitrogen-oxidall gúlyukéhoz érzéstenítő keverék jelenlétében történő használatra. Más fémeszközökkel való ütközés miatti szikrázás lehetősége. A szikrák meggyújtják a gúlyukéhoz gázokat, például a terep-gázokat.
- A készüléknek az előírt környezeti üzemi hőmérséklet-tartományon belül kell működnie.
- A kimeneti aljzat feszültségének meg kell felelnie a Generátora-es szabvány követelményeinek ("A rendszer műszaki feltételei" című fejezet). Ha a tápegység nem megfelelően van csatlakoztatva, az károsíthatja a Generátora-et, és áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne használjon hosszabbított.
- Ne állítsa az aktiválási hangot hallhatatlan szintre. Az aktiválási hangokat a sebészeti csapat személyzete észreveheti, miközben a Generátora energiát szolgáltat.
- Az elektrosebészet során keletkező füst bizonyítottan potenciálisan károsíthatja a betegeket vagy a sebészeti személyzetet. Javasolja a megfelelő szellőztetés sebészeti füstelvezetővel vagy más eszközzel.
- A Generátora-es integrált ultrahangos sebészeti készülékben vannak olyan alkatrészek, amelyeket nem steril módon szállítanak (pl. Energia-átalakítója). A rendszer telepítésének megkezdése előtt szükség szerint sterilizálja a terméket. A tisztítási és sterilizálási utasításokat lásd az egyes vonatkozó utasításokban.
- A felhasználóknak a betegek sérülésének elkerülése érdekében a Ultrahangos olló-nak a tesztgomb megnyomása előtt és a rendszerellenőrzés során kerülnie kell más eszközöket, műtői kendőket, betegeket vagy más tárgyakat. A rendszerellenőrzés és a vizsgálati módszer során biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani aeroszol esetén (a kórházi előírásoknak megfelelően).
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást az állkapocsra, hogy ne gátolja az ultrahangos energia leadását.
- A felhasználó sérülésének elkerülése érdekében a rendszer aktiválása előtt a pengének kerülnie kell a szövetekkel, más eszközökkel vagy más tárgyakkal való érintkezéssel.
- Ha folyadékot spriccelnek vagy öntenek a Generátora-esre vagy a Generátora-esre, vagy a Generátora-es kiömlik vagy folyadékba öntik, az károsíthatja a Generátora-est, és áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
- Az edényzársi technikákhoz kapcsolódó szikrázás és felmelegedés egyaránt gyújtóforrásként szolgálhat. A gáznek és a szivacsnak nedvesnek kell maradnia. Az elektrosebészeti elektródákat tartsa távol az éghető anyagoktól és az oxigénnel (O2) gazdag környezetektől.
- Ha a Energia-átalakítója jelentős sérülést szenvedett, vagy ha a tisztítás és a fertőtlenítő karbantartás után bármelyik alkatrész sérülés jeleit mutatja, dobja ki. A sérült alkatrészeket a későbbi kezelést előtt egyértelműen meg kell jelölni a helytelen használat elkerülése érdekében.
- Az eldobható hulladékokat és az elektronikai hulladékokat a kórházi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és a környezetszennyezés elkerülése érdekében nem szabad tetszőlegesen eldobni.
- Kerülje a Generátora-es készülék használatát más berendezések közelében, vagy más berendezésekre halmozva. Ha szükséges a szomszédos vagy egymásra helyezett használat, a megfelelő működés biztosítása érdekében ellenőrizze a Generátora és a többi berendezés működését.
- A készülék nem tartalmaz a kezelő által szervizelhető alkatrészeket. Szervizeléshez forduljon a Reach Surgical értékesítési képviselőjéhez vagy a szerviz személyzetéhez.
- Használat előtt ellenőrizze a rendszerhez csatlakoztatott összes eszközt és a csatlakozásokat. Ellenőrizze, hogy az eszköz rendeltetésszerűen működik-e. A nem megfelelő csatlakozásoknál ivéképződés, szikrázás, a készülék meghibásodásához vagy nem kívánt műtői eredményekhez vezethet.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt a berendezést csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni.
- Tartsa a lehető legnagyobb távolságot a Generátora és más elektronikus eszközök (pl. monitorok) között. Ne keresztezze vagy kösse össze az elektromos vezetékeket az elektronikus eszközökkel. A Generátora interferenciát okozhat más elektronikus eszközökkel.
- A rendszert belső és külső pacemakerek jelenlétében óvatosan kell használni. A Elektrosebészeti műszerek használata által okozott zavarok a pacemaker aszinkron állapotba kerülését vagy a pacemaker működésének teljes megakadályozását okozhatják. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkező betegeknek elektrosebészeti vagy szövetzáró eszközöket kívánunk használni, további információért forduljon a pacemaker gyártójához vagy a kórház kardiológiai osztályához.
- Legyen óvatos, ha műszereket rakogat a Generátora-es készülékre, vagy ha a Generátora-es készüléket elektromos műszerek tetejére helyezi. Ez egy instabil konfiguráció, és nem biztosít megfelelő hűtést.
- Ha a Generátora meghibásodik, az a műtét megszakítását okozhatja. Tartalékrendszernek rendelkezésre kell állnia.
- Ha a helyi előírások megkövetelik, a Generátora-et egy potenciálegyenlőségi kábel segítségével kell csatlakoztatni a kórház egyenértékű csatlakozójához.
- Ha a rendszert és a fiziológiai megfigyelőberendezést egyidejűleg használják ugyanazon a betegben, bármely megfigyelő elektródát a lehető legtovább kell elhelyezni a műszertől.
- Alap bipoláris üzemmódban válassza a kívánt hatás eléréséhez a lehető legkisebb kimeneti teljesítményt.
- A nagyfrekvenciás sebészeti berendezések meghibásodása a kimenő teljesítmény váratlan növekedését okozhatja.
- A Generátora-es és a bipoláris elektrosebészeti alapszatlakozóba víz vagy részecskék kerülhetnek. A használat és a tisztítás során el kell kerülni a víz vagy a részecskék bejutását.
- Ha a rendszert endoszkóppal együtt használják, az növelheti a beteg testén a szívárgási áramot. Figyeljen az eljárás során.
- A felhasználó és/vagy a beteg figyelmeztetése arra, hogy az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a Reach Surgical, Inc. számára a Reachquality@reachsurgical.com címen keresztül, valamint a felhasználó és/vagy a beteg letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Műszerrel kapcsolatos

Sebészeti beavatkozások során fontos tisztában lenni azzal, hogy a Ultrahangos olló, Ultrahangos olló pad és Szár műszer végrészén megemelkedhet a hőmérséklet, az ultrahangot vagy bipoláris elektrokoagulációt alkalmaznak a szövetekre hosszabb ideig. A biztonság érdekében alapvető fontosságú, hogy az eljárás során elkerülje ezen műszerelemek és a szövetek, a műtői kendők, a műtői köpenyek vagy bármely más, nem kapcsolódó terület véletlen érintkezését.

Ezenkívül elengedhetetlen az óvatosság a bipoláris műszer elhelyezésekor. Különösen nem szabad éghető anyagok, például gáz vagy sebészeti kendő közelében vagy azzal érintkezve elhelyezni. Az ebben az összefüggésben használt bipoláris műszerek használat közben hőt termelhetnek, ami potenciálisan tűzveszélyt okozhat. Amikor a bipoláris elektrosebészeti Generátora készüléket nem használják, azt megfelelően a védőburkolatban kell tárolni, vagy biztonságos távolságtól kell tartani a betegről, a sebészcsapat tagjaitól és az éghető anyagoktól.

MEGJEGYZÉS: További figyelmeztetések és övintézkedések a vonatkozó használati utasításban találhatóak.

EMC információk

A termék megfelel az elektromágneses kompatibilitási vizsgálaton, amely megfelel az IEC60601-1-2 szabvány orvosi berendezésekre vonatkozó korlátozási követelményeinek. Ezek a korlátozások megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben a normál orvosi berendezésekben.

A termék összetétele

Sorszám	Alkatrész neve	Modell/Version No.	Megjegyzések
1	Elektrosebészeti eszköz	OP9	/
2	Ultrahangos sebészeti eszköz energia-átalakítója	TRA6	Kompatibilis használat
3	Ultrahangos olló rendszer egyszerű használatra Ultrahangos olló	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatibilis használat
4	Eldobható ultrahangos nagyfrekvenciás sebészeti egység Szövet tömítőanyag	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrahangos lábkapcsoló	OP-FSD	/
6	Elektrosebészeti lábkapcsoló	OP-FSS	/
7	Elektrosebészeti bipoláris csatlakozó	OP-BPC	/

Termék kábel

Sorszám	Kábel neve	Hosszúság (m)	Árnyékolat
1	Lábvezérlő kábel	3	Igen
2	Hálózati kábel	5	Nem
3	Bipoláris elektrosebészeti kábel	3	Nem
4	A Energia-átalakítója-es kábel	2.9	Igen

EMC teljesítmény

Ez a berendezés más orvosi berendezések és a rádiós kommunikáció által okozott rádiófrekvenciás zavarásnak lehet kitéve. Az ilyen interferenciák megelőzése érdekében ezt a terméket az IEC 60601-1-2 szabvány szerint vizsgálták, és megfelel a követelményeknek. A Reach Surgical, Inc. azonban nem garantálja, hogy az egyes telepítési környezetekben egyáltalán nem lesz interferencia.

Ha úgy találják, hogy a készüléket zavarják (ami a készülék be- és kikapcsolásával állapítható meg), a felhasználónak (vagy a Reach Surgical, Inc. által jóváhagyott karbantartó személyzetnek) meg kell próbálnia az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet megtenni az interferenciaprobléma megoldására:

Állítsa be az eszköz irányát vagy helyzetét, amely hatással van rá.

Növelje a távolságot a készülék és a küldő készülék között.

Használjon más áramforrást (és ne a berendezés befolyásolására használt áramforrást) a berendezés áramellátásához.

Egyéb javaslatokért forduljon a szállítóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez.

A gyártó nem vállal felelősséget a következő helyzetek által okozott zavarokért: az ajánlott kábelektől eltérő összekötő kábelek használata; a berendezés engedély nélküli módosítása vagy átalakítása. Az engedély nélküli változtatások vagy módosítások a berendezés hatékonyságának elvesztését okozhatják.

Minden típusú elektronikus berendezés elektromágneses interferenciát okozhat más berendezéseknek a levegőn vagy a hozzá csatlakoztatott kábeleken keresztül. Ne használjon a készülék közelében olyan eszközöket, amelyek RF jeleket bocsátanak ki, például mobiltelefonokat, rádió adó-vevő készülékeket vagy rádióvezérlő termékeket, mivel ez azt okozhatja, hogy a készülék teljesítménye nem felel meg a megadott specifikációknak. Ha ilyen eszközök vannak a készülék közelében, kapcsolja ki ezen eszközök áramellátását. A készülékért felelős egészségügyi személyzetnek utasítania kell a technikusokat, a betegeket és a készülék közelében tartózkodó egyéb személyzetet a fenti követelmények maradéktalan betartására.

A megadott EMC-teljesítmény teljes körű eléréséhez a felhasználónak a terméket a kézikönyvben leírtak szerint kell helyesen telepítenie. Ha bármilyen EMC-vel kapcsolatos probléma merül fel, kérjük, forduljon a Reach Surgical, Inc. által jóváhagyott karbantartó személyzethez.

A Energia-átalakítója (kábellel) és Ultrahangos olló a teljes rendszer alkalmazott részeként van meghatározva.

Övintézkedések a termék telepítéséhez

A berendezés kórházi környezetben is használható, de nem tartalmaz rádiófrekvenciás árnyékoló helyiségeket az aktív rádiófrekvenciás sebészeti berendezések körül, vagy ahol mágneses rezonancia hatású berendezéseket helyeznek el, mivel ezeken a helyeken az elektromágneses zavarok intenzitása magas.

A helyhez kötött rádióátviteli berendezések elkülönítési távolsága és hatása: a helyhez kötött adók, például a vezeték nélküli (mobiltelefonok/kordon nélküli) telefonok bázisállomái, a földi mobil rádióvevők, az amatőr rádióvevők, az AM és FM rádióadások, a Generátora-es televíziós adások stb. által keltett mágneses térerősség elméletileg nem mérhető pontosan. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által generált elektromágneses környezet értékeléséhez az elektromágneses mező mérést kell figyelembe venni. Ha a mágneses térerősség mérő értéke a készülék helyén meghaladja a "Anti-Interferencia nyilatkozatban" meghatározott megfelelő rádiófrekvenciás szintet, akkor a készülék ellenőrizni kell, hogy a készülék normálisan működhessen. Ha rendellenes működési feltételeket találnak, további méréseket kell mérlegelni, például a berendezés átállítását vagy áthelyezését, vagy rádiófrekvencia-ellenes helyiség használatát.

1) A Reach Surgical, Inc. által biztosított vagy kijelölt tápkábelt használja. A hálózati csatlakozóval ellátott termékeket védőföldeléssel ellátott, rögzített hálózati csatlakozójátba kell csatlakoztatni. Ne használjon semmilyen adaptert vagy csatlakozó hálózati csatlakoztatásához.

2) Tartja ezt a készüléket a lehető legtávolabb más elektronikus eszközöktől.

3) Kövesse a lépéseket a készülék csatlakoztatásához.

Általános megjegyzések

(1) A kábel specifikációja.

A Reach Surgical, Inc. által biztosított kábelek használata nem károsítja a termék EMC-teljesítményét. Nem specifikált kábelek használata esetén a berendezés EMC-teljesítménye jelentősen csökkenhet.

(2) Övintézkedések a jogosulatlan módosítások esetén

A felhasználó nem módosíthatja ezt a terméket, különben a termék EMC-teljesítménye csökkenhet.

A termék módosítása a következő változtatásokat tartalmazza:

a. Kábel (hossza, anyaga, kábelezés stb.).

b. Berendezés/elrendezés.

c. A berendezés konfigurációja/összetévi.

d. Berendezésvédő alkatrészek (fedelelt nyitó/záró és fedelet rögzítő alkatrészek).

(3) A berendezés működétekor minden védőburkolatot be kell zárni.

Ezt a terméket várhatóan az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használják, és a termék vásárlójának és felhasználójának biztosítania kell, hogy a terméket ebben az elektromágneses környezetben használják.

Lényeges teljesítmény

1. A fejlett nagyfrekvenciás rádióenergia-kibocsátás esetén a rendszernek biztosítania kell, hogy a névleges kimeneti teljesítmény eltérése ne haladja meg a szabványos érték 20%-át.

2. Az alapvető nagyfrekvenciás rádióenergia-kibocsátás esetén a rendszernek biztosítania kell, hogy a névleges kimeneti teljesítmény eltérése ne haladja meg a szabványos érték 20%-át.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat - ELEKTROMAGNETIKUS EMISSZIÓ		
A készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra szánták. Az ügyfélnek vagy az a készülék felhasználójának biztosítania kell, hogy az a készülék t ilyen környezetben használják.		
Kibocsátási vizsgálat	Megfelelés	Elektromágneses környezet - iránymutatás
RF-kibocsátás CISPR 11	Csoport1	Az eszköz kizárólag belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát. Ezért RF-kibocsátása nagyon alacsony, és valószínűleg nem okoz semmilyen interferenciát a közeli elektronikus berendezésekben.
RF-kibocsátás	A osztály	A berendezés EMISSZIÓS jellemzői alkalmasak teszik ipari területeken és kórházakban való használatra.
Harmonikus áram IEC 61000-3-2	A osztály	
Feszültségváltozások / feszültségingadozás / villogás IEC 61000-3-3	Megfelel	

Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavarmentesség			
A készüléket az alábbiak szerint meghatározott elektromágneses környezetben való használatra szánták. Az ügyfélnek vagy a készülék felhasználójának biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.			
IMMUNITÁS teszt	IEC 60601 vizsgálati szint	Megfelelési szint	Elektromágneses környezet - iránymutatás
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV érintkező ± 2,4,8 ,15kV levegő	± 8 kV érintkező ± 2,4,8 ,15kV levegő	A padlónak fának, betonnak vagy kerámiaempingnek kell lennie. Ha a padlót szintetikus anyaggal borítják, A relatív páratartalomnak legalább 30 %-nak kell lennie.
Elektromos gyors transziens/kitörés IEC 61000-4-4	± 2 kV a tápvezetékek esetében ± 1 kV a bemeneti/ kimeneti vezetékeknél	± 2 kV a tápvezetékek esetében ± 1 kV a bemeneti/ kimeneti vezetékeknél	A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV-os vezeték(ek) a vezeték(ek)re ± 2 kV-os vezeték(ek) a földeléshez	± 1 kV-os vezeték(ek) a vezeték(ek)re ± 2 kV-os vezeték (s) a föld felé	A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.
Feszültségcsökkenés, rövidzárlat megszakítások a tápegység bemeneti vezetékein IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciklus 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 315° esetén 0 % UT; 1 ciklus és 70 % UT; 25/30 ciklus Egyfázisú: 0°-on 0 % UT; 250/300 ciklus	0 % UT; 0,5 ciklus 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 315° esetén 0 % UT; 1 ciklus és 70 % UT; 25/30 ciklus Egyfázisú: 0°-on 0 % UT; 250/300 ciklus	A hálózati áram minőségének meg kell felelnie egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha az ultrahangos sebészeti készülék felhasználója A berendezés folyamatos működést igényel a hálózati áramellátás megszakadása során, ajánlott, hogy az ultrahangos sebészeti A berendezéseket szünetmentes tápegységről vagy akkumulátorról kell táplálni.
Teljesítmény frekvencia (50/60 Hz) Mágneses mező IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Teljesítmény frekvencia mágneses a mezőknek a szintjellemzőknek kell lenniük. Egy tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetben található tipikus helyszínről.

Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavarmentesség			
A készülék célja az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő alkalmazás. Az ügyfélnek vagy a készülék felhasználójának biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.			
IMMUNITÁS teszt	IEC 60601 vizsgálati szint	Megfelelési szint	Elektromágneses környezet- útmutatás
Vezetett RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz-től 80 MHz-ig 6 V ISM-sávokban 0,15 MHz és 80 MHz	3V	Hordozható és mobil RF kommunikáció A berendezés nem használható közelebb a készülék bármely részéhez, beleértve a kábeleket is, mint az adó frekvenciájának egyenletéből számított ajánlott távolság. Ajánlott elkülönítési távolság
Sugárzott RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz és 2,7 GHz között 80 % AM 1 kHz-en	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ <p>80MHz és 800MHz között</p> <p>800MHz és 2,7GHz között</p> <p>ahol P a maximális kimeneti teljesítmény az adó gyártója szerint az adó teljesítménye wattban (W), d pedig az ajánlott távolság méterben (m).</p> <p>A helyhez kötött rádiófrekvenciás adókból származó, elektromágneses helyszíni felméréssel3 meghatározott térorösségnek minden frekvenciatartományban kisebbnek kell lennie a megfelelőségi szintnél.</p> <p>A következő szimbóllummal jelölt berendezések közelében interferencia léphet fel:</p>  <p>Az IEC 60601-1-2 szabvány 9. táblázatában meghatározottak szerint kell vizsgálni az ME-berendezések és ME-rendszerek ZÁRÓAPTJAIT az IEC 61000-4-3 szabványban meghatározott vizsgálati módszerek alkalmazásával.</p>

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a készülékek között ajánlott távolságok.			
A ultrahangos sebészeti eszköz olyan elektromágneses környezetben történő alkalmazásra irányul, ahol a kisugárzott RF zavarokat ellenőrzik. Az ügyfél vagy a készülék felhasználója segíthet az elektromágneses interferencia megelőzésében azáltal, hogy a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (adók) és A készülék az alábbi ajánlás szerint; között minimális távolságot tart a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítményének megfelelően.			
Az adó névleges maximális kimeneti teljesítménye (w)	Elválasztási távolság az adó frekvenciája szerint /m	150 kHz-től 80 MHz-ig	80 MHz és 800 MHz között
		$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$
			800 MHz-től 2,7 GHz-ig
			$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$

0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

MEGJEGYZÉS: Ezek az iránymutatások nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses terjedést befolyásolja a szerkezetek, tárgyak és emberek általi elnyelés és visszaverődés.

Műszaki feltételek


A rendszer működéséhez szükséges alkatrészek: Elektromos sebészeti eszköz, Energia-átalakítója, Ultrahangos lábkapcsoló, Elektrosebészeti lábkapcsoló, Ultrahangos olló vagy Elektrosebészeti kézidarabok, Elektromos sebészeti bipolaris csatlakozó Bipolaris eszköz.

Lásd a termékírást erre az alkatrészre vonatkozóan.

Az áramütés elleni védelem foka	Ultrahang:  CF típusú alkalmazott rész; Bipolaris elektrosebészeti  Defibrillációbiztos CF típusú alkalmazott rész
Az áramütés elleni védelem foka	I. osztály
Generátora a káros infúziókhöz	Normál felszerelés
Védelmi fokozat a káros vízbehatolás ellen	Lábkapcsoló: IP68
Menedzsment kategória	IIb. osztály
Ultrahang üzemmód paraméterkövetelmények:	
Bemeneti teljesítmény	Tápfeszültség: 100-240V Tápfrekvencia: 50Hz/60Hz Bemeneti teljesítmény: 400VA
Ultrahang üzemmód paraméterkövetelmények:	
Gerjesztési frekvencia	54 kHz - 57 kHz
Elsődleges csúcsrezgés kitérés	25 µm ~ 110 µm
Ultrahangos olló csúcs fő akusztikus kimeneti felület Termék:	1,53-2,75 mm ²
Másodlagos keresztötés akusztikus a Ultrahangos olló csúcson Kimeneti terület:	19,32-35,88 mm ²
Származtatott kimeneti hang Ultrahangos olló csúcson a referencia csúcson Elsődleges amplitúdó Teljesítmény	< 30W
A rendszer frekvenciaszabályozásának típusa	A gerjesztési frekvencia a terheléstől függetlenül, automatikusan, folyamatosan állítható.
Teljesítménytartalék index	Legalább 2,5
Elektrosebészeti paraméterek követelményei:	
Működési frekvencia	400KHz ± 5%
Maximális kimeneti feszültség	≤ 250V
Fejlett bipolaris üzemmód Maximális kimeneti áram	≤ 5,5A
Alapvető bipolaris üzemmód Maximális kimeneti áram	≤ 2,2A
Maximális kimeneti csúcs-csúcsfeszültség	≤ 500Vpk
Csúcsstényező	1.6 ± 0.4
Névleges teljesítmény	Rádiófrekvenciás fejlett bipolaris: 270 W Rádiófrekvencia Bipolaris alap: 95W
Névleges terhelés	Rádiófrekvenciás fejlett bipolaris: 30Ω Rádiófrekvencia Bipolaris alap: 200Ω
Működési környezet feltételei	Hőmérséklet: hőmérséklet: 10 ° C és 30 ° C között
	Relatív páratartalom: ≤ 70%
	Légköri nyomástartomány: 800 hPa és 1060 hPa között
Szállítási és tárolási feltételek	Hőmérséklet: -30 ° C-tól + 55 ° C-ig (Generátora, lábkapcsoló, adapter) Hőmérséklet: -10 ° C-tól + 55 ° C-ig (Ultrahangos olló)
	Páratartalom: ≤ 80%
	Légköri nyomástartomány: 800 hPa és 1060 hPa között
A gyártás dátuma	A gyártási dátum a Generátora hátlapján található sorozatszám alapján határozható meg.
Hálózati kábel	Megfelelés a CCC tanúsítási követelményeknek Jelenlegi minősítés: 10A
Megmaradási arány	A Energia-átalakítója kézidarab és a használt Ultrahangos olló alapján meghatározva. A perisztenciaáarányra vonatkozó információért lásd a vonatkozó Ultrahangos olló és Ultrahangos olló Energia-átalakítója kézidarab használati utasítás vagy 7. fejezet - Figyelmeztetések és óvintézkedések.
Biztosíték	45 * 20 T8AH250V
Tömeg (csomagolás nélkül)	Generátora: névleges 8 kg
Teljes mennyiség	OP9 Generátora: (hossz * szélesség * magasság): cm-34 cm-16 cm
Rendelkezés	A Generátora egyes belső alkatrészei, a lábkapcsoló és a lábkapcsoló kábel ólomot tartalmaznak. A helyi Az ártalmatlanításra vonatkozó követelmény és szabályozás. Az elemeket a megfelelő hulladékkezelési gyakorlatnak megfelelően ártalmatlanítsa.
AP/APG besorolás	Nem AP/APG berendezés.
Élettartam:	Élettartam: 7 év
Szoftver kiadásának verziója	V01.01

Bipoláris kimeneti hullámforma

Fejlett bipoláris kimeneti teljesítmény-terhelési görbe

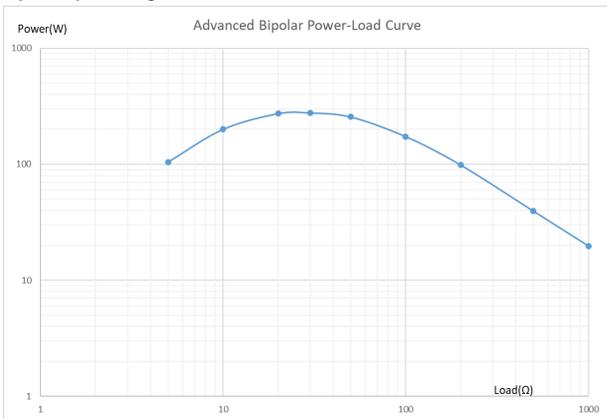


Teljesítménygörbe-korlát Max: 270[W]

Terhelés (Ω)	Alsó határérték	Névleges	Felső határ
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Névleges teljesítménygörbe 270 watt kimeneti teljesítmény névleges terhelésnél a teljesítménygörbe-mérő áram/feszültség határértékének megfelelően. A teljesítménygörbe azt a burkológörbét ábrázolja, amely üzemi állapotban változik.


Alapvető bipoláris kimenet teljes teljesítmény-terhelés görbéje

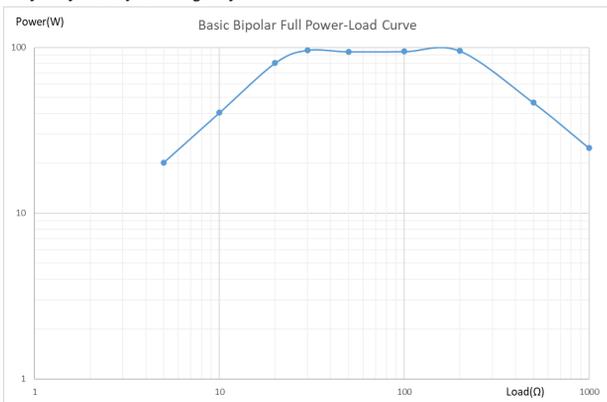

Teljes teljesítménygörbe határérték [W]: 95 Watt: Maximális teljesítmény 95 watt

Terhelés (Ω)	Alsó határérték	Névleges	Felső határ
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Alapvető bipoláris kimenet fél teljesítmény-terhelés görbe

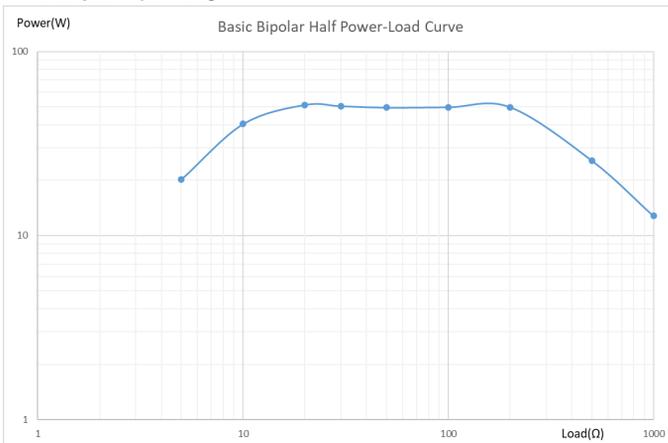

Fél teljesítménygörbe határérték [W]: Teljesítmény 50 watt

Terhelés (Ω)	Alsó határérték	Névleges	Felső határ
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Kimeneti teljesítmény vs. teljesítménybeállítások normál kétpólusú teljesítmény esetén

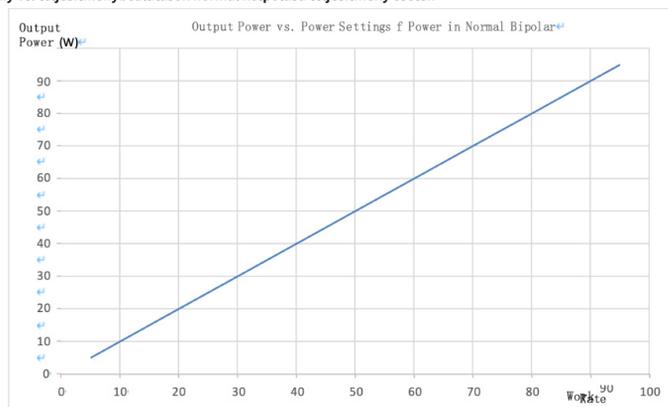

Kimeneti teljesítmény vs. teljesítmény-beállítási érték normál kétpólusú [W]; terhelés: 200Ω

Beállított teljesítmény (W)	Kimeneti teljesítmény alsó határérték (W)	Névleges teljesítmény (W)	Felső kimeneti teljesítményhatár (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Szerviz és garancia

A Reach Surgical, Inc. garantálja, hogy ez a termék normál használat és megelőző karbantartás mellett az alábbiakban meghatározott jótállási időszakban mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A Reach Surgical e garancia szerinti kötelezettsége a Reach Surgical, Inc. vagy a Reach Surgical, Inc. vagy annak meghatalmazott forgalmazójához a vonatkozó garanciaidőn belül visszaküldött és a Reach Surgical meglegedésére hibásnak bizonyult hibás termék vagy alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik, saját választása szerint. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a termékekre vagy alkatrészekre, amelyeket:

- A Reach Surgical, Inc. által nem engedélyezett felek által gyártott vagy forgalmazott, nem engedélyezett eszközökkel való használat miatt hátrányosan érintett.
- A Reach Surgical gyárán kívül javítják vagy módosítják, ha az befolyásolja a készülék stabilitását vagy megbízhatóságát a Reach Surgical által meghatározottak szerint.
- Nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság vagy baleset következtében.
- A termék tervezésével, használati paramétereivel, utasításaival és irányelveivel vagy a hasonló termékekre vonatkozó, az iparágban elfogadott funkcionális, működési vagy környezetvédelmi szabványokkal összeegyeztethetetlen módon használják.

Jótállási időszakok

Bipoláris energia alapcsatlakozó (OP-BPC): 1 év az alkatrészekre és a munkadíjra.

Generátora (OP9): 1 év az alkatrészekre és a munkára.

Lábkapcsoló/tápkábel: 1 év az alkatrészekre és a munkára.

Ez a garancia az eredeti vásárló kizárólagos jogorvoslat, és minden más, kifejezett vagy hallgatóság garancia helyébe lép, beleértve az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is. A Reach Surgical, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen különleges, véletlen vagy következményes kárért, beleértve a használat, a nyereség, az üzlet vagy a jó hírnév elvesztéséből eredő károkat, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten előírják.

A Reach Surgical, Inc. nem hatalmaz fel senkit arra, hogy termékeinek értékesítésével vagy használatával kapcsolatban további felelősséget vállaljon. Nincs olyan szavatosság, amely az itt megadott feltételeken túlmutatna.

A Reach Surgical, Inc. fenntartja a jogot, hogy változtatásokat eszközöljön termékein anélkül, hogy kötelezettséget vállalna arra, hogy ezeket a változtatásokat visszamenőlegesen alkalmazza a korábban értékesített vagy gyártott termékekre.

Panoramica

Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente le seguenti informazioni. Esse forniscono importanti istruzioni sul corretto funzionamento, sui potenziali rischi e sui possibili danni al prodotto o alle persone. In caso di situazioni anomale, seguire le istruzioni specificate per evitare danni a se stessi o all'apparecchiatura. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza, le prestazioni, la garanzia o la manutenzione, per cui il produttore non può essere ritenuto responsabile. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere anche le istruzioni per il Trasduttore e le Forbici ad Ultrasuoni. Questo documento è stato concepito come ausilio per l'utilizzo del dispositivo. Non è un riferimento per le tecniche chirurgiche.

Convenzioni standard utilizzate: Dichiarazioni di Attenzione, AVVERTENZA e Nota

Tenere presente le seguenti indicazioni, classificate come ATTENZIONE, AVVERTENZA o NOTA, che forniscono indicazioni essenziali per completare le operazioni in modo sicuro e completo. Queste indicazioni si trovano in tutta la documentazione e devono essere lette prima di passare alla fase successiva di una procedura.

AVVERTENZA: questa dichiarazione evidenzia una procedura, una pratica o una condizione di funzionamento o di manutenzione che, se non viene seguita scrupolosamente, può causare lesioni personali o morte.

ATTENZIONE: questa indicazione avverte l'utente di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate all'utente o al paziente, nonché danni all'apparecchiatura o ad altri beni. Può anche servire come avvertimento contro pratiche non sicure. Questo include le precauzioni necessarie per un uso sicuro ed efficace dello strumento e la cura richiesta per prevenire i danni derivanti da un uso corretto o improprio.

NOTA: questa affermazione indica una pratica operativa o una condizione essenziale per eseguire un compito in modo efficiente.

Descrizione

Lo strumento elettrochirurgico ENER REACH (di seguito denominato "il dispositivo") viene utilizzato nelle sale operatorie mediche per le procedure chirurgiche di taglio, coagulazione dei tessuti umani e legatura dei vasi. È dotato di due slot separati: uno per l'energia ultrasonica e l'altro per l'emissione di forme d'onda a radiofrequenza.

In modalità radiofrequenza, il generatore eroga schemi energetici diversi a seconda dello strumento/dispositivo di elettrochirurgia collegato. Quando è collegato uno strumento bipolare avanzato, il generatore eroga forme d'onda RF per la sigillatura di vasi arteriosi e venosi, linfatici e fasci di tessuto fino a 7 mm di diametro. Quando è collegato uno strumento bipolare di base, viene emessa energia a potenza costante per il taglio e la coagulazione dei tessuti molli.

In modalità di emissione di energia ultrasonica, utilizzando il trasduttore TRA6 in combinazione con i Bisturi ad Ultrasuoni monouso CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, il dispositivo taglia i tessuti molli che richiedono un controllo del sanguinamento e un danno termico minimo e sigilla i vasi fino a un diametro massimo di 5 mm. Se collegato ai Forbici ad Ultrasuoni monouso SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 e SRE45, il dispositivo taglia i tessuti molli che richiedono un controllo del sanguinamento e un danno termico minimo e sigilla i vasi fino a un diametro massimo di 7 mm.

Uso previsto

Il dispositivo fornisce energia a radiofrequenza per azionare manipoli elettrochirurgici destinati a tagliare e sigillare vasi e a tagliare, afferrare e sezionare tessuti.

Inoltre, il generatore fornisce energia ultrasonica per azionare gli strumenti chirurgici a ultrasuoni, indicati per le incisioni dei tessuti molli quando si desidera controllare il sanguinamento e ridurre al minimo il danno termico.

Indicazioni

Il dispositivo fornisce energia a radiofrequenza per azionare manipoli elettrochirurgici che vengono utilizzati durante interventi a cielo aperto o laparoscopici in chirurgia generale, pediatrica, ginecologica, urologica e toracica per tagliare e sigillare vasi fino a 7 mm inclusi e per tagliare, afferrare e sezionare tessuti.

Inoltre, il generatore fornisce l'energia per azionare gli strumenti chirurgici a ultrasuoni, indicati per le incisioni dei tessuti molli quando si desidera controllare il sanguinamento e ridurre al minimo il danno termico. Gli strumenti chirurgici a ultrasuoni possono essere utilizzati in aggiunta o in sostituzione dell'elettrochirurgia, del laser e dei bisturi ad Ultrasuoni per tagliare e/o coagulare i tessuti negli interventi chirurgici a cielo aperto o in quelli laparoscopici in ambito generale, pediatrico, ginecologico, urologico, toracico e per la sigillatura e la resezione dei vasi linfatici.

Utente previsto

Il dispositivo è destinato all'uso da parte di operatori sanitari per applicazioni chirurgiche.

Ambiente di utilizzo previsto

Il dispositivo è destinato all'uso in ospedale.

Popolazione di pazienti prevista

Questo dispositivo è indicato per i pazienti a partire dai 3 anni di età che necessitano di interventi chirurgici che comportano incisioni sui tessuti molli con controllo del sanguinamento e lesioni termiche minime.


Beneficio clinico

Il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro ed efficace per la legatura e la divisione di vasi, fasci di tessuto e linfatici.

Controindicazioni

Questo dispositivo è controindicato per incisioni ossee, occlusione delle tube contraccettive e procedure di coagulazione. Inoltre, non è destinato all'uso in neurochirurgia.

Composizione del sistema

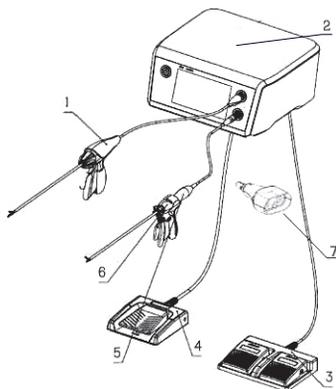

[01] Manipoli per Elettrochirurgia	[02] Generatore OP9
[03] Comando a Pedale per Ultrasuoni	[04] Comando a Pedale per Elettrochirurgia
[05] Trasduttore	[06] Forbici ad Ultrasuoni
[07] Connettore bipolare per elettrochirurgia	

[01] Manipolo elettrochirurgico

Il manipolo elettrochirurgico, collegato a un generatore, viene azionato dal chirurgo durante l'intervento. Applica energia elettrochirurgica a radiofrequenza al tessuto tra le sue ganasce per coagulare o sigillare. Lo strumento comprende anche una lama per la divisione dei tessuti. Modello: OSA23, OSA37, OSA44. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni.

[02] Generatore OP9

Il generatore fornisce sia energia elettrochirurgica che energia per terapia a ultrasuoni attraverso porte di connessione separate per gli strumenti. È composto da uno chassis, un guscio, una scheda elettronica, un touch screen LCD, un interruttore di alimentazione e interfacce per il collegamento degli accessori.

Modello: OP9

[03] Comando a Pedale per Ultrasuoni

Utilizzato per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'energia ultrasonica con due interruttori ("MIN" e "MAX"). Modello: OP-FSD

[04] Comando a Pedale per Elettrochirurgia

Utilizzato per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'energia ad alta frequenza con un unico interruttore.

Modello: OP-FSS

[05] Trasduttore

Il Trasduttore converte l'energia elettrica proveniente da un Generatore compatibile in movimento meccanico per le lame dello strumento. È uno strumento riutilizzabile con una durata limitata. Il trasduttore non è sterile e deve essere sterilizzato secondo le istruzioni prima dell'uso. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del Trasduttore TRA6.

Modello: TRA6.

[06] Forbici ad Ultrasuoni

Le Forbici ad Ultrasuoni utilizzano il movimento meccanico del trasduttore e forniscono energia ultrasonica per il taglio o la coagulazione dei tessuti. Occorre prestare attenzione poiché la vibrazione meccanica non è rilevabile e potrebbe involontariamente colpire aree non mirate. I Forbici ad Ultrasuoni sono sterilizzati con ossido di etilene. Se la durata di conservazione viene superata o la confezione di sterilizzazione è danneggiata, i Forbici ad Ultrasuoni non devono essere utilizzati e devono essere smaltiti. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni dei Forbici ad Ultrasuoni.

Le seguenti Forbici ad Ultrasuoni sono compatibili con il generatore OP9:

Serie PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Serie SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Serie SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Connettore bipolare per elettrochirurgia

Utilizzato per collegare gli strumenti elettrochirurgici bipolari di base al generatore per la coagulazione dei tessuti.

Modello: OP-BPC

Pannello frontale del Generatore

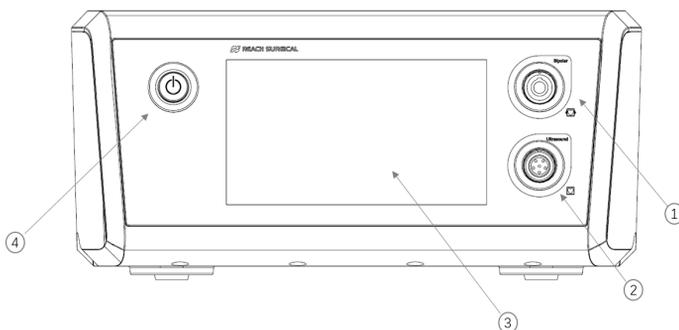

[01] Presa elettrochirurgica

Utilizzato per collegare strumenti elettrochirurgici bipolari avanzati o connettore bipolare per elettrochirurgia.

[02] Presa del Trasduttore


Collega il Trasduttore al Generatore.

[03] LCD touch screen

Visualizza le informazioni sul sistema e funge da interfaccia per la regolazione dei comandi e delle impostazioni.

[04] Pulsante dell'interruttore di alimentazione

Premere per accendere il Generatore; tenere premuto per spegnerlo.

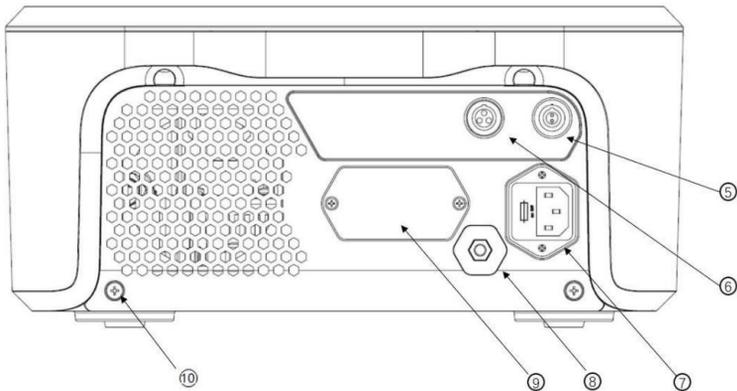Pannello posteriore del Generatore**[05] Presa a pedale elettrochirurgica**

Presca rotonda per il collegamento dell'interruttore a pedale elettrochirurgico.

[06] Presa a pedale elettrochirurgica

Presca rotonda per il collegamento dell'interruttore a pedale a ultrasuoni.

[07] Presa di corrente

Collega il cavo di alimentazione al Generatore.

[08] Porta di equalizzazione del potenziale

Se la messa a terra della presa di corrente è incerta, questa porta consente il collegamento alla terra protetta.

[09] Interfaccia di espansione

Utilizzato per l'espansione e la manutenzione delle funzioni.

[10] Foro di montaggio**Istruzioni per l'uso**

Fare riferimento alle linee guida fornite per l'ambiente operativo.

Disimballaggio

Seguire le istruzioni per la ricezione dei componenti riportate di seguito.

- Verificare la presenza di eventuali danni visibili dovuti al trasporto. Se si riscontrano danni, contattare Reach Surgical, Inc. o l'agente locale per assistenza.

Componenti inclusi nel (Per le specifiche tecniche dettagliate e i codici prodotto, consultare il capitolo "Condizioni tecniche del sistema"):

Modello	Descrizione	Componente
OP9	Generatore	Generatore, Cavo di alimentazione, Istruzioni
TRA6	Trasduttore	Trasduttore con Cavo
OP-FSD	Interruttore a pedale a ultrasuoni	/
OP-FSS	Interruttore a pedale bipolare	/
OP-BPC	Connettore di energia bipolare di base	/

Precauzioni di sicurezza

- Durante l'ispezione dell'apparecchiatura, tenere l'estremità distale dello strumento lontano da altri apparecchi, dai teli chirurgici, dal paziente o da altri oggetti per evitare lesioni.
- Attuare le misure di sicurezza necessarie in presenza di vapori, seguendo le procedure e le normative ospedaliere.

Energia a ultrasuoni con le Forbici ad Ultrasuoni della serie PD

- Collegare il trasduttore, l'interruttore a pedale e la Forbice ad Ultrasuoni serie PD al generatore.
- Dopo aver superato il test del trasduttore e della Forbice ad Ultrasuoni, regolare il livello di potenza (1-5) utilizzando le icone +/- sullo schermo LCD.
- Premere il pulsante 'Min' sulla Forbice ad Ultrasuoni o il pedale Min sull'interruttore a pedale per attivare l'energia ultrasonica al livello di potenza preimpostato.
- Premere il pulsante 'Max' sulla Forbice ad Ultrasuoni o sull'interruttore a pedale per erogare il massimo livello di energia.
- Rilasciare il tasto o l'interruttore a pedale per interrompere l'emissione di energia.

Energia a ultrasuoni con le Forbici ad Ultrasuoni della Serie SRB/SRE

- Dopo aver superato il test del trasduttore e della Forbice ad Ultrasuoni, regolare il livello di potenza (1-5) utilizzando le icone +/- sullo schermo LCD.
- Premere il Pulsante di erogazione energia sullo strumento o il pulsante Min sul pedale per attivare l'energia ultrasonica al livello di potenza preimpostato.

- Premere il Pulsante di erogazione di energia con Emostasi Avanzata sullo strumento per attivare la modalità Pulsante di erogazione avanzato.
- Rilasciare il pulsante delle Forbici ad Ultrasuoni o il pulsante dell'interruttore a pedale per interrompere l'erogazione di energia.

Energia elettrochirurgica bipolare con strumenti bipolari avanzati

- Il display LCD mostra l'icona del bipolare avanzato e l'icona della pulsantiera regolabile.
- Tirare la Leva sullo strumento o premere il pedale dell'interruttore a pedale per attivare la frequenza radio.
- Il generatore interromperà la produzione di energia quando la chiusura sarà completata, come indicato dall'icona di completamento sullo schermo.
- Se la legatura è incompleta, viene emesso un segnale acustico di avvertimento e viene visualizzata un'icona di avvertimento.

Energia elettrochirurgica bipolare con strumenti elettrochirurgici bipolari

- Lo schermo LCD visualizza il valore di potenza, le icone regolabili e le barre del livello di potenza.
- Le impostazioni di potenza variano da 1 a 95 watt, con incrementi regolabili.
- Selezionare l'impostazione di potenza desiderata: Bassa (15 watt), Media (30 watt) o Alta (60 watt).
- Premere il pulsante dell'interruttore manuale o del pedale per attivare la frequenza radio.
- Rilasciare il pulsante per disattivare l'emissione di energia.

Raccomandazioni per l'impostazione

Impostazioni dell'effetto	Gamma delle impostazioni di potenza	Applicazione clinica	Dispositivo ottimizzato
Basso	1-15 watt	Come ad esempio nervi/spina, mani e chirurgia facciale	- Dispositivi con superfici ridotte - Pinze microtip (0,4 - 2,2 mm)
Medio	16-40 watt	Come ad esempio la coagulazione durante il trattamento della testa/collo, della colonna vertebrale e dell'anatomia.	- Dispositivi con superficie media - Pinze microtip (1,0 - 2,2 mm) - Pinza laparoscopica a testa piatta di piccole dimensioni - Forbici bipolari
Alto	45-95 watt (incrementi di 5 watt)	Come la chirurgia della testa/collo e la chirurgia plastica (simile all'effetto medio, ma con effetto più rapido)	- Dispositivi con grandi superfici - Pinza laparoscopica a testa piatta di grandi dimensioni

NOTA: Questo dispositivo non è compatibile con l'elettrodo neutro.

NOTA: i Forbici ad Ultrasuoni e il Bisturi elettrico RF sono parti applicate a contatto con il paziente.


Utilizzo del generatore

Accendere il dispositivo

- Una volta acceso, il sistema è pronto per il funzionamento. Quando il generatore è collegato alla rete elettrica e la spia dell'interruttore di standby è accesa, il sistema è pronto per l'uso.
- Dopo aver premuto il pulsante Standby, viene visualizzata la seguente immagine:



- Se al Generatore non è collegato alcun Trasduttore o Forbice ad Ultrasuoni, o se sono collegati in modo errato, verrà visualizzata la seguente immagine:




Utilizzo dello strumento a ultrasuoni (Trasduttore e Forbice ad Ultrasuoni)


Quando vengono rilevati il trasduttore e i Forbici ad Ultrasuoni, viene visualizzata la seguente immagine.




NOTA: se il numero di utilizzi rimanenti del Trasduttore è inferiore a 10, verrà visualizzata la seguente immagine. Prestare attenzione al numero di utilizzi rimanenti, poiché il Trasduttore deve essere sostituito quando il numero diventa zero.

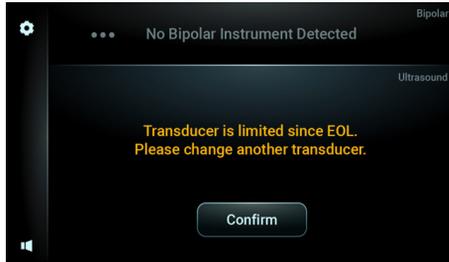


Verrà quindi visualizzata la seguente immagine; verrà chiesto di premere un pulsante qualsiasi della Forbice ad Ultrasuoni per avviare il test Forbici ad Ultrasuoni con le Ganasce aperte.

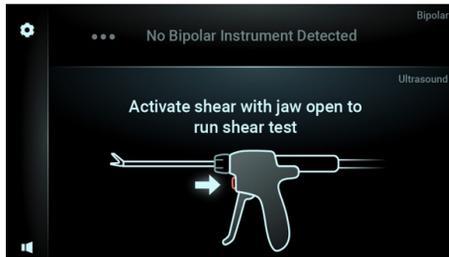

Premendo il tasto qualsiasi, verrà visualizzata la seguente immagine.

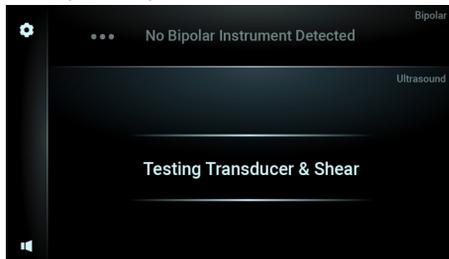


Se il test del trasduttore non riesce, viene visualizzata la seguente immagine:

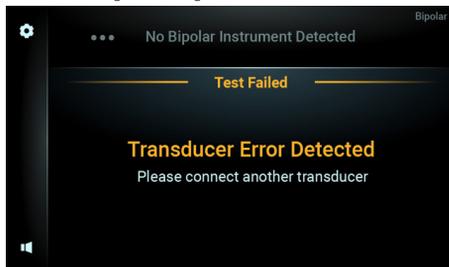

Quando il test Forbice ad Ultrasuoni fallisce, viene visualizzata l'immagine seguente



Quando il trasduttore e il test Forbici ad Ultrasuoni sono stati superati, viene visualizzata la seguente immagine:

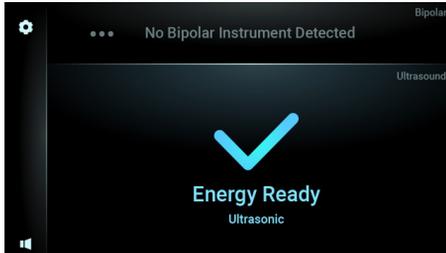

Quando si collegano Forbici ad Ultrasuoni senza la funzione Emostasi avanzata, viene visualizzata la seguente schermata di lavoro.




Quando si collegano i Forbici ad Ultrasuoni SRE con l'Emostasi Avanzata, viene visualizzata la seguente schermata di lavoro.




La modalità di uscita sarà evidenziata come attivata.

Utilizzo di strumenti elettrochirurgici


Quando vengono rilevati il trasduttore e i Forbici ad Ultrasuoni, viene visualizzata la seguente immagine.

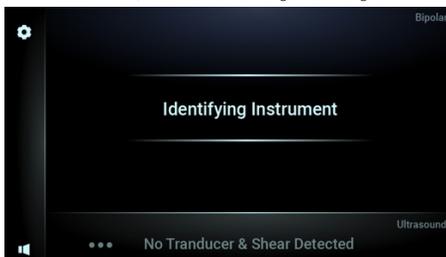

Quando il test dello strumento elettrochirurgico viene superato, viene visualizzata la seguente immagine:

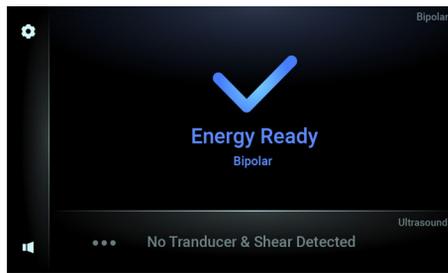

Quando si collega uno strumento bipolare avanzato, viene visualizzata la seguente schermata di lavoro.




Quando si collega un normale strumento bipolare, viene visualizzata la seguente schermata di lavoro.




Utilizzo di strumenti elettrochirurgici e Forbici ad Ultrasuoni

Si noti che quando il generatore è collegato sia a uno strumento elettrochirurgico bipolare che a un Forbice ad Ultrasuoni, il sistema funziona in modalità split-screen per visualizzare lo stato corrente. Il dispositivo che ha la priorità sarà il primo ad attivare l'energia. Questo stato di split-screen è mostrato di seguito:

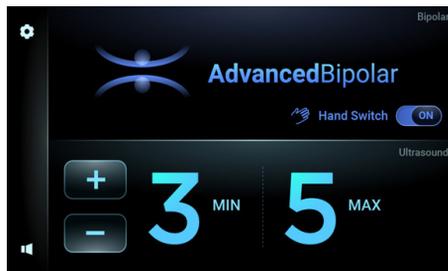

Impostazioni di sistema

Per accedere alle impostazioni del sistema, fare clic sull'icona delle impostazioni situata nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione del sistema:

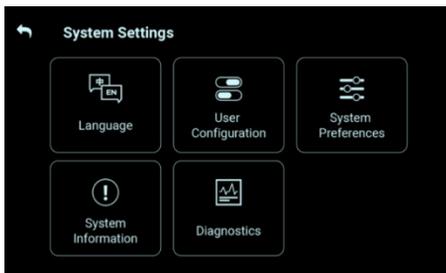


Lingua: Facendo clic sulla voce Lingua si visualizza la schermata di selezione della lingua:




Configurazione utente: Facendo clic sulla voce Configurazione utente, viene visualizzata la schermata di configurazione dell'utente:




Preferenze di sistema: Facendo clic sulla voce Preferenze di sistema si visualizza la schermata delle preferenze di sistema:

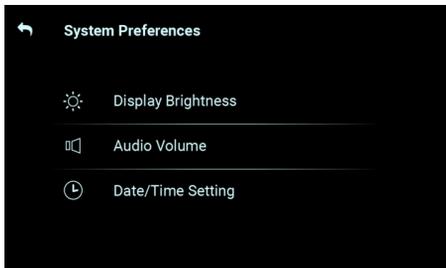

Informazioni sul sistema: Cliccare delicatamente sulla voce Info sistema per visualizzare la schermata delle informazioni sul sistema:

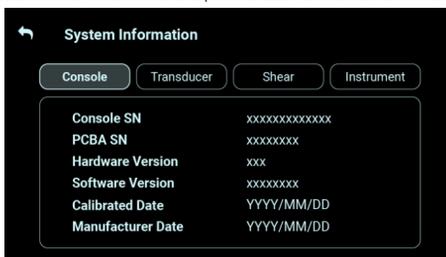

Diagnostica: Facendo clic sulla voce Diagnostica si visualizza la schermata di diagnostica:

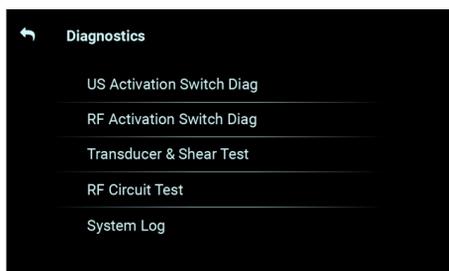

Per uscire dalle impostazioni del sistema e tornare alla modalità di standby, premere l'icona "Indietro" nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Spegnimento del sistema

Seguire la procedura descritta di seguito per spegnere il sistema in modo sicuro:

Premere il pulsante Standby: Individuare il pulsante di standby sul Generatore e premerlo per avviare il processo di spegnimento.

Scollegare il Trasduttore e la Forbice ad Ultrasuoni: Scollegare con cura il Trasduttore e la Forbice ad Ultrasuoni dal sistema. Per la corretta Impugnatura del Trasduttore e della Cesoia ad Ultrasuoni, consultare le istruzioni per l'uso.

Pulizia: Pulire il Generatore, il Comando a Pedale e il Trasduttore secondo le procedure specificate nel capitolo "Manutenzione".

Risoluzione dei problemi

Il Generatore incorpora vari segnali di allarme e codici di errore per facilitare l'identificazione e la diagnosi dei guasti dei componenti. È importante notare che questi segnali e codici sono progettati per supportare il giudizio clinico e l'osservazione, piuttosto che sostituirli.

Allarme sonoro

Stato di lavoro	Tipo di suono	Possibile causa e azione
Stato dell'autoverifica	Suono normale	/
	Suono anomalo	È stato rilevato un guasto hardware. Contattare il produttore per assistenza alla riparazione.
Utilizzo dello strumento a ultrasuoni	Livello massimo di suono	/
	Livello minimo di suono	/
	Suono anomalo	La Forbice ad Ultrasuoni è entrata in contatto con un eccesso di tessuto. Ridurre il contatto del tessuto con la forbice ad Ultrasuoni. Se persiste un suono continuo, rimuovere con cura il tessuto che potrebbe essersi accumulato intorno all'estremità della Forbice ad Ultrasuoni. È stato rilevato un errore nel Trasduttore e/o nella Forbice ad Ultrasuoni. Consultare il produttore o contattare l'assistenza per ulteriore assistenza.
	Suono avanzato	/
	Suono ITS	/
Attivazione dello strumento elettrochirurgico	Segnale di avviso bipolare avanzato	/
	Suono bipolare normale	/
	Suono anomalo	Taglio non riuscito: Se il tessuto a contatto con lo strumento non soddisfa i requisiti di taglio, ridurre la quantità di tessuto a contatto con lo strumento. Se il tono di errore persiste, eliminare con cura il tessuto che potrebbe accumularsi all'estremità dello strumento. Guasto hardware: Questo errore indica un potenziale guasto nel circuito o nel connettore. In caso di guasti o errori, si raccomanda di consultare il produttore o di richiedere assistenza per ottenere indicazioni e soluzioni adeguate.

Codici di errore

Il Generatore di Piattaforme Energetiche è dotato di un sistema completo di identificazione dei guasti che comprende avvisi ed errori di sistema. Quando viene rilevato un guasto, il generatore emette un segnale acustico, visualizza un segnale di avviso sul pannello di controllo e mostra un codice di guasto corrispondente sullo schermo LCD. Seguire la procedura descritta di seguito per risolvere il problema:

Tabella dei codici di errore

Codice di errore	Messaggio di errore corrispondente
Avvertenze	Collegare correttamente i Forbici ad Ultrasuoni con il Trasduttore
Avvertenze	Assicurarsi che le Ganasce siano aperte durante il test.
Avvertenze	Rilevato errore di taglio Forbice ad Ultrasuoni
Avvertenze	Il tempo residuo del Trasduttore è pari a zero.
Avvertenze	Attivare solo un pulsante alla volta
Avvertenze	Ridurre la forza applicata al Forbice ad Ultrasuoni
Avvertenze	Il pulsante Forbice ad Ultrasuoni e l'interruttore a pedale non possono essere chiusi simultaneamente
Avvertenze	Pulsante bloccato, controllare e continuare
Avvertenze	Regolare le Ganasce o pinzare meno tessuto
Avvertenze	Rimuovere il dispositivo dai tessuti
Errore di sistema	Errore di sistema
Errore di sistema	Autoverifica fallita

Se durante il test viene visualizzato un errore sullo schermo, eseguire le seguenti operazioni:



- Assicurarsi che il cavo del Trasduttore sia completamente inserito nella direzione corretta.
- Controllare se la Forbice ad Ultrasuoni è stata serrata correttamente o se si è accumulato del tessuto intorno all'estremità della Forbice ad Ultrasuoni.
- Regolare il serraggio della cesoia a ultrasuoni e rimuovere con cura eventuali accumuli di tessuto intorno all'involucro della cesoia a ultrasuoni. (Se il test viene avviato prima dell'operazione, assicurarsi che la Forbice ad Ultrasuoni sia rivolta verso l'aria. Se si utilizzano Forbici ad Ultrasuoni, verificare che la ganaschia sia aperta e non sia a contatto con oggetti).
- Se il problema persiste, sostituire il Trasduttore o la Forbice ad Ultrasuoni.
- Procedere alla modalità di lavoro dell'apparecchiatura.

NOTA: Il Trasduttore potrebbe non funzionare correttamente se la sua temperatura supera il limite specificato. In questi casi, utilizzare immediatamente un altro Trasduttore per il recupero o seguire i passaggi seguenti per determinare la causa dell'errore ed esplorare i metodi di recupero opzionali:

- Lasciare raffreddare il Trasduttore a temperatura ambiente per almeno 45 minuti. Questo metodo di raffreddamento si applica anche se il Trasduttore diventa caldo dopo un funzionamento prolungato ad alta potenza.
- Se il surriscaldamento del Trasduttore non è evidente e il problema rimane irrisolto, contattare i rappresentanti della manutenzione del produttore per assistenza.
- A parte i fusibili, il Generatore non contiene parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi necessità di sostituzione o assistenza, rivolgersi al personale di assistenza addestrato e autorizzato da Reach Surgical, Inc. o al rappresentante locale.

La manutenzione e gli aggiornamenti del Generatore devono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato e autorizzato da Reach Surgical.

È necessario prendere in considerazione le precauzioni di cybersecurity per prevenire le potenziali minacce. I seguenti incidenti comportano rischi per la sicurezza informatica:

- Accesso non autorizzato a qualsiasi prodotto non correlato al dispositivo.
- Qualsiasi comunicazione di rete non autorizzata con il dispositivo.
- Aggiornamenti di firmware o software non autorizzati da Reach Surgical.

In caso di uno dei suddetti incidenti, si prega di contattare il rappresentante commerciale di Reach Surgical, Inc. o di contattare direttamente Reach Surgical, Inc. all'indirizzo Reachquality@reachsurgical.com.

Manutenzione

Pulizia e disinfezione del generatore e del Connettore di energia bipolare di base

Pulizia

Pulire lo schermo LCD del Generatore e il connettore bipolare di base in conformità alle procedure e alle normative ospedaliere. Prima della pulizia, assicurarsi che l'alimentazione principale del Generatore sia scollegata e che il cavo di alimentazione sia rimosso dall'unità di uscita.

AVVERTENZA: Le procedure di pulizia devono essere seguite attentamente per evitare di danneggiare il Generatore, di provocare scosse elettriche o di creare un rischio di incendio. Non versare o spruzzare liquidi sul Generatore, né immergerlo in liquidi.

Per la pulizia, attenersi alla seguente procedura:

- Preparare un detergente a pH neutro o un detergente enzimatico a pH neutro come specificato dal produttore del detergente.
- Con un panno morbido e pulito imbevuto di una piccola quantità di soluzione detergente, pulire manualmente tutte le superfici, compreso lo schermo del Generatore.
- Pulire tutte le superfici con un panno pulito e morbido imbevuto di acqua calda di rubinetto.
- Infine, passare un panno morbido e pulito su tutte le superfici per assicurarsi che siano asciutte.

Disinfezione

- Se il generatore viene contaminato da sangue o fluidi corporei, deve essere disinfettato prima di essere riutilizzato. I seguenti disinfettanti chimici sono stati convalidati per l'uso sul generatore: alcol isopropilico al 70%, ipoclorito di sodio al 6%, perossido di idrogeno al 10%.
- Seguire le raccomandazioni del produttore per l'uso corretto, la concentrazione e il tempo di contatto dei disinfettanti.
- Assicurarsi che i disinfettanti siano configurati e utilizzati secondo le istruzioni del produttore.

Pulizia del Comando a Pedale

Pulire il Comando a Pedale e il cavo dopo ogni utilizzo utilizzando la seguente procedura:

- Scollegare il Comando a Pedale dal Generatore.
- Preparare un detergente enzimatico a pH neutro come indicato dal produttore.
- Collegare saldamente il cavo con il Comando a Pedale e immergerli nella soluzione detergente per 2 minuti.

NOTA: Assicurarsi che il cavo del Comando a Pedale utilizzato per collegare il Generatore sia completamente asciutto per evitare attivazioni accidentali.

● Dopo l'immersione, strofinare manualmente il Comando a Pedale e il cavo con una spazzola a setole morbide nella soluzione detergente.

● Sciacquare accuratamente il Comando a Pedale e il cavo con acqua calda del rubinetto per almeno 1 minuto.

ATTENZIONE: durante il risciacquo, mantenere il cavo e il Comando a Pedale saldamente collegati.

● Pulire tutte le superfici con un panno morbido e pulito.

AVVERTENZA: non utilizzare una macchina per la pulizia a ultrasuoni per pulire il Comando a Pedale.

AVVERTENZA: Non inserire l'alimentazione del Generatore prima di aver collegato il cavo di alimentazione CA. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano asciutti prima del montaggio.

Pulizia e disinfezione del Trasduttore

I Trasduttori vengono spediti non sterili e richiedono un'accurata pulizia e sterilizzazione prima di ogni utilizzo. **Detersione:**

Detergere profondamente il Trasduttore seguendo i passaggi indicati di seguito:

- Risciacquare il Trasduttore con il lato della vite verso l'alto e pulire con una spazzola a setole morbide con acqua purificata fino a quando non ci sono più tracce sulla superficie;
- Il Trasduttore può essere immerso in detergente enzimatico a pH neutro (principali ingredienti: proteasi, lipasi, amilasi, cellulasi, pectinasi e altri

enzimi biologici, surfattante ecologico, anticorrosivi e stabilizzatori) per un lasso di tempo fino a 10 minuti ed a temperatura appropriata, nell'intervallo 15°C-65°C. La diluizione del detergente in acqua purificata è di 1:400;

- Sciacquare il Trasduttore mantenendo la filettatura verso l'alto, usando acqua purificata, per 2 minuti;
- Pulire le vite di connessione, la superficie di assemblaggio del Bisturi e il connettore con una garza imbevuta di alcool.
- Immergere il Trasduttore in alcool al 75% ad uso medicale, mantenerlo immerso e scuoterlo per 30 volte.
- Sciacquare il Trasduttore mantenendo la filettatura verso l'alto, utilizzando acqua purificata, per 2 minuti.

Nota: l'impiego di dispositivi per la pulizia ad ultrasuoni non è consigliato per la detersione del Trasduttore.

Asciugatura:

Temperatura di asciugatura: 50-70°C, Tempo di asciugatura: 30 min.

Sterilizzazione del Trasduttore:

Dopo aver seguito le indicazioni per la detersione e l'asciugatura sopra riportate, il Trasduttore deve essere sterilizzato seguendo uno dei metodi indicati di seguito.

Sterilizzazione a vapore(121°C)

- Installare la Guaina prima della sterilizzazione. Il Trasduttore dovrebbe essere imbustato durante la sterilizzazione. Posizionare il Trasduttore all'interno di un contenitore per sterilizzazione a vapore ad alta temperatura e sterilizzare con ciclo a 121°C con durata 30 min.
- Temperatura di asciugatura:50-70°C, Tempo di asciugatura: 30 min.

Sterilizzazione a vapore(134°C)

- Installare la Guaina prima della sterilizzazione. Il Trasduttore dovrebbe essere imbustato durante la sterilizzazione. Posizionare il Trasduttore all'interno di un contenitore per sterilizzazione a vapore ad alta temperatura, e sterilizzare con ciclo a 134°C con durata 10 min.
- Temperatura di asciugatura: 50-70°C, Tempo di asciugatura: 30 min.

Test di sicurezza e funzionali

Assicurare l'esecuzione di test di sicurezza e funzionali per il Trasduttore, il Generatore e il Comando a Pedale in conformità alle procedure e alle normative ospedaliere. Per i test di sicurezza e di funzionamento di altri componenti utilizzati da più pazienti, fare riferimento alle istruzioni operative specifiche di ciascun componente.

Test di sicurezza

Generatore: I tecnici ospedalieri certificati devono eseguire un test della corrente di dispersione.

Comando a Pedale: Ispezionare il pedale, il connettore del cavo e il cavo per verificare che non vi siano crepe o danni. Sostituire i componenti danneggiati.

Altri componenti: Controllare tutti gli altri componenti come indicato nelle rispettive istruzioni per l'uso.

Test funzionale

Modalità a ultrasuoni

Preparare il set completo di Forbici ad Ultrasuoni PD e collegare il Trasduttore seguendo le istruzioni fornite nel Capitolo II - Installazione e funzionamento dell'apparecchiatura.

- Verificare se è possibile accedere allo stato di lavoro. Forbici ad Ultrasuoni diverse possono avere interfacce di ingresso diverse. Per istruzioni dettagliate, consultare la Parte 1, Sezione 3 del Capitolo 2.
- Confermare la visualizzazione di MIN power Level 3 e MAX power Level 5.
- Premere i pulsanti di aumento e diminuzione della potenza per assicurarsi che il livello di potenza MIN possa essere regolato dai livelli 1 e 5.
- Accendere il generatore e passare alla modalità di lavoro a ultrasuoni. Verificare il corretto collegamento del trasduttore e della Forbice ad Ultrasuoni.
- Con la ganascia aperta, premere il pulsante "MAX" sull'interruttore a pedale. Sullo schermo LCD viene visualizzato il livello di potenza MAX "5" e viene emesso un segnale acustico di attivazione.
- Con la ganascia aperta, premere il pulsante "MIN" sull'interruttore a pedale. Sullo schermo LCD viene visualizzato il livello di potenza MIN e viene emesso un segnale acustico di attivazione.

AVVERTENZA: prima di attivare il sistema, assicurarsi che la Ganascia sia lontana da tessuti, altri strumenti o altri oggetti per evitare lesioni all'utente.

Modalità elettrochirurgica bipolare

- Collegare lo strumento elettrochirurgico bipolare avanzato/stumento bipolare di base secondo le istruzioni.
- Verificare se il sistema può accedere all'interfaccia di lavoro. La modalità bipolare di base deve visualizzare l'icona del livello di potenza 30, mentre la modalità bipolare avanzata deve visualizzare l'icona "advanced bipolar".
- Sforare leggermente i tasti di incremento e decremento della potenza in modalità bipolare di base per confermare che il livello di potenza può essere regolato tra 1 e 95. Sforare le barre Bassa, Media e Alta per passare direttamente tra 15, 30 e 60.
- Spegnerne il generatore e attendere 5 secondi. Quindi, accendere l'alimentazione del generatore e attendere 10 secondi. Verificare se la modalità bipolare di base visualizza l'interfaccia del livello di potenza 30 e la modalità bipolare avanzata visualizza l'interfaccia "bipolare avanzato". Verificare se il generatore è attivato secondo i requisiti prestabiliti.
- Collegare gli strumenti elettrochirurgici bipolari avanzati e di base e premere l'interruttore singolo a pedale. Controllare che le indicazioni del livello di potenza lampeggino sul pannello di controllo e ascoltare il suono di attivazione.

AVVERTENZA: prima di attivare il sistema, è severamente vietato consentire il contatto della Forbice ad Ultrasuoni con tessuti, altri strumenti o altri oggetti per evitare lesioni all'utente.

Avvertenze e precauzioni

Sistema correlato

- Leggere le istruzioni prima dell'uso e seguire le linee guida ospedaliere per la pratica clinica della chirurgia a ultrasuoni, dell'elettrochirurgia, della ginecologia e della laparoscopia.
- I dispositivi miniminvasivi possono variare da produttore a produttore. Se in un intervento chirurgico vengono utilizzati contemporaneamente strumenti miniminvasivi e accessori di produttori diversi, prima dell'intervento verificare la compatibilità degli strumenti e degli accessori e controllare se gli accessori inseriti nel corpo umano presentano una superficie ruvida, un bordo affilato o una sporgenza che potrebbero causare rischi per la sicurezza.
- Questo dispositivo è destinato all'uso esclusivo da parte di chirurghi addestrati e autorizzati. Non utilizzare i dispositivi elettrochirurgici se non si è stati adeguatamente addestrati al loro uso per la procedura specifica da portare a termine. L'uso di questo dispositivo da parte di personale non addestrato può causare gravi lesioni al paziente, tra cui la perforazione dell'intestino e la necrosi inconscia e irreparabile dei tessuti.
- Non aprire l'involucro del generatore senza autorizzazione per evitare il rischio di scosse. Tutte le riparazioni e gli aggiornamenti dello strumento devono essere eseguiti da un tecnico addestrato e autorizzato da Reach Surgical, Inc. Non utilizzare questo strumento per scopi diversi dalla chirurgia medica.
- Una conoscenza approfondita dei principi e delle tecniche coinvolte nelle procedure laser, elettrochirurgiche e a ultrasuoni è essenziale per evitare rischi di scosse e ustioni per il paziente e il personale medico e danni a questo dispositivo o ad altri dispositivi medici. L'isolamento elettrico o la messa a terra non devono essere compromessi. Non immergere i dispositivi elettrochirurgici nei liquidi, a meno che il progetto non lo richieda e l'etichetta non indichi che devono essere immersi.
- La sicurezza e l'efficacia della chirurgia e dell'elettrochirurgia a ultrasuoni dipendono non solo dalla progettazione dell'apparecchiatura, ma anche da molti fattori controllati dall'operatore. Per migliorare la sicurezza e l'efficacia, leggere, comprendere e seguire le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo.

- Come per tutte le fonti di energia (elettrochirurgica, laser o ultrasuoni), occorre considerare i rischi cancerogeni e infettivi che molti sottoprodotti dei tessuti, come fumo e aerosol, possono presentare. Sia nelle procedure aperte che in quelle endoscopiche si devono osservare precauzioni adeguate, come occhiali di sicurezza, maschere di filtraggio e un'efficace attrezzatura per l'evacuazione dei fumi.
- Dopo aver rimosso il dispositivo, controllare che il tessuto sia emostatico. Se l'emostasi è assente, è necessario utilizzare metodi appropriati per raggiungere l'emostasi.
- I prodotti fabbricati o distribuiti da aziende non autorizzate da Reach Surgical, Inc. potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'uso di tali prodotti può portare a risultati imprevisti e può danneggiare l'utente o il paziente.
- Per ridurre il rischio di interferenze, il dispositivo e il guscio devono essere collegati a un circuito di alimentazione indipendente.
- L'apparecchiatura non è adatta all'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o protossido di azoto. Potenziale di scintille dovute alla collisione con altri dispositivi metallici. Le scintille possono incendiare gas infiammabili, come i gas di campo.
- Il sistema deve funzionare entro l'intervallo di temperatura ambiente richiesto.
- La tensione della presa di uscita deve soddisfare i requisiti del generatore (capitolo "Condizioni tecniche del sistema"). Se l'alimentazione non è collegata correttamente, può danneggiare il generatore e causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare prolunghe per evitare rischi di incendio.
- Non impostare il tono di attivazione su un livello non udibile. I toni di attivazione possono essere notati dal personale dell'équipe chirurgica mentre il generatore eroga energia.
- È stato dimostrato che il fumo generato durante elettrochirurgia è potenzialmente dannoso per i pazienti o per il personale dell'équipe chirurgica. Suggerire una ventilazione adeguata con un evacuatore di fumo chirurgico o altri mezzi.
- Alcuni componenti del Generatore integrato per chirurgia ad ultrasuoni vengono spediti non sterili (ad esempio, il Trasduttore). Sterilizzare il prodotto come richiesto prima di iniziare l'installazione del sistema. Per le istruzioni di pulizia e sterilizzazione, fare riferimento a ciascuna istruzione pertinente.
- Per evitare lesioni agli utenti o ai pazienti, il Forbice ad Ultrasuoni deve evitare altri dispositivi, teli chirurgici, pazienti o altri oggetti prima di premere il pulsante di prova e durante il controllo del sistema. Le misure di sicurezza in caso di aerosol (secondo le normative ospedaliere) devono essere implementate nel metodo di ispezione e test del sistema.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla mandibola per evitare di inibire l'erogazione dell'energia ultrasonica.
- Per evitare lesioni all'utente, la lama deve evitare il contatto con tessuti, altri dispositivi o altri oggetti prima di attivare il sistema.
- Se il liquido viene spruzzato o versato sul generatore o al suo interno, o se il generatore viene rovesciato o versato nel liquido, può danneggiare il generatore e causare scosse elettriche o incendi.
- Le scintille e il riscaldamento associati alle tecniche di chiusura dei vasi possono entrambi fuggire da fonti di accensione. Garze e spugne devono rimanere umide. Tenere gli elettrodi elettrochirurgici lontani da materiali combustibili e da ambienti ricchi di ossigeno (O2).
- In caso di danni significativi al Trasduttore o se alcune parti mostrano segni di danneggiamento dopo la manutenzione di pulizia e disinfezione, scartarle. Le parti danneggiate sono chiaramente contrassegnate per evitare un uso improprio prima della successiva Impugnatura.
- I rifiuti monouso e i rifiuti elettronici devono essere smaltiti secondo le norme ospedaliere e non devono essere gettati a piacimento per evitare l'inquinamento ambientale.
- Evitare di utilizzare il generatore vicino o impilato su altre apparecchiature. Se è necessario l'uso adiacente o impilato, monitorare il generatore e le altre apparecchiature per assicurarne il corretto funzionamento.
- Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'operatore. Per l'assistenza, contattare il rappresentante di Reach Surgical o il personale di assistenza.
- Controllare tutti i dispositivi collegati al sistema e le connessioni prima dell'uso. Verificare che il dispositivo funzioni come previsto. Un collegamento non corretto può provocare archi elettrici, scintille, malfunzionamenti del dispositivo o risultati chirurgici indesiderati.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata esclusivamente a un'alimentazione con messa a terra di protezione.
- Mantenere la massima distanza possibile tra il generatore e altri dispositivi elettronici (ad esempio, monitor). Non incrociare o legare i cavi elettrici ai dispositivi elettronici. Il generatore può causare interferenze con altri dispositivi elettronici.
- Il sistema deve essere utilizzato con cautela in presenza di pacemaker interni ed esterni. Le interferenze causate dall'uso di strumenti elettrochirurgici possono causare uno stato di asincronia del pacemaker o impedire completamente il funzionamento. Quando i dispositivi di elettrochirurgia o di sigillatura dei tessuti sono destinati all'uso in pazienti con pacemaker cardiaco, contattare il produttore del pacemaker o il reparto di cardiologia dell'ospedale per ulteriori informazioni.
- Prestare attenzione se si impiantano gli strumenti sopra il generatore o se si posiziona il generatore sopra gli strumenti elettrici. Si tratta di una configurazione instabile che non garantisce un raffreddamento adeguato.
- Il guasto del generatore può causare un'interruzione dell'attività chirurgica. Deve essere disponibile un sistema di backup.
- Se richiesto dalle normative locali, il generatore deve essere collegato al connettore equipotenziale dell'ospedale utilizzando un cavo equipotenziale.
- Quando il sistema e l'apparecchiatura di monitoraggio fisiologico vengono utilizzati contemporaneamente sullo stesso paziente, qualsiasi elettrodo di monitoraggio deve essere posizionato il più lontano possibile dallo strumento.
- In modalità bipolare di base, scegliere la potenza di uscita più bassa possibile per ottenere l'effetto desiderato.
- Il guasto di un'apparecchiatura chirurgica ad alta frequenza può causare un aumento imprevisto della potenza di uscita.
- Il generatore e il connettore elettrochirurgico bipolare di base possono essere invasi da acqua o particolato. Durante l'uso e la pulizia, è necessario evitare l'invasione di acqua o particolato.
- Quando il sistema viene utilizzato in combinazione con un endoscopio, può aumentare la corrente di dispersione sul corpo del paziente. Prestare attenzione durante la procedura.
- Un avviso all'utente e/o al paziente che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Reach Surgical, Inc. tramite Reachquality@reachsurgical.com. e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Strumento correlato

Durante le procedure chirurgiche, è importante sapere che la parte finale dello strumento Forbice ad Ultrasuoni, il cuscinetto per Forbici ad Ultrasuoni e l'asta possono raggiungere temperature elevate quando gli ultrasuoni o l'elettrocaterizzazione bipolare vengono applicati ai tessuti per periodi prolungati. Per garantire la sicurezza, è fondamentale evitare qualsiasi contatto accidentale tra questi componenti dello strumento e i tessuti, i teli chirurgici, i camicini chirurgici o qualsiasi altra area non correlata durante la procedura.

Inoltre, è fondamentale prestare attenzione al posizionamento dello strumento bipolare. In particolare, non deve essere posizionato vicino o a contatto con materiali combustibili come garze o teli chirurgici. Gli strumenti bipolari utilizzati in questo contesto possono generare calore durante l'uso, con conseguente rischio di incendio. Quando il generatore elettrochirurgico bipolare non è in uso, deve essere conservato correttamente nella custodia protettiva a tenuta d'aria di sicurezza dal paziente, dai membri dell'équipe chirurgica e da qualsiasi materiale combustibile.

NOTA: Per ulteriori avvertenze e precauzioni, consultare le rispettive Istruzioni per l'uso.

Informazioni EMC

Il prodotto ha superato il test di compatibilità elettromagnetica e soddisfa i requisiti di limitazione dello standard IEC60601-1-2 per le apparecchiature mediche. Queste limitazioni forniscono una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle normali installazioni mediche.

Composizione del prodotto

Numero di serie	Nome della parte	Modello/Versione No.	Osservazioni
1	Strumenti elettrochirurgici	OP9	/
2	Trasduttore dell'Apparecchiatura Chirurgica ad Ultrasuoni	TRA6	Uso compatibile

3	Forbici ad Ultrasuoni per uso singolo Forbice ad Ultrasuoni	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Uso compatibile
4	Unità chirurgica ad ultrasuoni ad alta frequenza monouso Sigillante per tessuti	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Comando a Pedale per Ultrasuoni	OP-FSD	/
6	Comando a Pedale per Elettrochirurgia	OP-FSS	/
7	Connettore bipolare per elettrochirurgia	OP-BPC	/

Cavo prodotto

Numero di serie	Nome del Cavo	Lunghezza (m)	Schermato
1	Cavo di controllo a pedale	3	Sì
2	Cavo di alimentazione	5	No
3	Cavo elettrochirurgico bipolare	3	No
4	Il cavo del Trasduttore	2,9	Sì

Prestazioni EMC

Questa apparecchiatura può essere soggetta a interferenze di radiofrequenza causate da altre apparecchiature mediche e da comunicazioni radio. Per evitare tali interferenze, questo prodotto è stato testato secondo la norma IEC 60601-1-2 e ne soddisfa i requisiti. Tuttavia, Reach Surgical, Inc. non garantisce l'assoluta assenza di interferenze nei singoli ambienti di installazione.

Se si riscontra un'interferenza con il dispositivo (che può essere determinata accendendo e spegnendo il dispositivo), l'utente (o il personale addetto alla manutenzione approvato da Reach Surgical, Inc.) deve cercare di adottare una o più delle seguenti misure per risolvere il problema dell'interferenza:

Regolare la direzione o la posizione del dispositivo che lo influenza.

Aumentare la distanza tra questo dispositivo e il dispositivo di invio.

Per alimentare l'apparecchiatura, utilizzare altre fonti di alimentazione (anziché quella utilizzata per l'alimentazione dell'apparecchiatura).

Per altri suggerimenti, consultare il fornitore o il rappresentante dell'assistenza.

Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze causate dalle seguenti situazioni: utilizzo di cavi di interconnessione diversi da quelli raccomandati; alterazione o modifica di questo apparecchio senza autorizzazione. Cambiamenti o modifiche non autorizzati possono causare la perdita di efficacia dell'apparecchiatura.

Tutti i tipi di apparecchiature elettroniche possono causare interferenze elettromagnetiche ad altre apparecchiature attraverso l'aria o altri cavi ad esse collegati. Non utilizzare dispositivi che possono emettere segnali RF, come telefoni cellulari, ricetrasmittitori radio o prodotti di controllo radio, in prossimità di questo dispositivo, in quanto le sue prestazioni potrebbero non essere conformi alle specifiche. Quando tali dispositivi si trovano in prossimità dell'apparecchio, spegnerne l'alimentazione. Il personale medico responsabile di questa apparecchiatura deve istruire tecnici, pazienti e altro personale che potrebbe trovarsi nelle vicinanze di questa apparecchiatura a rispettare pienamente i requisiti sopra indicati.

Per ottenere pienamente le prestazioni EMC specificate, l'utente deve installare il prodotto in modo corretto, seguendo i passaggi descritti nel manuale. In caso di problemi legati all'EMC, contattare il personale di manutenzione autorizzato da Reach Surgical, Inc.

Il Trasduttore (con cavo) e le Forbici ad Ultrasuoni sono definiti come la parte applicata dell'intero sistema.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

L'apparecchiatura può essere utilizzata in ambiente ospedaliero, ma non prevede locali di schermatura della radiofrequenza intorno ad apparecchiature chirurgiche attive a radiofrequenza o dove sono collocate apparecchiature a risonanza magnetica, poiché l'intensità dei disturbi elettromagnetici in questi luoghi è elevata.

Distanza di separazione e impatto delle apparecchiature fisse di radiocomunicazione: l'intensità del campo magnetico generato dai trasmettitori fissi, come le stazioni base dei telefoni senza fili (cellulari/cordless), i ricevitori radiofonici terrestri, i ricevitori radioamatoriali, le trasmissioni radiofoniche AM e FM, i Generatori di trasmissioni televisive, ecc. non può essere misurata con precisione in modo teorico. Per valutare l'ambiente elettromagnetico generato dai trasmettitori RF fissi, si deve prendere in considerazione la misurazione del campo elettromagnetico. Se il valore misurato dell'intensità del campo magnetico nel luogo in cui si trova il dispositivo supera il livello di radiofrequenza corrispondente specificato nella "Dichiarazione anti interferenze", il dispositivo deve essere ispezionato per assicurarsi che possa funzionare normalmente. Se si riscontrano condizioni di funzionamento anomale, è necessario prendere in considerazione ulteriori misure, come il riorientamento o la riallocazione dell'apparecchiatura o l'utilizzo di una stanza anti-radiofrequenza.

1) Utilizzare il cavo di alimentazione fornito o indicato da Reach Surgical, Inc. I prodotti dotati di spina di alimentazione devono essere collegati a una presa di corrente fissa con messa a terra di protezione. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o connettore per collegare la spina di alimentazione.

2) Tenere questo dispositivo il più possibile lontano da altri dispositivi elettronici.

3) Seguire la procedura per collegare il dispositivo.

Note generali

(1) Le specifiche del cavo.

L'uso dei cavi forniti da Reach Surgical, Inc. non danneggia le prestazioni EMC di questo prodotto. Se si utilizzano cavi non specificati, le prestazioni EMC di questa apparecchiatura possono essere notevolmente ridotte.

(2) Precauzioni per le modifiche non autorizzate

L'utente non deve modificare questo prodotto, altrimenti le prestazioni EMC del prodotto potrebbero diminuire.

La modifica del prodotto comprende i seguenti cambiamenti:

a. Cavo (lunghezza, materiale e cablaggio, ecc.).

b. Installazione/disposizione delle apparecchiature.

c. Configurazione/componenti dell'apparecchiatura.

d. Parti di protezione dell'apparecchiatura (apertura/chiusura del coperchio e parti di fissaggio del coperchio).

(3) Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, tutte le coperture protettive devono essere chiuse.

Questo prodotto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito e l'acquirente e l'utente di questo prodotto devono assicurarsi che venga utilizzato in questo ambiente elettromagnetico.

Prestazioni essenziali

1. Per l'emissione di energia radio ad alta frequenza avanzata, il sistema deve garantire che la deviazione della potenza nominale in uscita non superi il 20% del valore standard.

2. Per l'uscita di energia di base ad alta frequenza Radio, il sistema deve garantire che la deviazione della potenza nominale in uscita non superi il 20% del valore standard.

Guida e dichiarazione del fabbricante - EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE		
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente di il dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.		
Test sulle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo1	Il dispositivo utilizza l'energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni di radiofrequenza sono molto basse e non possono causare interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF	Classe A	Le caratteristiche di EMISSIONE di questa apparecchiatura la rendono idonea all'uso in aree industriali e ospedaliere
Corrente armonica IEC 61000-3-2	Classe A	
Variazioni di tensione / fluttuazioni di tensione / flicker IEC 61000-3-3	Conforme	

Guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica			
Il dispositivo è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.			
Test di immunità	IEC 60601 livello di prova	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Elettrostatico scarica (ESD) IEC 61000-4-2	Contatto ± 8 kV ± 2,4,8, 15kV aria	Contatto ± 8 kV ± 2,4,8, 15kV aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, L'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitorio rapido elettrico/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per le linee di ingresso/ uscita	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per le linee di ingresso/ uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Impennata IEC 61000-4-5	± 1 kV da linea(e) a linea(e) ± 2 kV linea/e a terra	± 1 kV da linea(e) a linea(e) ± 2 kV linea (s) verso terra	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, cortocircuiti interruzioni sulle linee di ingresso dell'alimentazione IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cicli a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0° 0% UT; ciclo 250/300	0% UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 25/30 cicli Monofase: a 0° 0% UT; ciclo 250/300	La qualità della rete elettrica deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utilizzatore dell'ecografo chirurgico Se l'apparecchiatura deve continuare a funzionare durante le interruzioni della rete elettrica, si raccomanda di utilizzare l'Apparecchiatura Chirurgica ad Ultrasuoni per la manutenzione del sistema. L'apparecchiatura deve essere alimentata da un gruppo di continuità o da una batteria.
Frequenza di alimentazione (50/60 Hz) Campo magnetico IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frequenza di potenza magnetica I campi devono essere a livello di caratteristica. Di una posizione tipica in un ambiente commerciale o ospedaliero.

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica			
Il dispositivo è destinato all'applicazione nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
IMMUNITÀ test	Test IEC 60601 livello	Conformità livello	Ambiente elettromagnetico. guida
RF condotta IEC 61000-4-6	3 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz 6 V nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz	3V	Comunicazioni RF portatili e mobili L'apparecchiatura non deve essere utilizzata a una distanza inferiore a quella raccomandata, calcolata in base all'equazione della frequenza del trasmettitore, da qualsiasi parte del dispositivo, compresi i cavi. Distanza di separazione consigliata
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{Da 80 MHz a 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad \text{Da 800MHz a 2,7GHz}$ <p>dove P è la potenza massima in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m). L'intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, determinata da un'indagine elettromagnetica sul sito.3 deve essere inferiore al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza. È possibile che si verifichino interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate dal seguente simbolo:</p>  <p>La PORTA DI INCLUSIONE delle APPARECCHIATURE e dei SISTEMI ME deve essere testata come specificato nella Tabella 9 della norma IEC 60601-1-2, utilizzando i metodi di prova specificati nella norma IEC 61000-4-3.</p>

Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e i dispositivi.

L'Apparecchiatura Chirurgica ad Ultrasuoni è destinata all'applicazione in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente del dispositivo può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo, come raccomandato di seguito, in base alla potenza massima di uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita massima nominale del trasmettitore (w)	Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore / m		
	Da 150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f_1}} \right] \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f_1}} \right] \sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{\sqrt{f_1}} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

NOTA: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Condizioni tecniche

Componenti necessari per il funzionamento del sistema: Strumento elettrochirurgico, Trasduttore, Comando a Pedale per Elettrochirurgia, Forbice ad Ultrasuoni o Manipoli per Elettrochirurgia Strumento bipolare per elettrochirurgia.


Fare riferimento alla descrizione del prodotto per questo componente.

Grado di protezione contro le scosse elettriche	Ultrasuoni:  Parte applicata di tipo CF; Elettrochirurgia bipolare  Parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione.
Grado di protezione contro le scosse elettriche	Classe I
Generatore di infusioni dannose	Attrezzatura normale
Grado di protezione contro l'ingresso nocivo dell'acqua	Interruttore a pedale: IP68
Categoria Gestione	Classe IIb
Requisiti dei parametri della modalità a ultrasuoni:	
Potenza d'ingresso	Tensione di alimentazione: 100-240V Frequenza di alimentazione: 50Hz/60Hz Potenza in ingresso: 400VA
Requisiti dei parametri della modalità a ultrasuoni:	
Frequenza di eccitazione	54 kHz - 57 kHz
Escursione della vibrazione della punta primaria	25 µm - 110 µm
Forbici ad Ultrasuoni Superficie di uscita acustica principale della punta a taglio Prodotto:	1,53-2,75 mm2
Acustica secondaria dei reticolati sulla punta delle Forbici ad Ultrasuoni Area di uscita:	19,32~35,88 mm2
Suono in uscita derivato alla punta di Forbice ad Ultrasuoni alla punta di riferimento Ampiezza primaria Potenza	< 30W
Tipo di controllo di frequenza del sistema	Indipendentemente dal carico, la frequenza di eccitazione viene regolata automaticamente in modo continuo.
Indice della riserva di carica	Non meno di 2,5
Requisiti dei parametri elettrochirurgici:	
Frequenza di lavoro	400KHz ± 5%
Tensione di uscita massima	≤ 250V
Modalità bipolare avanzata Corrente di uscita massima	≤ 5.5A
Modalità bipolare di base Corrente di uscita massima	≤ 2.2A
Tensione massima di uscita da picco a picco	≤ 500Vpk
Fattore di picco	1.6 ± 0.4
Potenza nominale	Bipolare avanzato a radiofrequenza: 270 W Radiofrequenza Bipolare di base: 95W
Carico nominale	Bipolare avanzato a radiofrequenza: 30Ω Radiofrequenza Bipolare di base: 200Ω
Condizioni ambientali operative	Temperatura: 10° C a 30° C
	Umidità relativa: ≤ 70%
	Intervallo di pressione atmosferica: da 800 hPa a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e conservazione	Temperatura: da -30 °C a + 55 °C (generatore, interruttore a pedale, adattatore)
	Temperatura: da -10°C a + 55°C (Forbici ad Ultrasuoni)
	Umidità: ≤ 80%
Data di produzione	Intervallo di pressione atmosferica: da 800 hPa a 1060 hPa
Cavo di alimentazione	Conformità ai requisiti di certificazione CCC
	Corrente nominale: 10A
Tasso di persistenza	Determinato dal manipolo del trasduttore e dalla Forbice ad Ultrasuoni utilizzata. Per informazioni sul tasso di persistenza, fare riferimento alle Forbici ad Ultrasuoni e ai prodotti per il trattamento delle acque reflue. Istruzioni del manipolo del trasduttore o Capitolo 7 - Avvertenze e precauzioni.
Fusibile	€5 * 20 T8AH250V

Peso (senza imballaggio)	Generatore: 8 kg nominali
Volume totale	Generatore OP9: (lunghezza * larghezza * altezza): 34 cm-34 cm-16 cm
Disposizione	Alcuni componenti interni del generatore, dell'interruttore a pedale e del cavo dell'interruttore a pedale contengono piombo. In base alla normativa locale Requisiti e norme per lo smaltimento. Smaltire le batterie in conformità con le pratiche di smaltimento dei rifiuti appropriate.
Classificazione AP/APG	Non è un'apparecchiatura AP/APG.
Durata di vita:	Vita utile: 7 anni
Versione del software	V01.01

Forma d'onda di uscita bipolare

Curva bipolare avanzata potenza-carico in uscita

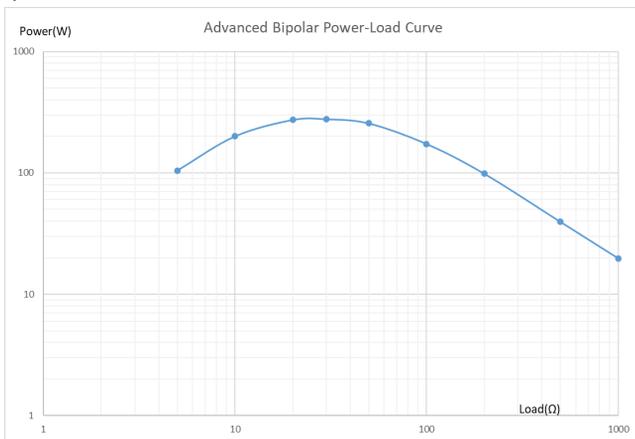


LIMITE DELLA CURVA DI POTENZA Uscita massima: 270[W]

Carico (Ω)	Limite inferiore	Nominale	Limite superiore
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Curva di potenza nominale di 270 watt in uscita a carico nominale in conformità al limite di corrente/tensione del misuratore della curva di potenza. La curva di potenza rappresenta l'involuppo che varia in condizioni di funzionamento.

Curva di uscita bipolare di base a piena potenza e carico

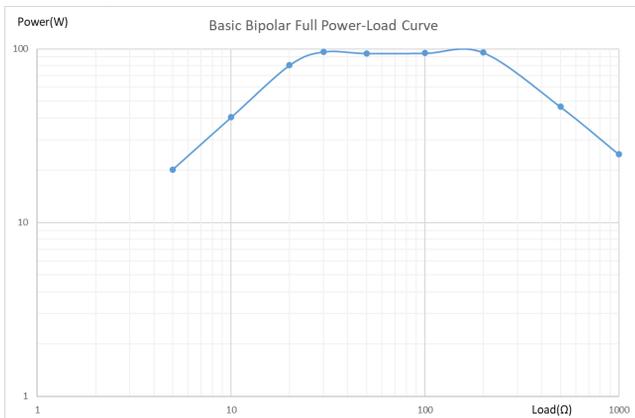


Limite della curva di piena potenza [W]: Potenza massima 95 Watt			
Carico (Ω)	Limite inferiore	Nominale	Limite superiore
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Curva di base uscita bipolare a metà potenza-carico

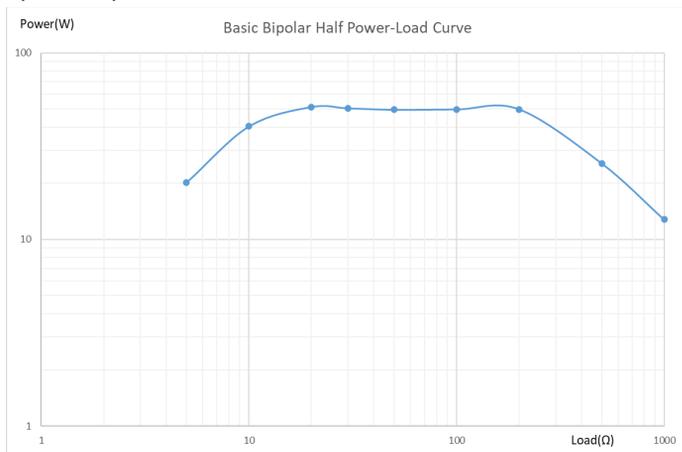

Limite della curva di mezza potenza [W]: Potenza massima 50 Watt			
Carico (Ω)	Limite inferiore	Nominale	Limite superiore
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Potenza di uscita rispetto alle impostazioni di potenza per la potenza in bipolare normale

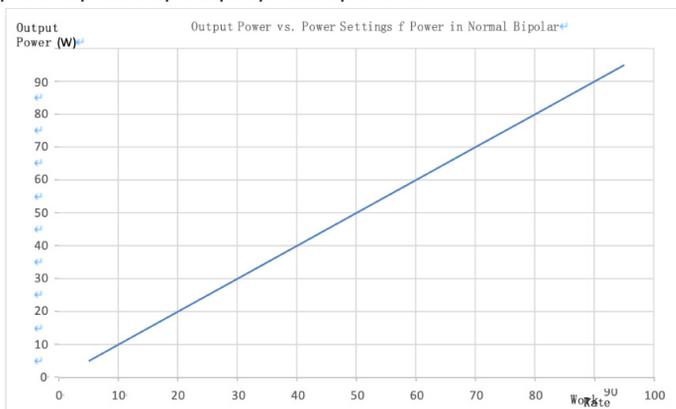

Potenza di uscita rispetto al valore impostato per il bipolare normale [W]; carico: 200Ω			
Potenza impostata (W)	Limite inferiore della potenza di uscita (W)	Potenza nominale (W)	Limite superiore di potenza in uscita (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Assistenza e garanzia

Reach Surgical, Inc. garantisce che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di uso normale e di manutenzione preventiva per il periodo di garanzia specificato di seguito. L'obbligo di Reach Surgical ai sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione, a sua discrezione, di qualsiasi prodotto o parte difettosa che sia stata restituita a Reach Surgical, Inc. o al suo distributore autorizzato entro il periodo di garanzia applicabile e che risulti difettosa in modo soddisfacente per Reach Surgical. La presente garanzia non si applica ai prodotti o alle parti che sono stati:

- Influenza negativa dovuta all'uso con dispositivi non autorizzati prodotti o distribuiti da parti non autorizzate da Reach Surgical, Inc.
- Riparati o modificati al di fuori della fabbrica di Reach Surgical, se ciò influisce sulla stabilità o sull'affidabilità del dispositivo, come stabilito da Reach Surgical.
- Soggetto a uso improprio, negligenza o incidente.
- Usato in modo non conforme al progetto, ai parametri di utilizzo, alle istruzioni e alle linee guida del prodotto o agli standard funzionali, operativi o ambientali accettati dal settore per prodotti simili.

Periodi di garanzia

Connettore di energia bipolare di base (OP-BPC): 1 anno per componenti e manodopera.

Generatore (OP9): 1 anno per componenti e manodopera.

Comando a Pedale/Cavo di alimentazione: 1 anno per componenti e manodopera.

La presente garanzia è il rimedio esclusivo per l'acquirente originale e sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare. Reach Surgical, Inc. non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali, compresi i danni derivanti da perdita di uso, profitti, affari o avviamento, salvo quanto espressamente previsto dalla legge applicabile.

Reach Surgical, Inc. non autorizza alcuna persona ad assumersi ulteriori responsabilità in relazione alla vendita o all'uso dei suoi prodotti. Non ci sono garanzie che vadano oltre i termini indicati nel presente documento.

Reach Surgical, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza incorrere in alcun obbligo di applicare retroattivamente tali modifiche ai prodotti precedentemente venduti o costruiti.

Apžvalga

Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją. Joje pateikiamos svarbios instrukcijos dėl tinkamo naudojimo, galimų pavojų ir galimos žalos gaminiui ar asmenims. Susidarius neįprastai situacijai, laikykitės nurodytų nurodymų, kad išvengtumėte žalos sau arba sugadintumėte įrenginį. Nesilaikant šių instrukcijų, gali nukentėti sauga, veikimas, garantija ar techninė priežiūra, už ką gamintojas negali būti atsakingas. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite ir Keitiklis bei Ultragarso žirkklės instrukcijas.

Šis dokumentas skirtas padėti naudotis šiuo prietaisu. Tai nėra chirurginių metodų vadovas.

Naudojami standartiniai susitarimai: Įspėjimieji, Įspėjimieji ir pastabieji užrašai

Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus teiginius, priskiriamus kategorijoms ĮSPĖJIMAS, ĮSPĖJIMAS arba PASTABA, kuriuose pateikiami svarbiausi nurodymai, kaip saugiai ir kruopščiai atlikti užduotis. Šiuos teiginius galima rasti visoje dokumentacijoje ir juos reikėtų perskaityti prieš pereinant prie kito procedūros veiksmo.

ĮSPĖJIMAS: Šiuo teiginiu atkreipiamas dėmesys į naudojimo ar techninės priežiūros procedūrą, praktiką ar sąlygą, kurios griežtai nesilaikant gali būti sužalotas žmogus arba prarasta gyvybė.

ĮSPĖJIMAS: Šiuo teiginiu naudotojas įspėjamas apie potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, naudotojas ar pacientas gali patirti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą, taip pat sugadinti įrangą ar kitą turtą. Jis taip pat gali įspėti apie nesaugius veiksmus. Tai apima būtinas atsargumo priemones saugiam ir veiksmingam Priemonės naudojimui ir atsargumą, būtiną siekiant išvengti žalos, atsiradusios dėl tinkamo ar netinkamo naudojimo.

PASTABA: Šis teiginys nurodo darbo praktiką arba sąlygą, kuri yra būtina norint veiksmingai atlikti užduotį.

Aprašymas

ENER REACH elektrochirurginis instrumentas (toliau - prietaisas) naudojamas medicinos operacinėse chirurginėse procedūroms pjauti, koaguluoti žmogaus audinius ir perrišti kraujagysles. Jame yra du atskiri lizdai: vienas skirtas ultragarso energijai, kitas - radio dažnio bangų formų išėjimui.

Radio dažnio režimu Bateria į tiekia skirtingas energijos schemas, priklausomai nuo prijungto instrumento / elektrochirurgijos prietaiso. Prijungus pažangų dvipolį instrumentą, Bateria perduoda radio dažnio bangų schemas, skirtas arterinėms ir veninėms kraujagyslėms, limfagyslėms ir iki 7 mm skersmens audinių pluoštams užplombuoti. Prijungus pagrindinį dvipolį instrumentą, minkštųjų audinių pjauštymui ir koaguliacijai tiekiami pastovios galios energija.

Ultragarso energijos išvesties režimu, naudojant TRA6 Keitiklis kartu su Vienkartinis ultragarsinis skalpelis CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, prietaisas pjauja minkštuosius audinius, kai reikia kontroliuoti kraujavimą ir minimaliai pažeisti termiškai, ir sandarina kraujagysles iki 5 mm skersmens. Sujungus su Vienkartinis ultragarso žirkklės SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 ir SRE45, prietaisas pjauja minkštuosius audinius, kuriems reikia kontroliuoti kraujavimą ir minimalios šiluminės žalos, ir užplombuoja kraujagysles iki didžiausio 7 mm skersmens.

Numatytas naudojimas

Prietaisas teikia radio dažnio energiją elektrochirurgijos antgaliams, kurie skirti kraujagyslėms perpjauti ir užsandarinti, taip pat audiniams pjauti, griebti ir išpjauti.

Be to, Bateria suteikia ultragarso galią ultragarsiniams chirurginiams instrumentams, kurie skirti minkštųjų audinių pjūviams, kai reikia kontroliuoti kraujavimą ir minimaliai termiškai sužaloti.

Indikacijos

Prietaisas teikia radio dažnio energiją elektrochirurgijos antgaliams, kurie naudojami atliekant atviras operacijas arba laparoskopines operacijas bendrojoje, vaikų, ginekologinėje, urologinėje, urologinėje, krūtinės ląstos chirurgijoje, pjaunant ir sandarinant kraujagysles iki 7 mm (imtinai), taip pat pjaunant, griebiant ir išpjaunant audinius.

Be to, Bateria tiekia energiją ultragarsiniams chirurginiams instrumentams, kurie skirti minkštųjų audinių pjūviams, kai reikia kontroliuoti kraujavimą ir minimaliai termiškai sužaloti. Ultragarsiniai chirurginiai instrumentai gali būti naudojami kaip elektrochirurgijos, lazerių ir plieninių skalpelių papildymas arba pakaitalas audiniams pjauti ir (arba) koaguluoti atliekant atviras operacijas arba laparoskopines operacijas bendrojoje, vaikų, ginekologinėje, urologinėje, krūtinės ląstos chirurgijoje, taip pat limfagyslių sandarinimui ir perpjovimui.

Numatomas naudotojas

Prietaisas skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams chirurgijoje.

Numatomo naudojimo aplinka

Prietaisas skirtas naudoti ligoninėje.

Numatoma pacientų populiacija

Šis prietaisas tinka 3 metų ir vyresniems pacientams, kuriems reikia atlikti chirurgines procedūras, susijusias su minkštųjų audinių pjūviams, kontroliuojant kraujavimą ir minimalų terminį sužalojimą.


Klinikinė nauda

Prietaisą galima saugiai ir veiksmingai naudoti kraujagyslių, audinių pluoštų ir limfagyslių perrišimui ir dalijimui.

Kontraindikacijos

Šį prietaisą draudžiama naudoti atliekant kaulų pjūvius, kontraceptinių kiaušintakių užkalinimą ir koaguliacijos procedūras. Jis taip pat neskirtas naudoti neurochirurgijoje.

Sistemos sudėtis

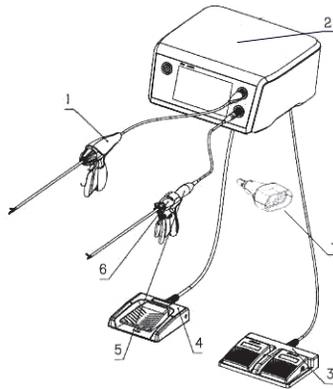

[01] Elektrochirurgijos rankenos	[02] OP9 Baterija
[03] Ultragaršinis kojinis jungiklis	[04] Elektrochirurginis kojinis jungiklis
[05] Keitiklis	[06] Ultragarso žirkklės
[07] Elektrochirurgijos dvipolis keitiklis	

[01] Elektrochirurginis antgalis

Procedūros metu chirurgas valdo elektrochirurginį antgalį, prijungtą prie Baterija. Jis naudoja radijo dažnių elektrochirurginę energiją audiniui tarp jo žandikauliai koaguluoti arba užsandarinti. Prietaisas taip pat turi ašmenis audiniams dalyti. Modelis: OSA23, OSA37, OSA44. Išsamesnės informacijos ieškokite instrukcijose.

[02] OP9 Baterija

Baterija per atskiras instrumentų prijungimo jungtis tiek elektrochirurginę, tiek ultragaršinę terapijos energiją. Ji sudaro važiuoklė, korpusas, elektroninė plokštė, LCD jutiklinis ekranas, maitinimo jungiklis ir sąsajos priedams prijungti.

Modelis: OP9

[03] Ultragaršinis kojinis jungiklis

Naudojamas ultragarso energijos išėjimui valdyti dviem jungikliais ("MIN" ir "MAX"). Modelis: OP-FSD

[04] Elektrochirurginis kojinis jungiklis

Naudojamas aukšto dažnio energijai įjungti ir išjungti vienu jungikliu.

Modelis: OP-FSS

[05] Keitiklis

Prietaisas Keitiklis iš suderinamo prietaiso Baterija gaunamą elektros energiją paverčia mechaniniu judesiu prietaiso mentėms. Tai daugkartinio naudojimo prietaisas, kurio naudojimo trukmė ribota. Keitiklis nėra sterilus, todėl prieš naudojimą jį reikia sterilizuoti pagal instrukcijas. Išsamesnės informacijos rasite TRA6 Keitiklis instrukcijose.

Modelis: TRA6.

[06] Ultragarso žirkklės

Ultragarso žirkklės naudoja Keitiklis mechaninį judesį ir perduoda ultragarso energiją audiniams pjauti arba koaguluoti. Reikėtų būti atsargiems, nes mechaninė vibracija neaptinkama ir gali netyčia paveikti netiklines sritis. Ultragarso žirkklės sterilizuojami etileno oksidu. Jei galiojimo laikas viršijamas arba sterilizacijos pakuotė pažeista, Ultragarso žirkklės negalima naudoti ir juos reikia išmesti. Išsamesnės informacijos ieškokite Ultragarso žirkklės instrukcijose.

Su OP9 Baterija suderinami šie Ultragarso žirkklės:

PD serija: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB serija: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE serija: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektrochirurgijos bipolinė jungtis

Naudojamas pagrindiniam dvipoliariui Elektrochirurginiai instrumentai prijungti prie Baterija, skirto audinių koaguliacijai.

Modelis: OP-BPC

Baterija Priekinis skydelis

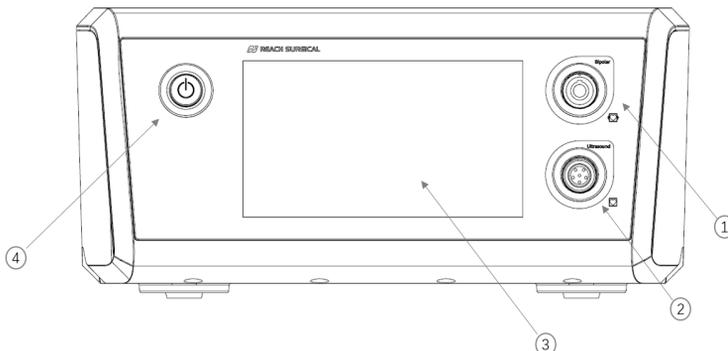

[01] Elektrochirurginis lizdas

Naudojamas pažangiai bipolinei Elektrochirurginiai instrumentai arba elektrochirurginei bipolinei jungčiai prijungti.

[02] Keitiklis lizdas


Sujungia Keitiklis su Baterija.

[03] LCD jutiklinis ekranas

Rodoma sistemos informacija ir naudojama kaip sąsaja valdikliams ir nustatymams reguliuoti.

[04] Maitinimo jungtlio mygtukas

Paspauskite , kad įjungtumėte Baterija; paspauskite ir palaikykite , kad išjungtumėte.

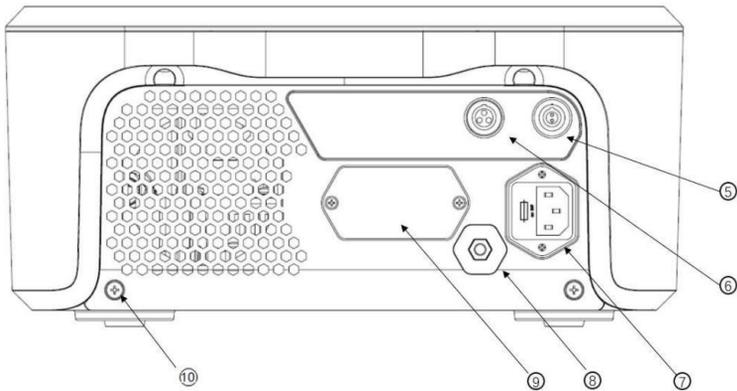Baterija Galinis skydelis**[05] Elektrochirurginis kojinio jungtlio lizdas**

Apvalus lizdas, skirtas prijungti elektrochirurginį kojinių jungtį.

[06] Ultragarso kojinio jungtlio lizdas

Apvalus lizdas ultragarso kojiniams jungtliui prijungti.

[07] Maitinimo lizdas

Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio Baterija.

[08] Potencialo išlyginimo prievadas

Jei neaišku, ar maitinimo lizdo įžeminimas yra patikimas, per šią jungtį galima prisijungti prie apsaugoto įžeminimo.

[09] Išplėtimo sąsaja

Naudojamas funkcijoms plėsti ir prižiūrėti.

[10] Montavimo skylė**Naudojimo instrukcijos**

Vadovaukitės pateiktomis darbo aplinkos gairėmis.

išpakavimas

Gavę toliau nurodytus komponentus, vadovaukitės instrukcijomis.

- Patikrinkite, ar nėra matomų transportavimo pažeidimų. Jei pastebėjote pažeidimų, kreipkitės į "Reach Surgical, Inc." arba vietinį atstovą.

Komponentai, įeinantys į sistemą (išsamios techninės specifikacijos ir gaminių kodai nurodyti skyriuje "Sistemos techninės sąlygos"):

Modelis	Aprašymas	Komponentas
OP9	Baterija	Baterija, maitinimo laidas, instrukcijos
TRA6	Keitiklis	Keitiklis su kabeliu
OP-FSD	Ultragarso kojinis jungtulis	/
OP-FSS	Bipolinis kojinis jungtulis	/
OP-BPC	Pagrindinė dvipolė energijos jungtis	/

Atsargumo priemonės

- Tikrindami įrangą laikykite distalinį instrumento galą atokiau nuo kitų aparatų, chirurginių užvalkalų, paciento ar kitų objektų, kad išvengtumėte sužeidimų.
- Įgyvendinkite būtinas saugos priemones, kai yra garų, laikydamiesi ligoninės procedūrų ir taisyklių.

Ultragarso energija su PD serija Ultragarso žirkklės

- Prijunkite Keitiklis, kojinių jungtį ir PD serijos Ultragarso žirkklės prie Baterija.
- Atlikę Keitiklis ir Ultragarso žirkklės testus, LCD ekrane esančiomis +/- piktogramomis nustatykite galios lygį (1-5).
- Paspauskite mygtuką "Min" ant Ultragarso žirkklės arba Min pedalą ant kojinio jungtikio, kad įjungtumėte ultragarso energiją nustatyto galingumo.
- Paspauskite mygtuką "Max" ant Ultragarso žirkklės arba "Min" pedalą ant kojinio jungtikio, kad pasiektumėte didžiausią energijos lygį.
- Atleiskite raktą arba kojinių jungtį, kad sustabdytumėte energijos išleidimą.

Ultragarso energija su SRB/SRE serija Ultragarso žirkklės

- Atlikę Keitiklis ir Ultragarso žirkklės testus, LCD ekrane esančiomis +/- piktogramomis nustatykite galios lygį (1-5).
- Paspauskite ant prietaiso esantį mygtuką Energijos mygtukas arba kojinio pedalo mygtuką Min, kad įjungtumėte nustatyto galingumo ultragarso energiją.
- Paspauskite prietaiso mygtuką Energijos mygtukas su pažangios homostazės funkcija, kad įjungtumėte išplėstinį homostazės režimą.
- Noredami sustabdyti energijos tiekimą, atleiskite mygtuką ant Ultragarso žirkklės arba mygtuką ant Kojinis jungtikis.

Elektrochirurginė bipolinė energija su pažangiais bipoliniais instrumentais

- LCD ekrane rodoma išplėstinio dvipolio piktograma ir reguliuojamo rankinio valdymo piktograma.
- Norėdami įjungti radijo dažnį, patraukite Svirtis ant prietaiso arba paspauskite kojinio jungiklio pedalą.
- Baterija sustabdys energijos išvedimą, kai uždarymas bus baigtas, o tai rodo ekrane esanti užbaigimo piktograma.
- Jei surišimas nebaigtas, pasigirs įspėjamasis signalas ir bus rodoma įspėjimo piktograma.

Bipolinė elektrochirurginė energija su bipoliniu elektrochirurginiu instrumentu

- LCD ekrane rodoma galios vertė, reguliuojamos piktogramos ir galios lygio juostos.
- Galingumo nustatymų diapazonas - 1-95 vatai, reguliuojami žingsniai.
- Pasirinkite pageidaujimą išėjimo galios nustatymą: Pasirinkite mažą (15 vatų), vidutinę (30 vatų) arba didelę (60 vatų) galią.
- Norėdami įjungti radijo dažnį, paspauskite rankinio jungiklio arba kojinio jungiklio pedalą mygtuką.
- Atleiskite mygtuką, kad išjungtumėte energijos išėjimą.

Nustatymo rekomendacijos

Efektų nustatymai	Galios nustatymų diapazonas	Klinikinis taikymas	Optimizuotas įrenginys
Žemas	1-15 vatų	nervų ir (arba) stuburo, rankų ir veido chirurgija	- Mažesnio paviršiaus ploto prietaisai - Mikrognyplės (0,4-2,2 mm)
Viduryje	16-40 vatų	Pavyzdžiui, koaguliacija galvos/kaklo, stuburo ir anatominės srityse.	- Vidutinio paviršiaus ploto prietaisai - Mikrognyplės (1,0-2,2 mm) - Mažos plokščios laparoskopinės žnyplės - Bipolinės žirkklės
Aukštas	45-95 vatai (po 5 vatus)	Pavyzdžiui, galvos/kaklo ir plastinė chirurgija (panašus į vidutinio poveikio, bet greitesnis poveikis)	- Didelio paviršiaus ploto prietaisai - Didelės plokščios laparoskopinės žnyplės

PASTABA: Šis prietaisas nesuderinamas su neutraliuoju elektrodu.

PASTABA: Ultragarso žirkklės ir RF elektrinis skalpelis yra su pacientu kontaktuojančios dalys.


Naudojant Bateriją

Įjunkite įreginį

- Įjungus sistemą, ji yra paruošta darbui. Kai Baterija yra prijungtas prie elektros tinklo ir dega budėjimo režimo jungiklio lemputė, sistema yra paruošta naudoti.
- Paspaudus budėjimo režimo mygtuką, bus rodomas šis vaizdas:




- Jei prie Baterija nėra prijungtas Keitiklis arba Ultragarso žirkklės arba jei jie prijungti neteisingai, bus rodomas toks vaizdas:

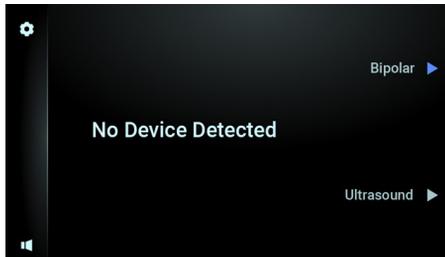

Naudojant ultragarsinį prietaisą (Keitiklis ir Ultragarso žirkklės)


Aptikus Keitiklis ir Ultragarso žirkklės, bus rodomas šis vaizdas.

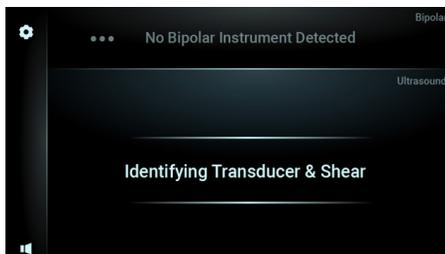


PASTABA: jei Keitiklis likęs naudojimo laikas yra mažesnis nei 10, bus rodomas šis vaizdas. Atkreipkite dėmesį į likusių naudojimo atvejų skaičių, nes Keitiklis reikia pakeisti, kai šis skaičius tampa lygus nuliui.




Toliau bus rodomas toliau pateiktas vaizdas, bus paprašyta paspausti bet kurį Ultragarso žirklių mygtuką, kad būtų pradėtas Ultragarso žirklių testas su atidarytu žandikauliu.

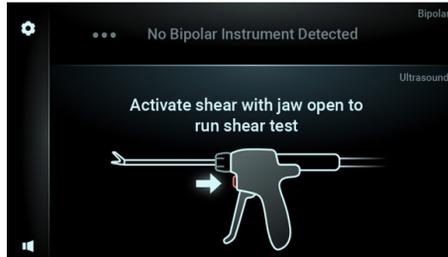


Paspauskite bet kurį mygtuką, ir bus rodomas šis vaizdas.

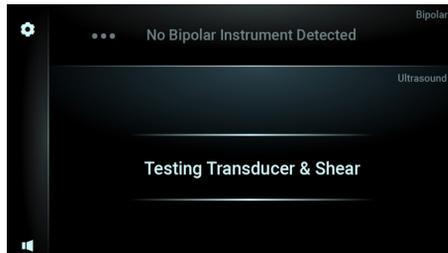


Kai Keitiklis testas nepavyksta, rodomas toks vaizdas:

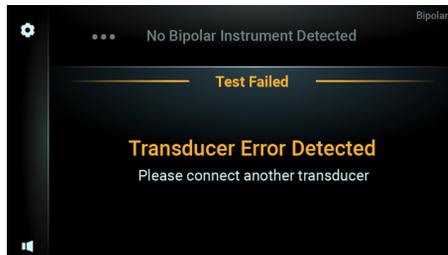

Kai testas Ultragarso žirklių nepavyksta, rodomas toks vaizdas:

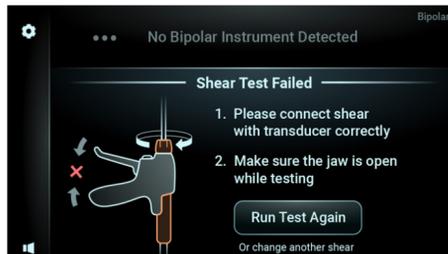


Kai testas Keitiklis ir Ultragarso žirklių bus atliktas sėkmingai, bus rodomas šis vaizdas:

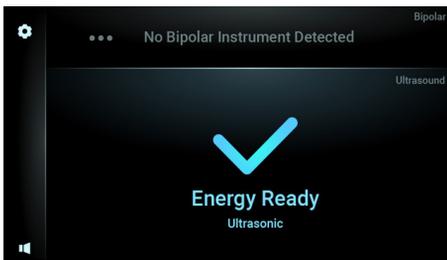

Prijungus Ultragarso žirkklės be išplėstinės hemostazės funkcijos, bus rodomas šis darbinis ekranas.




Sujungus SRE Ultragarso žirkklės su "Advanced Hemostasis", bus rodomas šis darbinis ekranas.

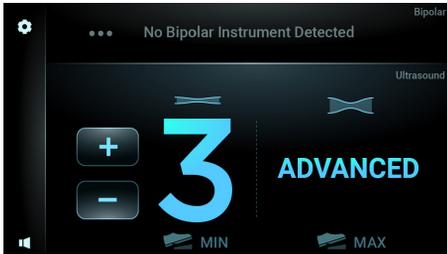


Išvesties režimas bus paryškintas.

Naudojant elektrochirurginį instrumentą


Aptikus Keitiklis ir Ultragarso žirkklės, bus rodomas šis vaizdas.

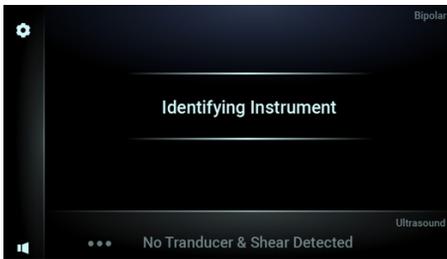

Kai elektrochirurginio instrumento testas bus sėkmingas, bus rodomas šis vaizdas:

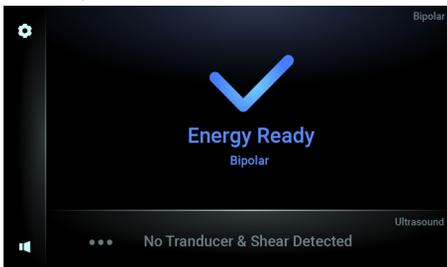

Prisijungus prie išplėstinio dvipolio prietaiso, bus rodomas šis darbinis ekranas.

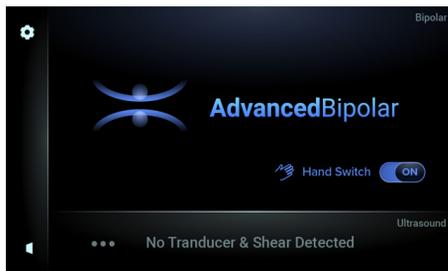

Prisijungus prie įprasto dvipolio prietaiso, bus rodomas šis darbinis ekranas.




Naudojant elektrochirurginį instrumentą ir Ultragarso žirklys

Atkreipkite dėmesį, kad kai Baterija prijungtas ir prie bipolinio elektrochirurginio instrumento, ir prie Ultragarso žirklys, sistema veikia padalytame ekrane ir rodo esamą būseną. Prietaisas, kuriam suteikta pirmenybė, pirmasis aktyvus energiją. Tokia padalytame ekrane rodoma būseną pavaizduota toliau:



Sistemos nustatymai


Norėdami pasiekti sistemos nustatymus, spustelėkite viršutiniame kairiajame ekrano kampe esančią nustatymų piktogramą. Galimos šios sistemos nustatymų parinkty:




Kalba: Paspaudus elementą Language (Kalba), bus rodomas kalbos pasirinkimo ekranas:




Naudotojo konfigūracija: Paspaudus elementą User Configuration (Vartotojo konfigūracija), bus rodomas vartotojo konfigūracijos ekranas:

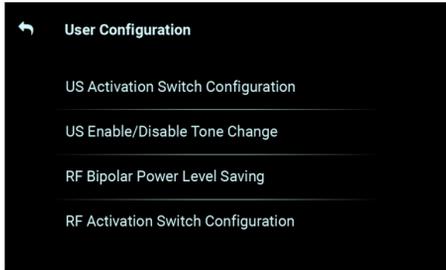


Sistemos nuostatos: Paspaudus elementą System Preferences (Sistemos nuostatos), bus rodomas sistemos nuostatų ekranas:

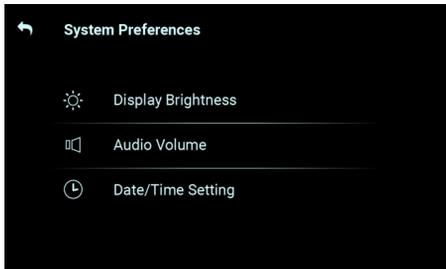

Sistemos informacija: Atsargiai spustelėkite System Info elementą, kad būtų parodytas sistemos informacijos ekranas:

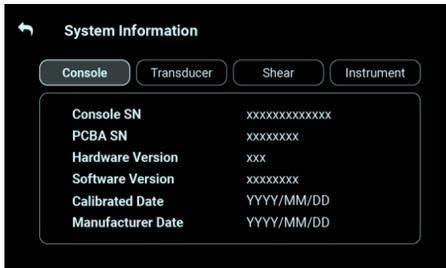

Diagnostika: Paspaudus elementą Diagnostika, bus rodomas diagnostikos ekranas:

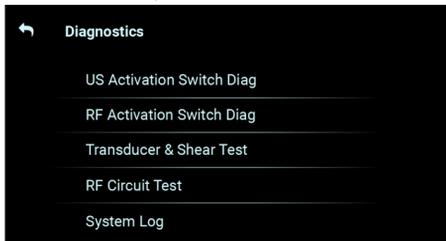

Norėdami išeiti iš sistemos nustatymų ir grįžti į sistemos budėjimo režimą, paspauskite ekrano viršutiniame kairiajame kampe esančią piktogramą "Return" (grįžti).

Sistemos išjungimas

Norėdami saugiai išjungti sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Paspauskite budėjimo režimo mygtuką. Paspauskite budėjimo režimo mygtuką ant Baterija ir paspauskite jį, kad pradėtumėte išjungimo procesą.

Atjunkite Keitiklis ir Ultragarso žirkklės. Atsargiai atjunkite Keitiklis ir Ultragarso žirkklės nuo sistemos. Kaip tinkamai elgtis su Keitiklis ir Ultragarso žirkklės, žr. naudojimo instrukcijas.

Valymas: Baterija, kojinių jungiklį ir Keitiklis valykite pagal skyriuje "Techninė priežiūra" nurodytas procedūras.

Trikčių šalinimas

Ji Baterija yra įvairių įspėjamųjų signalų ir klaidų kodų, padedančių nustatyti ir diagnozuoti komponentų gedimus. Svarbu pažymėti, kad šie signalai ir kodai yra skirti padėti klinikiniam vertinimui ir stebėjimui, o ne juos pakeisti.

Garsinis įspėjimas

Darbo būsena	Garso tipas	Galima priežastis ir veiksmai
Savikontrolės būsena	Įprastas garsas	/
	Nenormalus garsas	Aptiktas aparatinės įrangos gedimas. Kreipkitės į gamintoją dėl remonto pagalbos.
	Maksimalus garso lygis	/
	Minimalus garso lygis	/
	Nenormalus garsas	Ultragarso žirkklės susiliečia su per dideliu audinių kiekiu. Sumažinkite audinių sąlytį su Ultragarso žirkklės. Jei nuolatinis garsas išlieka, atsargiai pašalinkite visus audinius, kurie gali būti susikaupę aplink Ultragarso žirkklės galą. Aptiktas Keitiklis ir (arba) Ultragarso žirkklės gedimas. Dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į gamintoją arba į palaikymo tarnybą.
Ultragarso prietaiso naudojimas	Išplėstinis garsas	/
	ITS garsas	/
	Išplėstinis bipolinis įspėjamasis signalas	/
	Normalus dvipolis garsas	/
Elektrochirurginio instrumento aktyvavimas	Nenormalus garsas	Nesėkmingas pjaustymas: Jei audinis, su kuriuo liečiasi instrumentas, neatitinka pjovimo reikalavimų, sumažinkite su instrumentu besiliečiančio audinio kiekį. Jei gedimo signalas išlieka, atsargiai pašalinkite visus audinius, kurie gali būti susikaupę prie instrumento galo. Techninės įrangos gedimas: Ši klaida rodo galimą grandinės arba jungties gedimą. Bet koks gedimo ar klaidos atveju rekomenduojama pasikonsultuoti su gamintoju arba kreiptis pagalbos į techninės pagalbos tarnybą, kad būtų pateiktos tinkamos rekomendacijos ir išspręsta problema.


Klaidų kodai

"Energy Platform Baterija" turi išsamią gedimų identifikavimo sistemą, kurią sudaro įspėjimai ir sistemos klaidos. Aptikus gedimą, Baterija skleidžia įspėjamąjį signalą, valdymo skydelyje rodo įspėjamąjį signalą, o LCD ekrane - atitinkamą gedimo kodą. Norėdami išspręsti problemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas	Atitinkamas gedimo pranešimas
Įspėjimas	Prašome tinkamai sujungti Ultragarso žirkklės su Keitiklis
Įspėjimas	Užtikrinkite, kad atliekant bandymus būtų atidarytas Žandikauliai
Įspėjimas	Ultragarso žirkklės Aptikta klaida
Įspėjimas	Likęs Keitiklis laikas lygus nuliui
Įspėjimas	Vienu metu aktyvuokite tik vieną mygtuką
Įspėjimas	Sumažinkite Ultragarso žirkklės veikiančią jėgą
Įspėjimas	Ultragarso žirkklės mygtuko ir kojino jungiklio negalima uždaryti vienu metu
Įspėjimas	Mygtukas užstrigo, patikrinkite ir tęskite
Įspėjimas	Sureguliuokite Žandikauliai arba suspauskite mažiau audinio
Įspėjimas	Išimkite prietaisą iš audinių
Sistemos klaida	Sistemos klaida
Sistemos klaida	Savikontrolė nepavyko

Jei testavimo metu ekrane pasirodo klaida, atlikite šiuos veiksmus:



- Įsitinkinkite, kad kabelis Keitiklis visiškai įkištas tinkama kryptimi.
- Patikrinkite, ar teisingai užveržtas Ultragarso žirkklės, ar aplink Ultragarso žirkklės galą nesudarė audinių. Sureguliuokite Ultragarso žirkklės sandarumą ir atsargiai pašalinkite aplink Ultragarso žirkklės korpusą susikaupusius audinius. (Jei bandymas pradedamas prieš operaciją, įsitinkinkite, kad Ultragarso

žirkles nukreiptas į orą. Jei naudojamas Ultragarso žirkles, įsitikinkite, kad spaudukas yra atidarytas ir nesiliečia su jokiais objektais).

- Jei problema išlieka, apsvastykite galimybę pakeisti Keitiklis arba Ultragarso žirkles.
- Pereikite prie įrangos darbo režimo.

PASTABA: Keitiklis gali tinkamai neveikti, jei jo temperatūra viršija nurodytą ribą. Tokiais atvejais nedelsdami naudokite kitą Keitiklis arba atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte klaidos priežastį ir išnagrinėtumėte nepravalmos atkūrimo metodus:

- Leiskite Keitiklis atvėsti kambario temperatūroje mažiausiai 45 minutes. Šis aušinimo būdas taikomas ir tuo atveju, jei Keitiklis įkaista po ilgo veikimo didele galia.
- Jei Keitiklis perkaitymas nėra akivaizdus ir problema neišsprendžiama, kreipkitės pagalbos į gamintojo techninės priežiūros atstovus.
- Išskyrus saugiklius, Baterija nėra jokių naudotojų aptarnaujamų dalių. Dėl bet kokių pakeitimo ar aptarnavimo reikalavimų kreipkitės į "Reach Surgical, Inc." apmokytą ir įgaliotą aptarnaujantį personalą arba į savo vietinį atstovą.

Aparato Baterija techninė priežiūrą ir atnaujinimus turi atlikti tik "Reach Surgical" apmokytas ir įgaliotas aptarnaujantis personalas.

Siekiant užtikrinti kelių galimoms grėsmėms, reikėtų apsvastyti kibernetinio saugumo priemones. Toliau išvardyti incidentai kelia kibernetinio saugumo pavojų:

- Neteisėta prieiga prie bet kokių su prietaisu nesujusių produktų.
- bet koks neleistinas tinklo ryšys su įrenginiu.
- "Reach Surgical" nepatvirtinti programinės įrangos ar programinės įrangos atnaujinimai.

Jykykus bet kuriam iš minėtų incidentų, kreipkitės į "Reach Surgical, Inc." pardavimų atstovą arba tiesiogiai kreipkitės į "Reach Surgical, Inc." adresu Reachquality@reachsurgical.com.

Techninė priežiūra

Baterija ir pagrindinės dvipolės energijos jungties valymas ir dezinfekavimas

Valymas

Išvalykite Baterija LCD ekraną ir pagrindinę dvipolę jungtį pagal ligininės procedūras ir taisykles. Prieš valydami įsitikinkite, kad pagrindinis Baterija maitinimo šaltinis yra atjungtas, o maitinimo laidas ištrauktas iš išvesties bloko.

ĮSPĖJIMAS: valymo procedūrų reikia laikytis atidžiai, kad nesugadintumėte Baterija, nesukeltumėte elektros smūgio arba nesukeltumėte gaisro pavojaus. Neišpilkite ir nepurškite skysčių ant ar į Baterija, taip pat nemerkite jo į skystį.

Atlikite šiuos valymo veiksmus:

- Paruoškite neutralaus pH ploviklį arba neutralaus pH fermentinį ploviklį, kaip nurodo ploviklio gamintojas.
- Švaria, minkšta šluoste, suvilgyta nedideliu kiekiu valymo tirpalo, rankomis nuvalykite visus paviršius, įskaitant Baterija ekraną.
- Visus paviršius nuvalykite švaria, minkšta šluoste, pamirkyta šiltame vandentiekio vandenyje.
- Galiausiai nuvalykite visus paviršius švaria, minkšta šluoste, kad jie būtų sausi.

Dezinfekcija

- Jei Baterija užteršias krauju ar kūno skysčiais, prieš pakartotinai naudojant jį reikia dezinfekuoti. Patvirtinta, kad Baterija galima naudoti šias chemines dezinfekavimo priemones: 70 % izopropilo alkoholi, 6 % natrio hipochloritą, 10 % vandenilio peroksida.
- Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl tinkamo dezinfekavimo priemonių naudojimo, koncentracijos ir kontakto laiko.
- Užtikrinkite, kad dezinfekavimo priemonės būtų sukonfigūruotos ir naudojamos pagal gamintojo instrukcijas.

Kojinio jungiklio valymas

Po kiekvieno naudojimo kojinių jungiklį ir kabelį valykite toliau nurodyta tvarka:

- Atjunkite kojinių jungiklį nuo Baterija.
 - Paruoškite neutralaus pH fermentinį ploviklį pagal gamintojo nurodymus.
 - Tvirtai prijunkite kabelį su kojiniu jungikliu ir panardinkite juos į valymo tirpalą 2 minutėms.
- PASTABA:** įsitikinkite, kad kojinio jungiklio laidas, naudojamas Baterija prijungti, yra visiškai sausas, kad būtų išvengta atsitiktinio įjungimo.
- Po panardinimo rankiniu būdu nušveikite kojinių jungiklį ir kabelį minkštu šerių šepečiu valymo tirpale.
 - Kojinių jungiklį ir kabelį kruopščiai skalaukite šiltu vandentiekio vandeniu ne trumpiau kaip 1 minutę.

ĮSPĖJIMAS: skalavimo metu laikykite kabelį ir kojinių jungiklį tvirtai sujungtus.

- Visus paviršius nuvalykite švaria, minkšta šluoste.

ĮSPĖJIMAS: kojiniams jungikliui valyti nenaudokite ultragarsinio valymo aparato.

ĮSPĖJIMAS: Neįjunkite Baterija maitinimo šaltinio prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo kabelį. Prieš montuodami įsitikinkite, kad visos jungtys yra sausas.

Keitiklis valymas ir dezinfekavimas

Keitiklis siunčiamas nesterilus, todėl prieš kiekvieną naudojimą juos reikia kruopščiai išvalyti ir sterilizuoti.

Valymas:

- Kruopščiai išvalykite keitiklį pagal toliau nurodytus veiksmus:
- Nuplaukite keitiklį sraigtiniu paviršiumi į viršų ir valykite minkštu šerių šepečėliu su išgrynintu vandeniu, kol paviršiuje neliks dėmių;
- Keitiklis mirkomas pH neutralioje fermentinėje plovimo priemonėje (pagrindiniai ingredientai: proteazė, lipazė, amilazė, celulazė, pektinazė ir kiti biologiniai fermentai, aplinkai nekenksminga paviršiumi aktyvumo medžiaga, rūdžių prevencijos veiksnys ir stabilizatorius) iki 10 minučių tinkamoje 15°C – 65°C temperatūroje. Ploviklio ir išgryninto vandens santykis yra 1:400.
- Nuplaukite keitiklį sraigtiniu paviršiumi į viršų išgrynintu vandeniu už 2 minutes;
- Išvalykite jungiamąjį varžtą, skalpelio montavimo paviršius ir jungtį alkoholiu servetėle.
- Pamirkykite keitiklį 75 % mediciniame alkoholyje ir palaikykite bei pakratykite 30 kartų;
- Nuplaukite keitiklį sraigtiniu paviršiumi į viršų išgrynintu vandeniu už 2 minutes.

Pastaba: keitikliui nerekomenduojama naudoti ultragarsinių valiklių.

Džiovinimas:

Džiovinimo temperatūra: 50 ~ 70 °C, džiovinimo laikas: 30 min.

Keitiklių sterilizavimas:

Atlikus anksčiau nurodytus valymo ir džiovinimo veiksmus, keitiklį reikia sterilizuoti vienu iš toliau nurodytų metodų.

Garo sterilizavimas (121 °C)

- Prieš sterilizaciją reikia uždėti apvalkalą. Sterilizacijos metu keitiklis turi būti suvyniotas. Sterilizuodami įdėkite keitiklį į garo sterilizavimo puodą, kuriame temperatūra yra 121 °C, o sterilizacijos trukmė – 30 min.
- Džiovinimo temperatūra: 50 ~ 70 °C, džiovinimo laikas: 30 min.

Garo sterilizavimas (134 °C)

- Prieš sterilizaciją reikia uždėti apvalkalą. Sterilizacijos metu keitiklis turi būti suvyniotas. Sterilizuodami įdėkite keitiklį į garo sterilizavimo puodą, kuriame temperatūra yra 134 °C, o sterilizacijos trukmė – 10 min.
- Džiovinimo temperatūra: 50 ~ 70 °C, džiovinimo laikas: 30 min.

Saugos ir funkciniai bandymai

Užtikrinkite, kad būtų atlikti saugos ir funkciniai Keitiklis, Bateria ir kojino jungiklio bandymai pagal ligininės procedūras ir taisykles. Dėl kitų komponentų, kuriuos naudoja keli pacientai, saugos ir funkcinį bandymų žr. kiekvienam komponentui skirtas naudojimo instrukcijas.

Saugos testas

Bateria: Atestuoti ligininės technikai turėtų atlikti nuotėkio srovės bandymą.

Kojinis jungiklis: Apžiūrėkite, ar pedalas, kabelio jungtis ir laidas nėra įtrūkę ar pažeisti. Pakeiskite visus pažeistus komponentus.

Kitos sudedamosios dalys: Patikrinkite visus kitus komponentus, kaip nurodyta atitinkamose jų naudojimo instrukcijose.

Funkciniai bandymai

Ultragarso režimas

- Paruoškite visą PD Ultragarso žirkles komplektą ir prijunkite Keitiklis, vadovaudamiesi II skyriuje "Įrangos montavimas ir eksploatavimas" pateiktomis instrukcijomis.
- Patikrinkite, ar galima pereiti į darbinę būseną. Skirtingus Ultragarso žirkles gali turėti skirtingas įvesties sąšajas. Išsamioms instrukcijoms pateiktos 2 skyriaus 1 dalies 3 skirsnyje.
- Patvirtinkite, kad rodomas MIN galios 3 lygis ir MAX galios 5 lygis.
- Paspauskite galios didinimo ir mažinimo mygtukus, kad MIN galios lygį būtų galima reguliuoti nuo 1 iki 5 lygio.
- Įjunkite prietaisą Bateria ir prijunkite jį į ultragarso darbo režimą. Patikrinkite, ar teisingai sujungti Keitiklis ir Ultragarso žirkles.
- Kai žandikaulis atidarytas, paspauskite kojino jungiklio mygtuką "MAX". LCD ekrane turėtų būti rodomas MAX galios lygis "5" ir pasigirsti įjungimo signalas.
- Kai žandikaulis atidarytas, paspauskite kojino jungiklio mygtuką "MIN". LCD ekrane turėtų būti rodomas MIN galios lygis ir pasigirsti įjungimo signalas.

ĮSPĖJIMAS: Prieš įjungdami sistemą, įsitinkite, kad žandikaulis yra atokiau nuo ausinių, kitų instrumentų ar bet kokių kitų objektų, kad naudotojas nesusižeistų.

Bipolinis elektrochirurginis režimas

- Prijunkite pažangų bipolinį elektrochirurginį instrumentą / pagrindinį bipolinį instrumentą pagal instrukcijas.
- Patikrinkite, ar sistema gali įeiti į darbinę sąsają. Pagrindiniu dvipoliu režimu turi būti rodoma 30 galios lygio piktograma, o išplėstiniu dvipoliu režimu - piktograma "išplėstinis dvipolis".
- Lengvai palieskite galios didinimo ir mažinimo klavišus, esančius pagrindiniame dvipoliame režime, kad patvirtintumėte, jog galios lygį galima reguliuoti nuo 1 iki 95. Palieskite mygtukus Low (žemas), Medium (vidutinis) ir High (aukštas), kad tiesiogiai perjungtumėte tarp 15, 30 ir 60.
- Įjunkite Bateria ir palaukite 5 sekundes. Tada įjunkite Bateria maitinimo šaltinį ir palaukite 10 sekundžių. Patikrinkite, ar pagrindinio dvipolio režimo ekrane rodoma 30 galios lygio sąšaja, o išplėstinio dvipolio režimo ekrane rodoma "išplėstinio dvipolio" sąšaja. Patikrinkite, ar Bateria įjungtas pagal iš anksto nustatytus reikalavimus.
- Prijunkite išplėstinį ir pagrindinį dvipolį Elektrochirurginiai instrumentai ir paspauskite vieną kojini jungiklį. Patikrinkite, ar valdymo skydelyje mirksi galios lygio indikatoriai, ir paklauskite, ar nesigirdi įjungimo garso.

ĮSPĖJIMAS: prieš įjungiant sistemą griežtai draudžiama leisti bet kokį Ultragarso žirkles sąlytį su ausiniais, kitais instrumentais ar bet kokiais kitais objektais, kad naudotojas nesusižeistų.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Su sistema susiję

- Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas ir laikykitės ligininės klinikinės praktikos gairių, taikomų ultragarsoinei chirurgijai, elektrochirurgijai, ginekologijai ir laparoskopijai.
- Minimaliai invaziniai prietaisai gali kurtis priklausomai nuo gamintojo. Jei vienu metu atliekant operaciją naudojami skirtingų gamintojų minimaliai invaziniai instrumentai ir priedai, prieš operaciją patikrinkite instrumentų ir priedų suderinamumą ir patikrinkite, ar į žmogaus kūną įterpiami priedai neturi šiurkštaus paviršiaus, aštrios briaunos ar išsikisimo, galinčio kelti pavojų saugai.
- Šį prietaisą gali naudoti tik apmokyti ir licencijuoti chirurgai. Nenaudokite elektrochirurginių prietaisų, jei nesate tinkamai apmokyti juos naudoti konkrečiai procedūrai, kurią turėsite atlikti. Neapmokytas šio prietaiso naudojimas gali sukelti netįžinį sunkų paciento sužalojimą, įskaitant žarnos perforaciją ir nesąmoningą bei nepataisomą ausinių nekrozę.
- Neatidarykite korpuso Bateria be leidimo, kad išvengtumėte galimo elektros smūgio pavojaus. Bet kokį prietaiso remontą ir atnaujinimą turi atlikti "Reach Surgical, Inc." apmokytas ir įgaliotas serviso darbuotojas. Nenaudokite šio instrumento jokiais kitais tikslais, išskyrus medicininę chirurgiją.
- Norint išvengti šoko ir nudegimų pavojaus pacientui ir medicinos personalui bei šio prietaiso ar kitų medicinos prietaisų sugadinimo, būtina gerai išmanyti lazerio, elektrochirurgijos ir ultragarso procedūrų principus ir metodus. Negalima pažeisti elektros izoliacijos ar įžemimo. Elektrochirurginių prietaisų nemerkitė į skysčius, išskyrus atvejus, kai to reikalauja konstrukcija ir kai etiketėje nurodyta, kad juos reikia panardinti.
- Saugų ir veiksmingą ultragarsoinę chirurgiją ir elektrochirurgiją priklauso ne tik nuo įrangos konstrukcijos, bet ir nuo daugelio operatoriaus kontroliuojamų veiksnių. Norėdami padidinti saugumą ir efektyvumą, perskaitykite, supraskite ir laikykitės kartu su prietaisu pateiktų naudojimo instrukcijų.
- Kaip ir naudojant visus energijos šaltinius (elektrochirurginius, lazerinius ar ultragarso), reikėtų atsivėlgti į kancerogeninę ir infekcinę riziką, kurią gali kelti daugelis ausinių šaltinių produktų, pavyzdžiui, dūmai ir aerosoliai. Atliekant atvirus, tiek endoskopines procedūras reikėtų laikytis atitinkamų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, naudoti apsauginius akinus, filtravimo kaukes ir veiksmingą dūmų šalinimo įrangą.
- Išėmę prietaisą, patikrinkite, ar ausiniai nėra hemostazuoti. Jei hemostazės nėra, reikia naudoti tinkamus metodus hemostazės pasiekimui.
- Produktai, kuriuos gamina ar platina bendrovės "Reach Surgical, Inc." neigalios žmonėms, gali būti nesuderinami su šio prietaisu. Naudojant tokius gaminius gali būti gauti netikėti rezultatai ir gali būti sužalotas naudotojas arba pacientas.
- Kad sumažintumėte trūkų riziką, prietaisas ir korpusas turi būti prijungti prie nepriklausomos maitinimo grandinės.
- Įranga netinkama naudoti esant degiam anestetikui mišiniui su oru, deguonimi ar azoto oksidu. Galimas kibirkščiavimas dėl susidūrimo su kitais metaliniais prietaisais. Nuo kibirkščių gali užsidegti degiosios dujos, pavyzdžiui, lauko dujos.
- Jis turi veikti reikiame aplinkos darbinės temperatūros diapazone.
- Išėjimo lizdo įtampa turi atitikti Bateria reikalavimus (skyrus "Sistemos techninės sąlygos"). Netinkamai prijungus maitinimo šaltinį, gali būti sugadintas Bateria ir kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite ilgtinųjų, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
- Nesusiekite įjungimo signalo iki negirdimo lygio. Aktyvavimo tonus gali pastebėti chirurginės komandos personalas, kol Bateria tiekia energiją.
- Įrodyta, kad elektrochirurginių operacijų metu susidarantys dūmai gali pakenkti pacientams ar chirurgijos komandos darbuotojams. Pasiūlykite tinkamą ventiliaciją chirurginių dūmų šalinimui arba kitomis priemonėmis.
- Kai kurie ultragarso chirurginio integruoto prietaiso Bateria komponentai tiekiami sterilūs (pvz., Keitiklis). Prieš pradėdami montuoti sistemą, sterilizuokite gaminį, kaip reikalaujama. Valymo ir sterilizavimo instrukcijų išskaitę kiekvienoje atitinkamoje instrukcijoje.
- Siekiant išvengti naudotojų ar pacientų sužalojimo, prieš paspaudžiant bandymo mygtuką ir sistemos tikrinimo metu Ultragarso žirkles turi būti vengiama kitų prietaisų, chirurginių užvalkalų, pacientų ar kitų objektų. Sistemos tikrinimo ir bandymo metu turi būti įgyvendintos saugos priemonės azerolio atveju (pagal ligininės taisykles).
- Nespauskite žandikaulio per stipriai, kad nesutrikdytumėte ultragarso energijos perdavimo.
- Kad naudotojas nesusižeistų, prieš įjungiant sistemą, išmenys turi vengti sąlytį su ausiniais, kitais prietaisais ar kitais objektais.
- Jei ant Bateria ar jį jį papurškiamo skysčio arba jį pilama skysčio, arba jei Bateria išpilamas ar jį pilamas skystis, jis gali sugadinti Bateria ir sukelti elektros smūgio ar gaisro pavojų.

- Kibirkščiaivimas ir kaitinimas, susijęs su indo uždarymo būdais, gali būti uždegimo šaltiniai. Marlé ir kempinė turi išlikti drėgnos. Elektrochirurginius elektrodus laikykite atokiau nuo degių medžiagų ir deguonies turtingos (O2) aplinkos.
- Jei po valymo ir dezinfekavimo priežiūros yra didelių Keitiklis pažeidimų arba jei po valymo ir dezinfekavimo priežiūros kurios nors dalys turi pažeidimų požymių, jas išmeskite. Pažeistos dalys yra aiškiai pažymėtos, kad prieš vėlesnį tvarkymą būtų išvengta netinkamo naudojimo.
- Vienkartinės atliekos ir elektroninės atliekos turi būti šalinamos pagal ligininės taisyklės ir neturi būti išmetamos savo nuožūra, kad būtų išvengta aplinkos taršos.
- Venkite naudoti Baterija šalia kitos įrangos arba uždėtą ant jos. Jei būtina naudoti greta arba sukrautą, stebėkite Baterija ir kitą įrangą, kad užtikrintumėte tinkamą jos veikimą.
- Prietaise nėra jokių operatoriaus aptarnaujamų dalių. Dėl aptarnavimo kreipkitės į "Reach Surgical" prekybos atstovą arba aptarnaujantį personalą.
- Prieš naudodami patikrinkite visus prietaisus ir jungtis. Patikrinkite, ar prietaisai veikia taip, kaip numatyta. Dėl netinkamo sujungimo gali atsirasti elektros lanko, kibirkščiaivimo, prietaiso veikimo sutrikimų arba nenumatytų chirurginių rezultatų.
- Kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus, ši įranga turi būti jungiama tik prie maitinimo šaltinio su apsauginiu įžeminimu.
- Laikykitės kuo toliau nuo Baterija ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., monitorių). Nekryžiuokite ir nesieskite elektros laidų su elektroniniais prietaisais. Baterija gali sukelti trukdžių kitiems elektroniniams prietaisams.
- Sistemą reikia atsargiai naudoti, kai yra vidinių ir išorinių širdies stimuliatorių. Dėl trukdžių, atsirandančių naudojant Elektrochirurginiai instrumentai, širdies stimuliatorius gali pereiti į asinchroninę būseną arba visiškai nustoti veikti. Kai elektrochirurgijos ar audinių sandarinimo prietaisus ketinama naudoti pacientams, turintiems širdies stimuliatorių, dėl papildomos informacijos kreipkitės į širdies stimulatoriaus gamintoją arba ligininės kardiologijos skyrių.
- Būkite atsargūs, jei prietaisus kraunate ant Baterija arba dedate Baterija ant elektrinių prietaisų. Tokia konfigūracija yra nestabili ir neužtikrina tinkamo aušinimo.
- Jei Baterija neveikia, gali būti nutrauktas chirurginis gydymas. Turi būti atsarginė sistema.
- Jei to reikalaujama pagal vietines taisykles, Baterija turi būti prijungtas prie ligininės ekvipotencialo jungties naudojant ekvipotencialo kabelį.
- Kai sistema ir fiziologinio stebėjimo įranga tuo pačiu metu naudojama tam pačiam pacientui, bet kuris stebėjimo elektrodas turi būti kuo toliau nuo prietaiso.
- Naudojami pagrindinį dvipolį režimą, norimą efektui pasiekti pasirinkite mažiausią įmanomą išėjimo galią.
- Sugedus aukšto dažnio chirurginei įrangai, gali netikėtai padidėti išėjimo galia.
- Į Baterija ir pagrindinę bipolinę elektrochirurgijos jungtį gali patekti vandens ar kietųjų dalelių. Naudojant ir valant būtina vengti vandens ar kietųjų dalelių patekimo.
- Kai sistema naudojama kartu su endoskopu, gali padidėti nuotėkio srovė į paciento kūną. Procedūros metu būkite atidūs.
- Pranešimas naudotojui ir (arba) pacientui, kad apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, reikia pranešti bendrovei "Reach Surgical, Inc." per Reachquality@reachsurgical.com ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Su priemone susijusios priemonės

Atliekant chirurgines procedūras svarbu žinoti, kad instrumento Ultragarso žirkklės, Ultragarso žirkklės pado ir Velenas galinės dalies temperatūra gali būti padidėjusi, kai ultragarso arba bipolinio elektrokauteriu ilgą laiką veikiama audiniai. Siekiant užtikrinti saugumą, labai svarbu vengti bet kokio atsitiktinio šių instrumentų komponentų sąlyčio su audiniais, chirurginiais apdangalais, chirurginiais chalatais ar kitomis nesujusiomis vietomis procedūros metu. Be to, labai svarbu atsargiai išdėstyti dvipolį instrumentą. Ypač jo negalima dėti šalia degių medžiagų, tokių kaip marlé ar chirurginiai apdangalai, arba liestis su jomis. Naudojant bipolinis instrumentus gali išsiskirti šiluma, dėl kurios gali kilti gaisro pavojus. Kai bipolinis elektrochirurginis instrumentas Baterija nenaudojamas, jis turėtų būti tinkamai laikomas apsauginiame dėkle arba saugiu atstumu nuo paciento, chirurginės komandos narių ir bet kokių degių medžiagų.

PASTABA: Papildomų įspėjimų ir atsargumo priemonių ieškokite atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.

EMC informacija

Gaminys praėjo elektromagnetinio suderinamumo bandymą, kuris atitinka IEC60601-1-2 standarto medicinos įrangai keliamus apribojimų reikalavimus. Šie apribojimai užtikrina pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių įprastuose mediciniuose įrenginiuose.

Produkto sudėtis

Serijos numeris	Dalies pavadinimas	Modelio / versijos Nr.	Pastabos
1	Elektrochirurgijos instrumentas	OP9	/
2	Ultragarso chirurginės įrangos keitiklis	TRA6	Suderinamas naudojimas
3	Ultragarso žirkklės Vienkartinio naudojimo sistema Ultragarso žirkklės	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Suderinamas naudojimas
4	Vienkartinis ultragarsinis aukšto dažnio chirurgijos įrenginys Audinių sandariklis	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultragarsinis kojinis jungiklis	OP-FSD	/
6	Elektrochirurginis kojinis jungiklis	OP-FSS	/
7	Elektrochirurgijos bipolinė jungtis	OP-BPC	/

Produkto kabelis

Serijos numeris	Kabelio pavadinimas	Ilgis (m)	Ekranuotas
1	Kojinio valdymo kabelis	3	Taip
2	Maitinimo laidas	5	Ne
3	Bipolinis elektrochirurginis kabelis	3	Ne
4	Keitiklis laidas	2.9	Taip

EMC veikimas

Šią įrangą gali veikti radijo dažnių trukdžiai, kuriuos sukelia kita medicinos įranga ir radijo ryšys. Siekiant išvengti tokių trukdžių, šis gaminys buvo išbandytas pagal IEC 60601-1-2 ir atitinka jo reikalavimus. Tačiau "Reach Surgical, Inc." negarantuoja, kad individualioje įrengimo aplinkoje nebus absoliučiai jokių trukdžių.

Jei nustatoma, kad prietaisas patiria trukdžių (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojas (arba bendrovės "Reach Surgical, Inc." patvirtintas techninės priežiūros personalas) turėtų pabandyti imtis vienos ar kelių toliau nurodytų priemonių trukdžių problemai išspręsti:

Sureguliuokite prietaiso, kuris daro [taką, kryptį] arba padėtį.

Padidinkite atstumą tarp šio įrenginio ir siunčiančiojo įrenginio.

Šiai įrangai maitinti naudokite kitus maitinimo šaltinius (o ne tuos, kurie naudojami įrangai paveikti).

Dėl kitų pasiūlymų kreipkitės į tiekėją arba techninės priežiūros atstovą.

Gamintojas neatsako už bet kokius trūkščius, atsirandančius dėl šių priežasčių: naudojant kitus nei rekomenduojami jungiamuosius kabelius; keičiant ar modifikuojant šią įrangą be leidimo. Dėl neleistinų pakeitimų ar modifikacijų įranga gali prarasti veiksmingumą. Visų tipų elektroninė įranga gali kelti elektromagnetinius trūkščius kitai įrangai per orą ar kitus pries jos prijungtus kabelius. Šalia šio prietaiso nenaudokite prietaisų, galinčių skleisti radio bangų signalus, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, radio siųstuvų ar radio valdymo produktų, nes dėl to šio prietaiso veikimas gali neatitikti nurodytų specifikacijų. Kai tokie prietaisai yra arti šio prietaiso, išjunkite šių prietaisų maitinimą. Medicinos personalas, atsakingas už šį įrenginį, turėtų instruktuoti technikus, pacientus ir kitą personalą, kuris gali būti arti šio įrenginio, kad jie visiškai laikytųsi pirmiau nurodytų reikalavimų. Kad būtų visiškai užtikrintas nurodytas EMC veikimas, naudotojas turėtų teisingai sumontuoti gaminį pagal vadove aprašytus veiksmus. Jei kyla su EMC susijusių problemų, kreipkitės į "Reach Surgical, Inc." patvirtintą techninės priežiūros personalą. Ketiklis (su kabeliu) ir Ultragarso žirkklės apibrėžiamos kaip visos sistemos taikomoji dalis.

Atsargumo priemonės montuojant gaminį

Įranga gali būti naudojama ligoninės aplinkoje, tačiau joje nėra radio dažnio ekranavimo patalpų aplink aktyvią radio dažnio chirurginę įrangą arba ten, kur yra magnetinio rezonanso poveikio įranga, nes elektromagnetinių trikdžių intensyvumas šiose vietose yra didelis.

Atstumas ir stacionarus radio ryšio įrangos poveikis: magnetinio lauko stipris, kurį sukurs stacionarus siųstuvai, pavyzdžiui, belaidžių (mobiliųjų / belaidžių) telefonų bazinės stotys, antžeminio judriojo radio ryšio imtuvai, mėgėjiški radio imtuvai, AM ir FM radio laidos, televizijos laidos Bateria ir t. t., negali būti tiksliai išmatuotas teoriškai. Norint įvertinti stacionariųjų radio dažnių siųstuvų sukuriama elektromagnetinę aplinką, reikėtų apsarstyti galimąbę išmatuoti elektromagnetinį lauką. Jei išmatuota magnetinio lauko stiprio vertė prietaiso buvimo vietoje viršija atitinkamą radio dažnio lygį, nurodytą "Apsaugos nuo trikdžių pareiškime", prietaisas turėtų būti patikrintas, siekiant įsitikinti, kad jis gali normaliai veikti. Jei nustatomos neįprastos veikimo sąlygos, reikėtų apsarstyti gaminį atlikę papildomus matavimus, pavyzdžiui, perorientuoti ar perkelti įrenginį arba naudoti antiradijo dažnių patalpą.

- 1) Naudokite "Reach Surgical, Inc." pateiktą arba nurodytą maitinimo laidą. Gaminius, kuriuose įrengtas maitinimo kištukas, reikia jungti į stacionarų elektros lizdą su apsauginiu įžeminimu. Maitinimo kištukui prijungti nenaudokite jokių adapterių ar jungčių.
- 2) Kiek įmanoma labiau laikykite šį prietaisą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų.
- 3) Vykdykite veiksmus, kad prijungtumėte įrenginį.

Bendrosios pastabos

(1) Kabelio specifikacija.

Naudojant "Reach Surgical, Inc." pateiktus kabelius, šio gaminio elektromagnetinio suderinamumo charakteristikos nebus pažeistos. Jei naudojami nenurodyti kabeliai, šios įrangos EMC charakteristikos gali gerokai suprastėti.

(2) Atsargumo priemonės dėl neleistinų pakeitimų

Naudotojas neturi modifikuoti šio gaminio, nes priešingu atveju gali sumažėti šio gaminio EMC charakteristikos.

Produktu modifikacija apima šiuos pakeitimus:

- a. Kabelis (ilgis, medžiaga, laidai ir t. t.).
- b. Įrangos montavimas ir išdėstymas.
- c. Įrangos konfigūracija ir (arba) komponentai.
- d. Įrangos apsaugos dalys (dangčio atidarymo/uždarymo ir dangčio tvirtinimo dalys).

(3) Naudojant įrangą visi apsauginiai dangteliai turi būti uždaryti.

Tikimasi, kad šis gaminys bus naudojamas toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje, todėl šio gaminio pirkėjas ir naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų naudojamas šioje elektromagnetinėje aplinkoje.

Esminės naštumas

1. Pažangiosios aukšto dažnio radio energijos išvesties atveju sistema turi užtikrinti, kad vardinės išvesties galios nuokrypis neviršytų 20 % standartinės vertės.

2. Pagrindinio aukšto dažnio radio energijos išėjimo atveju sistema turi užtikrinti, kad vardinės išėjimo galios nuokrypis neviršytų 20 % standartinės vertės.

Gairės ir gamintojo deklaracija - ELEKTROMAGNETINIAI IŠLAIDOS			
Prietaisas skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba įrenginys naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.			
Įšmetamųjų teršalų bandymas	Atitiktis	Elektromagnetinė aplinka - rekomendacijos	
RF spinduliuotė CISPR 11	1 grupė	Įrenginys naudoja radio dažnių energiją tik savo vidinei funkcijai. Todėl jo skleidžiamos radio dažnių bangos yra labai mažos ir negali sukelti jokių trūkščių netoliese esančiai elektrinei įrangai.	
RF spinduliuotė	A klasė	Šios įrangos EMISIJŲ charakteristikos leidžia ją naudoti pramoninėse zonose ir ligoninėse.	
Harmoninė srovė IEC 61000-3-2	A klasė		
Įtampos pokyčiai / įtampos svyravimai / mirgėjimas IEC 61000-3-3	Atitinka		

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija - elektromagnetinis atsparumas

Prietaisas skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.

Klientas arba prietaiso naudotojas turėtų užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

IMUNITETO testas	IEC 60601 bandymo lygis	Atitikties lygis	Elektromagnetinė aplinka - rekomendacijos
Elektrostatinis iškrovis (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontaktas ± 2,4,8,15 kV oras	± 8 kV kontaktas ± 2,4,8,15 kV oras	Grindys turėtų būti medinės, betoninės arba keraminių plytelių. Jei grindys padengtos sintetine medžiaga, Santykinis oro drėgmė turi būti ne mažesnis kaip 30 %.
Greitas elektrinis perinamasis procesas ir (arba) sproginimas IEC 61000-4-4	± 2 kV elektros tiekimo linijoms ± 1 kV įvesties ir išvesties linijoms	± 2 kV elektros tiekimo linijoms ± 1 kV įvesties ir išvesties linijoms	Maitinimo tinklo kokybė turėtų atitikti tipinės komercinės ar ligoninės aplinkos kokybę.
Virsmo bangos IEC 61000-4-5	± 1 kV linija (-os) - linija (-os) ± 2 kV linija (-os) į žemę	± 1 kV linija (-os) iki linijos (-ų) ± 2 kV linija (s) į žemę	Maitinimo tinklo kokybė turėtų atitikti tipinės komercinės ar ligoninės aplinkos kokybę.
Įtampos kritimai, trumpas pertraukos ant maitinimo šaltinio įvesties linijų IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciklo 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ir 315° kampu 0 % UT; 1 ciklas ir 70 % UT; 25/30 ciklų Vienfazis: esant 0° 0 % UT; 250/300 ciklų	0 % UT; 0,5 ciklo 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ir 315° kampu 0 % UT; 1 ciklas ir 70 % UT; 25/30 ciklų Vienfazis: esant 0° 0 % UT; 250/300 ciklų	Maitinimo tinklo kokybė turėtų atitikti tipinės komercinės ar ligoninės aplinkos kokybę. Jei ultragarso chirurginio aparato naudotojas įranga turi toliau veikti nutrūkus elektros energijos tiekimui, rekomenduojama, kad ultragarso chirurgijos įranga turi būti maitinama iš nepatraukiamo maitinimo šaltinio arba akumuliatoriaus.
Maitinimo dažnis (50/60 Hz) Magnetinis laukas IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Maitinimo dažnis magnetinis laukai turėtų būti charakteringo lygio. Tipinės vietos tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje.

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija - elektromagnetinis atsparumas			
Įrenginys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba prietaiso naudotojas turėtų užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje.			
IMUNITETAS testas	IEC 60601 bandymas lygis	Atitikties lygis	Elektromagnetinė aplinka - rekomendacijos
Laidusis radijo dažnis IEC 61000-4-6	3 Vrms Nuo 150 kHz iki 80 MHz 6 V ISM juostose nuo 0,15 MHz iki 80 MHz	3V	Nešiojamieji ir mobilieji radijo dažnių ryšiai Įranga turi būti naudojama ne arčiau bet kurios prietaiso dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo dažnio lygtį. Rekomenduojamas atstumas $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$
Spinduliuojamas radijo dažnių bangos IEC 61000-4-3	3 V/m Nuo 80 MHz iki 2,7 GHz 80 % AM esant 1 kHz dažniui	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ Nuo 80 MHz iki 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ Nuo 800 MHz iki 2,7 GHz kur P - didžiausia vardinė išėjimo galia siųstuvo galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją, o d - rekomenduojamas atstumas metrais (m). Stacionariųjų radijo dažnių siųstuvų lauko stipris, nustatytas atlikus elektromagnetinę vietos apžiūrą 3 kiekviename dažnių diapazone turėtų būti mažesnis už atitikties lygį. Šalia toliau nurodytu simboliu pažymėtos įrangos gali atsirasti trikdžių:  ME ĮRANGA ir ME SISTEMOS ĮRENGINIŲ UŽDARYMO PRIEINKLAS turi būti bandomas, kaip nurodyta IEC 60601-1-2 9 lentelėje, taikant IEC 61000-4-3 nurodytus bandymų metodus.

Rekomenduojami atstumai tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo ryšio įrangos ir prietaisų.			
Ultragarsinis chirurginė įranga skirtas taikyti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje kontroliuojami skleidžiami radijo dažnių trikdžiai. Įrenginio klientas arba naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trikdžių, išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo dažnių ryšio įrangos (siųstuvų) ir įrenginio, kaip rekomenduojama toliau., atsižvelgiant į didžiausią ryšio įrangos išėjimo galią.			
Maksimali vardinė siųstuvo išėjimo galia (w)	Atstumas pagal siųstuvo dažnį /m		
	Nuo 150 kHz iki 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	Nuo 80 MHz iki 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	Nuo 800 MHz iki 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

PASTABA: Šios gairės gali būti taikomos ne visais atvejais. Elektromagnetinių spindulių sklidimui įtakos turi absorbcija ir atspindys nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių.

Techninės sąlygos

Sistemos veikimui reikalingi komponentai: Keitiklis, Ultragarsinis kojinis jungiklis, Elektrochirurginis kojinis jungiklis, Ultragarso žirkklės arba Elektrochirurgijos rankenos, elektrochirurgijos bipolinė jungtis Bipolinis instrumentas.

Žr. šio komponento aprašymą.


Apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis	Ultragarsas:  CF tipo taikomoji dalis; dvipolė elektrochirurginė -  CF tipo defibriliacijai atspari taikomoji dalis
Apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis	I klasė
Baterija iki kenksmingų infuzijų	Įprasta įranga
Apsaugos nuo kenksmingo vandens patekimo laipsnis	Kojų jungiklis: IP68
Valdymo kategorija	IIb klasė
Ultragarso režimo parametrų reikalavimai:	
Įvesties galia	Maitinimo įtampa: 100-240 V Maitinimo dažnis: 50 Hz/60 Hz Įvesties galia: 400VA
Ultragarso režimo parametrų reikalavimai:	
Sužadavimo dažnis	54 kHz - 57 kHz
Pirminio antgalio vibracijos sužadinimas	25 μm - 110 μm
Ultragarso žirkklės antgalis pagrindinis akustinis išėjimo paviršius Produktas:	1,53~2,75 mm2
Antrinis kryžminis ryšys Akustinis ties Ultragarso žirkklės antgalio išvesties sritis:	19,32~35,88 mm2
Išvestinis išvesties garsas Ultragarso žirkklės antgalio etaloniniame antgalyje Pirminė amplitudė Galia	< 30W
Sistemos dažnio valdymo tipas	Neapribojama nuo apkrovos, sužadavimo dažnis automatiškai nuolat reguliuojamas.
Galios rezervo indeksas	Ne mažiau kaip 2,5
Reikalavimai elektrochirurgijos parametrams:	

Darbo dažnis	400 KHz \pm 5 %
Maksimali išėjimo įtampa	\leq 250V
Išplėstinis dvipolis režimas Maksimali išėjimo srovė	\leq 5.5A
Pagrindinis bipolinis režimas Maksimali išėjimo srovė	\leq 2.2A
Didžiausia išėjimo įtampa nuo smailės iki smailės	\leq 500Vpk
Piko koeficientas	1.6 \pm 0.4
Nominatioji galia	Radio dažnio pažangi dvipolė: 270 W Radio dažnis Pagrindinis dvipolis: 95W
Nominali apkrova	Radio dažnio pažangi dvipolė: 30 Ω Radio dažnis Pagrindinis dvipolis: 200 Ω

Darbo aplinkos sąlygos	Temperatūra: nuo 10 °C iki 30 °C
	Santykinė oro drėgmė: \leq 70 %
	Atmosferos slėgio diapazonas: nuo 800 hPa iki 1060 hPa
Transportavimo ir laikymo sąlygos	Temperatūra: nuo -30 °C iki +55 °C (Baterija, kojinis jungiklis, adapteris)
	Temperatūra: nuo -10 °C iki +55 °C (Ultragarso žirkklės)
	Drėgmė: \leq 80 %
	Atmosferos slėgio diapazonas: nuo 800 hPa iki 1060 hPa
Pagaminimo data	Pagaminimo datą galima nustatyti pagal serijos numerį, esantį galiniame Baterija skydelyje.
Maitinimo laidas	Atitikti CCC sertifikavimo reikalavimus Dabartinis įvertinimas: 10A
Pastovumo rodiklis	Nustatoma pagal Keitiklis antgalį ir naudojamą Ultragarso žirkklės. Informacijos apie patvarumo normą ieškokite taikomuose Ultragarso žirkklės ir Keitiklis rankinio antgalio instrukcijos arba 7 skyrius "Išpėjimai ir atsargumo priemonės".
Saugiklis	ϕ 5 * 20 T8AH250V
Svoris (be pakuotės)	Baterija: vardinis svoris 8 kg
Bendras tūris	OP9 Baterija: (ilgis * plotis * aukštis): (ilgis (cm): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispozicija	Kai kuriuose vidiniuose Baterija, kojinio jungiklio ir kojinio jungiklio kabelio komponentuose yra švino. Pagal vietinius reikalavimus Šalinimo reikalavimai ir taisyklės. Baterijas šalinkite laikydamiesi tinkamos atliekų šalinimo praktikos.
AP/APG klasifikacija	Ne AP/APG įranga.
Tarnavimo laikas:	Tarnavimo laikas: 7 metai
Programinės įrangos išleidimo versija	V01.01

Bipolinė išėjimo bangos forma


Išplėstinė dvipolio išėjimo galios ir apkrovos kreivė

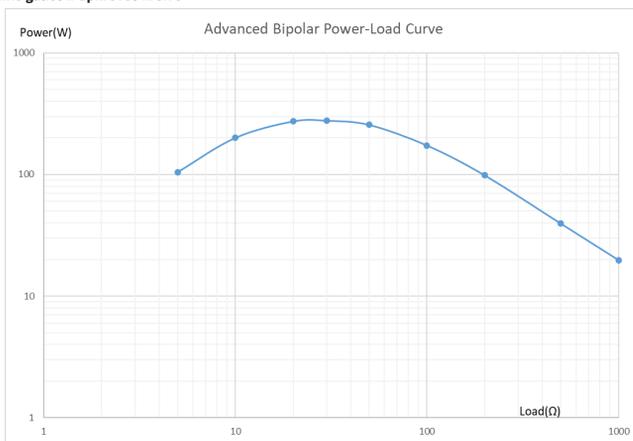

Galios kreivės riba Maksimalus išėjimas: 270[W]			
Apkrova (Ω)	Apatinė riba	Nominalus	Viršutinė riba
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Nominali 270 vatų galios kreivė, esant vardinei apkrovai, pagal galios kreivės matuoklio srovės/tampos ribą. Galios kreivė vaizduoja apvalkalą, kuris kinta darbo sąlygomis.

Pagrindinė bipolinio išėjimo visos galios ir apkrovos kreivė

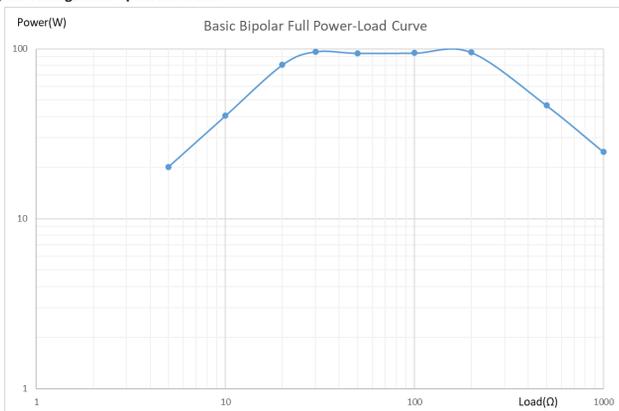


Visiškos galios kreivės riba [W]: Maksimali galia 95 W			
Apkrova (Ω)	Apatinė riba	Nominalus	Viršutinė riba
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Pagrindinė dvipolio išėjimo pusės galios ir apkrovos kreivė

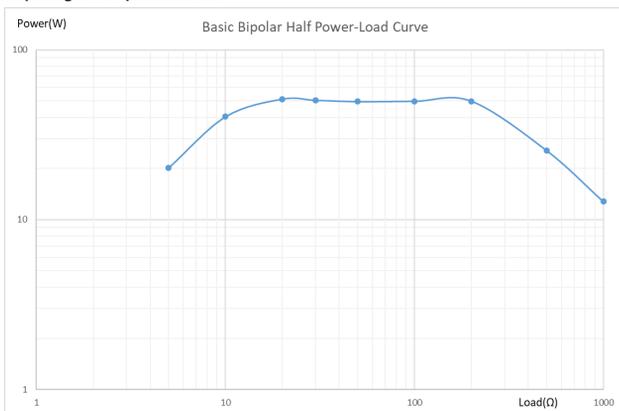

Pusės galios kreivės riba [W]: Maksimali galia 50 W			
Apkrova (Ω)	Apatinė riba	Nominalus	Viršutinė riba
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Išėjimo galios priklausomybė nuo galios nustatymų esant normaliam dvipoliariui

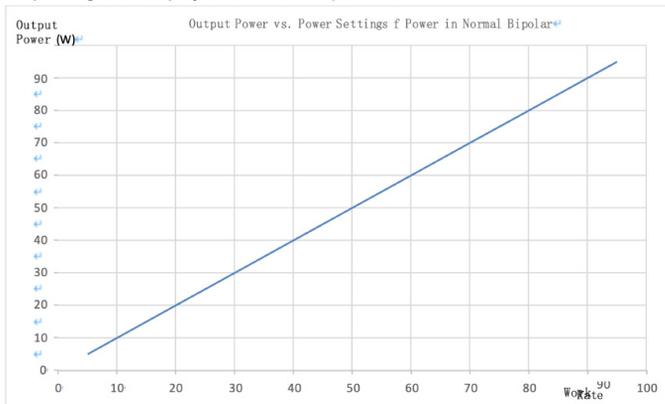

Išėjimo galios priklausomybė nuo nustatytos galios vertės normaliam dvipoliariui [W]; apkrova: 200Ω			
Nustatyta galia (W)	Išėjimo galios apatinė riba (W)	Nominalioji galia (W)	Viršutinė išėjimo galios riba (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Apptarnavimas ir garantija

"Reach Surgical, Inc." garantuoja, kad šis gaminys neturės medžiagų ir gamybos defektų, jei jis bus naudojamas įprastai ir bus atliekama profilaktinė priežiūra, toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu. Pagal šią garantiją "Reach Surgical" įsipareigojimai apsiriboja tik tuo, kad savo nuožūria pataiso arba pakeičia bet kurį gaminį ar jo dalį su defektais, gražintą "Reach Surgical, Inc." arba jos įgaliotajam platintojui per taikomą garantinį laikotarpį ir pripažintą turinčiu defektų, kurie tenkina "Reach Surgical". Ši garantija netaikoma gaminiams ar dalims, kurie buvo:

- Neigiamas poveikis dėl naudojimo su neautorizuotais prietaisais, kuriuos pagamino arba platina "Reach Surgical, Inc." neįgaliosios šalys.
- Remontuoti ar keisti ne "Reach Surgical" gamykloje, jei tai turi įtakos prietaiso stabilumui ar patikimumui, kaip nustatė "Reach Surgical".
- Dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo ar nelaimingo atsitikimo.
- Naudojamas nesilaikant gaminio konstrukcijos, naudojimo parametrų, instrukcijų ir gairių arba pramonėje pripažintų panašių gaminių funkcinių, eksploatavimo ar aplinkosaugos standartų.

Garantiniai laikotarpiai

Pagrindinė dvipolė energijos jungtis (OP-BPC): 1 metai komponentams ir darbui.

Baterija (OP9): 1 metai sudedamosioms dalims ir darbui.

Kojinis jungiklis / maitinimo laidas: 1 metai komponentams ir darbui.

Ši garantija yra vienintelė pirminio pirkėjo teisių gynimo priemonė ir pakeičia visas kitas aiškias ar numanomas garantijas, įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. "Reach Surgical, Inc." neatsako už jokią specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą, įskaitant žalą, atsiradusią dėl naudojimo, pelno, verslo ar geros reputacijos praradimo, išskyrus atvejus, aiškiai numatytus galiojančiuose įstatymuose.

Bendrovė "Reach Surgical, Inc." neigalioja jokio asmens prisiimti jokios papildomos atsakomybės, susijusios su jos gaminių pardavimu ar naudojimu. Nėra jokių garantijų, viršijančių čia nurodytas sąlygas.

"Reach Surgical, Inc." pasilieka teisę keisti savo gaminius, neprisiimdama jokių įsipareigojimų atgaline data taikyti šiuos pakeitimus anksčiau parduotiems ar pagamintiems gaminiams.

Pārskats

Pirms šīs ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet turpmāk sniegto informāciju. Tajā sniegti svarīgi norādījumi par pareizu lietošanu, iespējamajiem riskiem un iespējamajiem bojājumiem produktam vai personām. Jebkuras neparastas situācijas gadījumā ievērojiet norādītos norādījumus, lai novērstu kaitējumu sev vai iekārtas bojājumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt drošības, veiktspējas, garantijas vai apkopes traucējumus, par kuriem ražotājs nevar uzņemties atbildību. Pirms ierīces lietošanas izlasiet arī instrukcijas, kas attiecas uz Pārveidotājus un Ultraskaņas šķēres. Šis dokuments ir izstrādāts, lai palīdzētu lietot šo ierīci. Tas nav atsauce uz ķirurģiskām metodēm.

Izmantotās standartas konvencijas: Brīdinājums, Brīdinājums un Piezīme.

Nemiet vērā šādus paziņojumus, kas klasificēti kā UZMANĪBU, BRĪDINĀJUMS vai PIEZĪME un kas sniedz būtiskus norādījumus, lai uzdevumus veiktu droši un rūpīgi. Šie paziņojumi ir atrodami visā dokumentācijā, un tie ir jāizlasa, pirms tiek veikts nākamais procedūras solis.

BRĪDINĀJUMS: Šis paziņojums uzsvēr ekspluatācijas vai tehniskās apkopes procedūru, praksi vai apstākļus, kuru neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai dzīvības zaudēšanu.

UZMANĪBU: Šis paziņojums brīdina lietotāju par potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās netiek novērsta, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus ievainojumus lietotājam vai pacientam, kā arī iekārtas vai cita īpašuma bojājumus. Tas var kalpot arī kā brīdinājums par nedrošu praksi. Tas ietver nepieciešamos piesardzības pasākumus droši un efektīvai Instrumenta lietošanai un nepieciešamo piesardzību, lai novērstu bojājumus, kas radušies pareizas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

PIEZĪME: Šis apgalvojums norāda darbības praksi vai nosacījumu, kas ir būtisks uzdevuma efektīvai izpildei.

Apraksts

ENER REACH elektroķirurģisko instrumentu (turpmāk tekstā - "ierīce") izmanto medicīnas operāciju zālēs ķirurģiskām procedūrām, lai grieztu, koagulētu cilvēka audus un sasiētu asinsvadus. Tam ir divas atsevišķas atveres: viena ultraskaņas enerģijai un otra radiofrekvences viļņu formai.

Radiofrekvences režīmā ģenerators nodrošina dažādas enerģijas shēmas atkarībā no pievienotā instrumenta/elektroķirurģijas ierīces. Ja ir pieslēgts moderns bipolārs instruments, ģenerators nodrošina radiofrekvences viļņu shēmas arteriālo un venozo asinsvadu, limfātisko sistēmu un ausu saišķu līdz 7 mm diametrā slēgšanai. Kad ir pievienots pamata bipolārais instruments, tiek raidīta nemainīga jaudas enerģija miksto ausu griešanai un koagulācijai.

Ultraskaņas enerģijas izejas režīmā, izmantojot TRA6 Pārveidotājs kopā ar Vienreizlietojamās ultraskaņas šķēres CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, ierīce griež mikstos audus, kam nepieciešama asiņošanas kontrole un minimāli termiskie bojājumi, un aizzīmogo asinsvadus līdz maksimālajam diametram 5 mm. Savienojumā ar Vienreizlietojamās ultraskaņas šķēres SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 un SRE45 ierīce griež mikstos audus, kam nepieciešama asiņošanas kontrole un minimāli termiski bojājumi, un aizzīmogo asinsvadus līdz maksimālajam diametram 7 mm.

Paredzētais lietojums

Ierīce nodrošina radiofrekvences jaudu, lai darbinātu elektroķirurģiskos uzgaļus, kas paredzēti asinsvadu griešanai un hermetizācijai, kā arī ausu griešanai, satveršanai un šķelšanai.

Turklāt ģenerators nodrošina ultraskaņas jaudu, lai darbinātu ultraskaņas ķirurģiskos instrumentus, kas paredzēti miksto ausu griezumiem, kad nepieciešama asiņošanas kontrole un minimāli termiskie bojājumi.

Indikācijas

Ierīce nodrošina radiofrekvences jaudu, lai darbinātu elektroķirurģiskos uzgaļus, ko izmanto atvērtu operāciju vai laparoskopisku operāciju laikā vispārējās, pediatriskās, ginekoloģiskās, uroloģiskās, torakālās ķirurģijas operācijās, lai grieztu un aizzīmogu asinsvadus līdz 7 mm (ieskaitot), kā arī grieztu, satvērtu un šķeltu ausus.

Turklāt ģenerators nodrošina jaudu, lai darbinātu ultraskaņas ķirurģiskos instrumentus, kas paredzēti miksto ausu griezumiem, kad nepieciešama asiņošanas kontrole un minimāli termiskie bojājumi. Ultraskaņas ķirurģiskos instrumentus var izmantot kā elektroķirurģijas, lāzeru un tērauda skalpeļu papildinājumu vai aizstājēju ausu griešanai un/vai koagulācijai atklātās operācijās vai laparoskopiskās operācijās vispārējās, pediatriskās, ginekoloģiskās, uroloģiskās, krūšu kurvja operācijās, kā arī limfātisko asinsvadu aizzīmogošanai un pārgriešanai.

Paredzētais lietotājs

Ierīce ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem ķirurģiskām vajadzībām.

Paredzētā lietošanas vide

Ierīce ir paredzēta lietošanai slimnīcā.

Paredzētā pacientu populācija

Šī ierīce ir piemērota pacientiem vecumā no 3 gadiem, kuriem nepieciešamas ķirurģiskas procedūras, kas saistītas ar miksto ausu griezumiem, kontrolējot asiņošanu un minimālu termisko ievainojumu.


Klīniskais ieguvums

Ierīci var droši un efektīvi izmantot asinsvadu, ausu saišķu un limfātisko sistēmu ligācijai un sadalīšanai.

Kontrindikācijas

Šī ierīce ir kontrindicēta kaulu iegriezumiem, kontrceptīvo olvadu oklūzijām un koagulācijas procedūrām. To nav paredzēts lietot arī neiroķirurģijā.

Sistēmas sastāvs

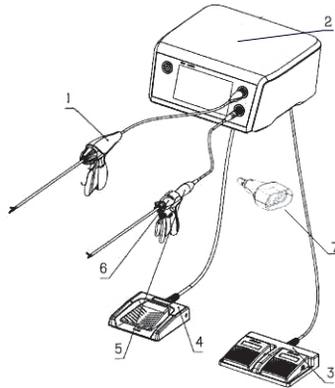

[01] Elektroķirurģijas rokas instrumenti	[02] OP9 ģenerators
[03] Ultraskaņas kāju slēdzis	[04] Elektroķirurģiskais kājas slēdzis
[05] Pārveidotājs	[06] Ultraskaņas šķēres
[07] Elektroķirurģijas bipolārs pārveidotājs	

[01] Elektroķirurģiskais rokas instruments

Procedūras laikā ķirurgs darbina elektroķirurģisko rokas uzgali, kas savienota ar ģeneratoru. Tas pieliek radiofrekvenču elektroķirurģisko enerģiju audiem starp tās Spiles, lai koagulētu vai hermetizētu. Instrumentam ir arī asmens audu sadalīšanai. Modelis: OSA23, OSA37, OSA44. Sīkāku informāciju skatīt instrukcijā.

[02] OP9 ģenerators

Ģenerators nodrošina gan elektroķirurģisko enerģiju, gan ultraskaņas terapijas enerģiju, izmantojot atsevišķas instrumentu pieslēgšanas pieslēgvietas. Tas sastāv no šasijas, apvalka, elektroniskās plates, LCD skārienekrāna, strāvas slēdža un saskarnēm piederumu pieslēgšanai.

Modelis: OP9

[03] Ultraskaņas kāju slēdzis

Izmanto ultraskaņas enerģijas ieslēgšanas/izslēgšanas kontrolei ar diviem slēdžiem ("MIN" un "MAX"). Modelis: OP-FSD

[04] Elektroķirurģiskais kājas slēdzis

Izmanto, lai ar vienu slēdzi kontrolētu augstfrekvences enerģijas ieslēgšanu/izslēgšanu.

Modelis: OP-FSS

[05] Pārveidotājs

Ierīce Pārveidotājs pārveido elektrisko enerģiju no savietojamās ierīces ģeneratora mehāniskajā kustībā instrumenta lāpstiņām. Tas ir atkārtoti lietojams instruments ar ierobežotu kalpošanas laiku. Instruments Pārveidotājs nav sterils, un pirms lietošanas tas jāsterilizē saskaņā ar instrukcijām. Sīkāku informāciju skatīt TR46 Pārveidotājs instrukcijā.

Modelis: TR46.

[06] Ultraskaņas šķēres

Ultraskaņas šķēres izmanto Pārveidotājs mehānisko kustību un nodrošina ultraskaņas enerģiju audu griešanai vai koagulācijai. Jāievēro piesardzība, jo mehāniskā vibrācija nav konstatējama un var netīši ietekmēt jomas, kas nav mērķētas. Ultraskaņas šķēres tiek sterilizēti ar etilēnoksīdu. Ja derīguma termiņš ir pārsniegts vai sterilizācijas iepakojums ir bojāts, Ultraskaņas šķēres nedrīkst lietot un tie jāiznīcina. Sīkāku informāciju skatīt Ultraskaņas šķēres lietošanas instrukcijā.

Ar OP9 ģeneratoru ir saderīgi šādi Ultraskaņas šķēres:

PD sērija: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB sērija: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE sērija: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektroķirurģijas bipolārais savienotājs

Izmanto, lai savienotu pamata bipolāro Elektroķirurģijas instrumentu ar ģeneratora audu koagulāciju.

Modelis: OP-BPC

Ģenerators Priekšējais panelis

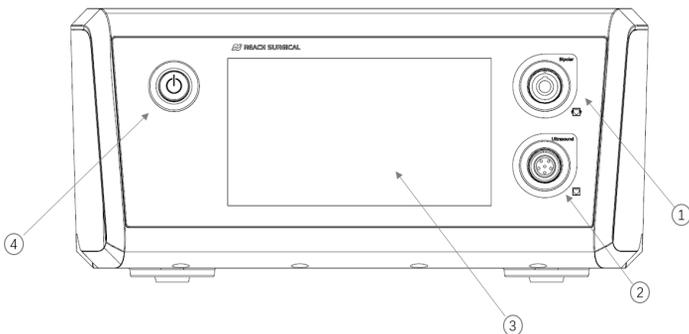

[01] Elektroķirurģiskā ligzda

Izmanto, lai savienotu uzlabotu bipolāro Elektroķirurģijas instrumenti vai elektroķirurģijas bipolāro savienotāju.

[02] Pārveidotājs ligzda


Savieno Pārveidotājs ar ģeneratoru.

[03] LCD skārienekrāns

Tiek rādīta sistēmas informācija un kalpo kā saskarne vadības ierīču un iestatījumu regulēšanai.

[04] Barošanas slēdža poga

Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci ģeneratorā; nospiediet un turiet, lai izslēgtu ierīci.

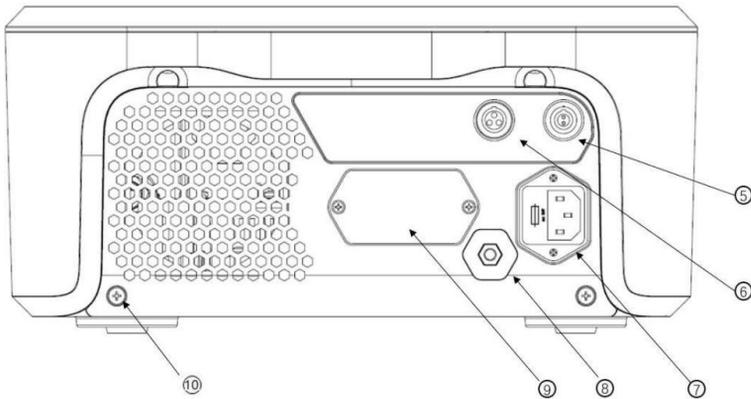ģenerator Aizmugurējais panelis**[05] Elektroķirurģiskā kājslauka ligzda**

Apāļa ligzda elektroķirurģiskā kājslauka pievienošanai.

[06] Ultraskaņas kāju slēdža ligzda

Apāļa kontaktligzda ultraskaņas kājas slēdža pieslēgšanai.

[07] Strāvas kontaktligzda

Savieno barošanas kabeli ar ierīci ģeneratorā.

[08] Potenciāla izlīdzināšanas osta

Ja strāvas kontaktligzdas zemējums ir neskaids, šī pieslēgvietā ļauj pieslēgties aizsargātajam zemējumam.

[09] Paplašināšanas interfeiss

Izmanto funkciju paplašināšanai un uzturēšanai.

[10] Montāžas caurums**Lietošanas instrukcija**

Skatiet sniegtos norādījumus par darba vidi.

Izpakošana

Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus pēc sastāvdaļu saņemšanas.

- Pārbaudiet, vai nav redzamu transportēšanas bojājumu. Ja tiek konstatēti bojājumi, sazinieties ar Reach Surgical, Inc vai vietējo pārstāvi, lai saņemtu palīdzību.

Sastāvdaļas, kas iekļautas (Sīkaku tehnisko specifikāciju un izstrādājumu kodus skatīt nodaļā "Sistēmas tehniskie nosacījumi"):

Modelis	Apraksts	Sastāvdaļa
OP9	ģenerator	ģenerator, barošanas vads, instrukcija
TRA6	Pārveidotājs	Pārveidotājs ar kabeli
OP-FSD	Ultraskaņas kāju slēdzis	/
OP-FSS	Bipolārais kāju slēdzis	/
OP-BPC	Bipolārais enerģijas savienotājs	/

Drošības piesardzības pasākumi

- Iekārtas pārbaudes laikā turiet instrumenta distālo galu tālāk no citiem aparātiem, ķirurģiskajām pārklājumiem, pacienta vai citiem priekšmetiem, lai izvairītos no traumām.
- Ieviest nepieciešamos drošības pasākumus tvaiku klātbūtnē, ievērojot slimnīcas procedūras un noteikumus.

Ultraskaņas enerģija ar PD sēriju Ultraskaņas šķēres

- Savienojiet Pārveidotājs, kāju slēdzi un PD sērijas Ultraskaņas šķēres ar ģeneratoru.
- Pēc Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres testa veikšanas, noregulējiet jaudas līmeni (1-5), izmantojot +/- ikonas uz LCD ekrāna.
- Nospiediet pogu "Min" uz Ultraskaņas šķēres vai Min pedāli uz kājas slēdža, lai aktivizētu ultraskaņas enerģiju iestatītajā jaudas līmenī.
- Nospiediet pogu "Max" uz Ultraskaņas šķēres vai Min pedāli uz kājas slēdža, lai nodrošinātu maksimālo enerģijas līmeni.
- Atļaidiet taustiņu vai kājgaismas slēdzi, lai apturētu enerģijas padevi.

Ultraskaņas enerģija ar SRB/SRE sēriju Ultraskaņas šķēres

- Pēc Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres testa veikšanas, noregulējiet jaudas līmeni (1-5), izmantojot +/- ikonas uz LCD ekrāna.
- Nospiediet Enerģijas poga uz instrumenta vai Min pogu uz pedāļa, lai aktivizētu ultraskaņas enerģiju iestatītajā jaudas līmenī.
- Nospiediet Enerģijas poga ar uzlaboto hemostāzi uz instrumenta, lai aktivizētu uzlaboto hemostāzes režīmu.
- Atļaidiet pogu uz Ultraskaņas šķēres vai pogu uz Kāju slēdzis, lai apturētu enerģijas padevi.

Elektroķirurģiskā bipolārā enerģija ar moderniem bipolāriem instrumentiem

- LCD displejā tiek parādīta uzlabotas bipolārās vadības ikona un regulējamas rokas vadības ikona.
- Lai aktivizētu radio frekvenci, velciet Svira uz instrumenta vai nospiediet kājlēdža pedāli.
- Ierīce ģenerators pārtrauks enerģijas izvadi, kad slēgšana būs pabeigta, par ko ekrānā norāda pabeigšanas ikona.
- Ja savienošana nav pabeigta, atskanēs brīdinājuma signāls un tiks parādīta brīdinājuma ikona.

Elektroķirurģiskā bipolārā enerģija ar bipolāro elektroķirurģijas instrumentu

- LCD ekrānā tiek rādīta jaudas vērtība, regulējamās ikonas un jaudas līmeņa jostas.
- Jaudas iestatījumu diapazons ir no 1 līdz 95 vati ar regulējamu soli.
- Izvēlieties vēlamo izejas jaudas iestatījumu: Izvēlieties zemo (15 vati), vidējo (30 vati) vai augsto (60 vati).
- Nospiediet pogu uz rokas slēdža vai pedāļa, lai aktivizētu radio frekvenci.
- Atlaidiet pogu, lai deaktivizētu enerģijas izvadi.

Ieteikumu iestatīšana

Efektu iestatījumi	Jaudas iestatījumu diapazons	Klīniskā pielietošana	Optimizēta ierīce
Zems	1-15 vati	Piemēram, nervu/ mugurkaula, roku un sejas ķirurģija.	- Ierīces ar mazāku virsmas laukumu - Mikrotīkļveida kņaišes (0,4 - 2,2 mm)
Vidējais	16-40 vati	Piemēram, koagulācija galvas/ kakla, mugurkaula un anatomijas laikā.	- Ierīces ar vidēju virsmas laukumu - Mikrotīkļveida kņaišes (1,0 - 2,2 mm) - Mazas laparoskopiskās kņaišes ar plakanu galvu - Bipolārās šķēres
Augsts	45-95 vati (ar 5 vatu soli)	Piemēram, galvas/ kakla un plastiskā ķirurģija (līdzīga vidējam efektam, bet ar ātrāku iedarbību).	- Ierīces ar lielu virsmas laukumu - Lielas plakangalvas laparoskopiskās kņaišes

PIEZĪME: Šī ierīce nav saderīga ar neitrālo elektrodu.

PIEZĪME: Ultraskaņas šķēres un RF elektriskais skalpelis ir daļas, kas tiek lietotas kontaktā ar pacientu.


Izmantojot ģeneratoru

Ierīces ieslēgšana

- Pēc ieslēgšanas sistēma ir gatava darbam. Kad ierīce ģeneratorā ir pieslēgta elektrotīklam un deg gaidīšanas režīma slēdža indikators, sistēma ir gatava darbam.
- Pēc gaidīšanas režīma pogas nospiešanas tiks parādīts šāds attēls:




- Ja pie ģeneratora nav pieslēgts neviens no Pārveidotājs vai Ultraskaņas šķēres vai ja tie ir nepareizi pieslēgti, tiks parādīts šāds attēls:

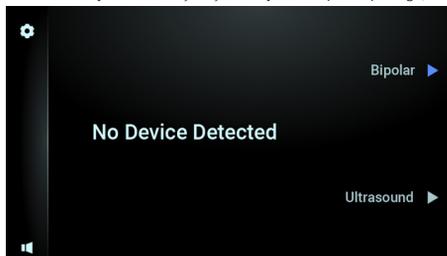

Izmantojot ultraskaņas instrumentu (Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres)

Ja tiek atklāti Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres, tiek parādīts šāds attēls.

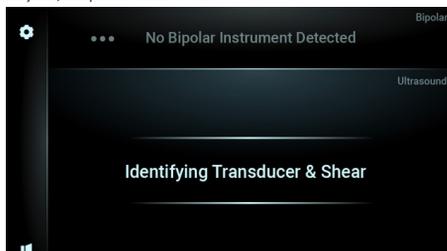

PIEZĪME: Ja Pārveidotājs atlikušais izmantošanas laiks ir mazāks par 10, tiks parādīts šāds attēls. Pievērsiet uzmanību atlikušo lietošanas reizu skaitam, jo


Pārveidotājs ir jānomaina, kad šis skaitlis kļuvis nulle.




Pēc tam tiks parādīts šāds attēls, un jums tiks lūgts nospriest jebkuru Ultraskaņas šķēres pogu, lai sāktu Ultraskaņas šķēres testu ar atvērtu Spiles.



Nospiediet jebkuru pogu, un tiks parādīts šāds attēls.

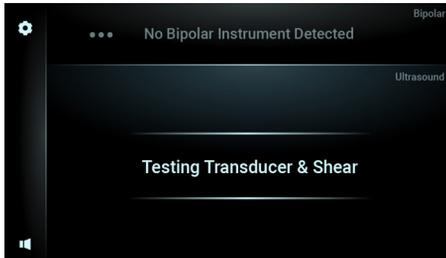


Ja Pārveidotājs tests neizdodas, tiek parādīts šāds attēls:

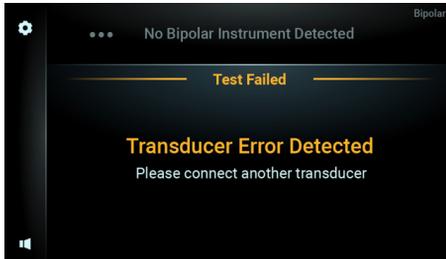


Ja Ultraskaņas šķēres tests neizdodas, tiek parādīts šāds attēls.



Kad Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres tests ir izturēts, tiek parādīts šāds attēls:

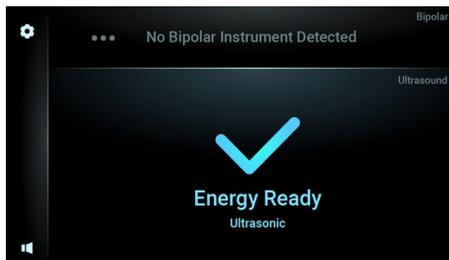

Savienojot Ultraskaņas šķēres bez uzlabotās hemostāzes funkcijas, tiks parādīts šāds darba ekrāns.

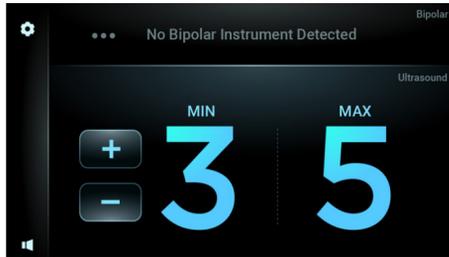


Savienojot SRE Ultraskaņas šķēres ar Advanced Hemostasis, tiks parādīts šāds darba ekrāns.




Izvades režīms tiks izcelts, tas ir aktivizēts.

Izmantojot elektroķirurģisko instrumentu


Ja tiek atklāti Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres, tiek parādīts šāds attēls.

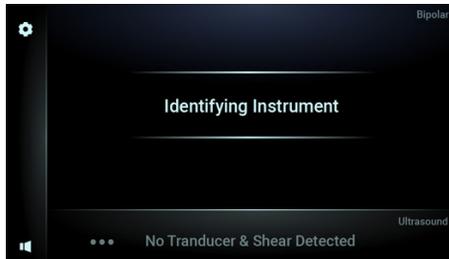

Kad elektroķirurģiskā instrumenta tests ir izturēts, tiks parādīts šāds attēls:

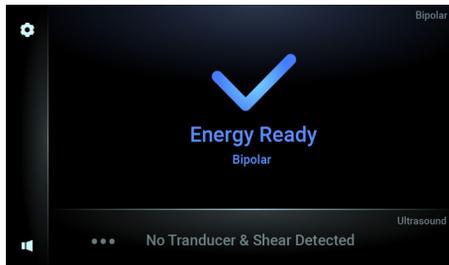

Savienojot ar uzlabotu bipolāro instrumentu, tiks parādīts šāds darba ekrāns.

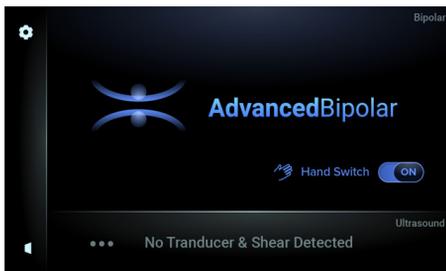

Savienojot ar parastu bipolāru instrumentu, tiks parādīts šāds darba ekrāns.




Izmantojot elektroķirurģisko instrumentu un Ultraskaņas šķēres

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja ģenerators ir savienots gan ar bipolāro elektroķirurģijas instrumentu, gan ar Ultraskaņas šķēres, sistēma darbojas dalītā ekrāna režīmā, lai parādītu pašreizējo stāvokli. Ierīce, kurai ir piešķirta prioritāte, pirmā aktivizēs enerģiju. Šis sadalītā ekrāna stāvoklis ir parādīts turpmāk:



Sistēmas iestatījumi

Lai piekļūtu sistēmas iestatījumiem, noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas, kas atrodas ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Ir pieejamas šādas sistēmas iestatījumu opcijas:

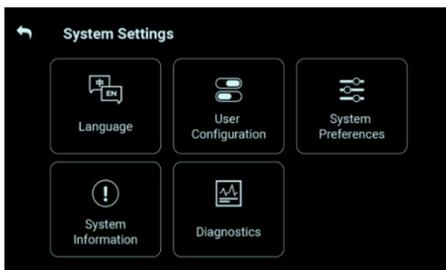


Valoda: Noklikšķinot uz elementa Valoda, tiks parādīts valodas izvēles ekrāns:




Lietotāja konfigurācija: Noklikšķinot uz elementa Lietotāja konfigurācija, tiks parādīts lietotāja konfigurācijas ekrāns:




Sistēmas preferences: Noklikšķinot uz elementa System Preferences (Sistēmas preferences), tiks parādīts sistēmas preferenču ekrāns:



Sistēmas informācija: Nedaudz noklikšķiniet uz elementa System Info, lai parādītu sistēmas informācijas ekrānu:

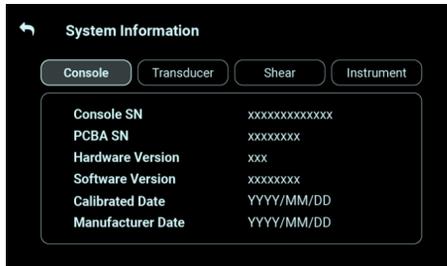

Diagnostika: Noklikšķinot uz elementa Diagnostika, tiks parādīts diagnostikas ekrāns:

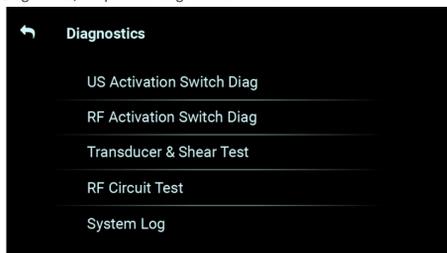

Lai izietu no sistēmas iestatījumiem un atgrieztos sistēmas gaidīšanas režīmā, nospiediet ikonu "Atgriešanās", kas atrodas ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Sistēmas izslēgšana

Lai droši izslēgtu sistēmu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

Nospiediet gaidīšanas režīma pogu: Atrodiet gaidīšanas režīma pogu uz ierīces ģeneratora un nospiediet to, lai sāktu izslēgšanas procesu.

Atvienojiet Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres: Uzmaniģi atvienojiet Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres no sistēmas. Lai pareizi rīkotos ar Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres, skatiet lietošanas instrukciju.

Tīrīšana: Tīriet ģenerator, kāju slēdzi un Pārveidotājs saskaņā ar norādīto procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Tehniskā apkope".

Problēmu novēršana

ģenerator ietver dažādus brīdinājuma signālus un kļūdu kodus, lai palīdzētu identificēt un diagnosticēt komponentu defektus. Ir svarīgi atzīmēt, ka šie signāli un kodi ir paredzēti, lai atbalstītu klīnisko vērtējumu un novērošanu, nevis tos aizstātu.

Skaņas brīdinājums

Darba statuss	Skaņas veids	Iespējama iemesls un rīcība	
Pašpārbaudes statuss	Parastā skaņa	/	
	Nenormāla skaņa	Ir konstatēts aparātūras defekts. Lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu remonta palīdzību.	
	Maksimālais skaņas līmenis	/	
	Minimālais skaņas līmenis	/	
	Ultraskaņas instrumenta izmantošana	Nenormāla skaņa	Ultraskaņas šķēres ir nonācis saskarē ar pārmērīgu ausu daudzumu. Samaziniet ausu kontaktu ar Ultraskaņas šķēres. Ja nepārtraukta skaņa saglabājas, uzmanīgi noņemiet visus ausus, kas var būt sakrājušies ap Ultraskaņas šķēres galu. Pārveidotājs un/vai Ultraskaņas šķēres ir konstatēts defekts. Lūdzu, vērsieties pie ražotāja vai sazinieties ar atbalsta dienestu, lai saņemtu papildu palīdzību.
		PAPILDU skaņa	/
ITS skaņa		/	
Uzlabots bipolārais brīdinājuma signāls		/	
Elektrokirurģiskā instrumenta aktivizēšana	Normāla divpolāra skaņa	/	
	Nenormāla skaņa	Neveiksmīga griešana: Ja audi, ar kuriem saskaras instruments, neatbilst griešanas prasībām, samaziniet ar instrumentu saskarē esošo ausu daudzumu. Ja kļūmes signāls saglabājas, rūpīgi notīriet visus ausus, kas var būt sakrājušies instrumenta galā. Aparātūras atteice: Šī kļūda norāda uz iespējamu kļēdes vai savienotāja kļūmi. Jebkuras kļūdas vai traucējuma gadījumā ieteicams konsultēties ar ražotāju vai meklēt atbalsta dienestu, lai saņemtu atbilstošus norādījumus un risinājumu.	


Kļūdu kodi

Energy Platform ģenerator ir aprīkots ar visaptverošu kļūdu identifikācijas sistēmu, kas ietver brīdinājumus un sistēmas kļūdas. Ja tiek konstatēta kļūda, ģenerator izdod brīdinājuma signālu, uz vadības panelā parāda brīdinājuma signālu un uz LCD ekrāna parāda attiecīgo kļūdas kodu. Lai novērstu problēmu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības:

Kļūdu kodu tabula

Kļūdas kods	Atbilstošais kļūdas ziņojums
Brīdinājums	Lūdzu, pareizi savienojiet Ultraskaņas šķēres ar Pārveidotājs
Brīdinājums	Pārliecinieties, ka testēšanas laikā ir atvērts Spiles
Brīdinājums	Ultraskaņas šķēres Atklāta kļūda
Brīdinājums	Pārveidotājs atlikušais laiks ir nulle
Brīdinājums	Lūdzu, vienlaikus aktivizējiet tikai vienu pogu
Brīdinājums	Lūdzu, samaziniet spēku, kas tiek pielietots pret Ultraskaņas šķēres
Brīdinājums	Ultraskaņas šķēres pogu un pedāļu slēdzi nevar aizvērt vienlaicīgi
Brīdinājums	Poga iestrēdzis, lūdzu, pārbaudiet un turpiniet
Brīdinājums	Pielāgojiet Spiles vai skavu mazāk ausu
Brīdinājums	Izņemiet ierīci no ausiem
Sistēmas kļūda	Sistēmas kļūda
Sistēmas kļūda	Pašpārbaude neizdevās

Ja testēšanas laikā ekrānā parādās kļūda, veiciet šādas darbības:

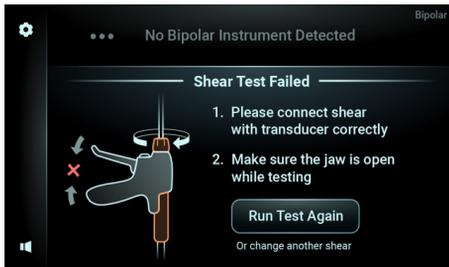

• Pārliecinieties, ka kabelis Pārveidotājs ir pilnībā ievietots pareizajā virzienā.

• Pārbaudiet, vai Ultraskaņas šķēres ir pareizi pievilktas un vai ap Ultraskaņas šķēres galu nav sakrājušies ausi. Noregulējiet Ultraskaņas šķēres hermētiskumu un uzmanīgi noņemiet ap Ultraskaņas šķēres korpusu sakrājušos ausus. (Ja pārbaude tiek uzsākta pirms darbības, pārliecinieties, ka Ultraskaņas šķēres ir vērstas pret gaisu. Ja tiek izmantots Ultraskaņas šķēres, pārliecinieties, ka spāile ir atvērta un nesaskaras ar priekšmetiem).

- Ja problēma saglabājas, apsveriet iespēju nomainīt Pārveidotājs vai Ultraskaņas šķēres.

• Pārējiet uz iekārtas darba režīmu.

PIEZĪME: Ierīce Pārveidotājs var nedarboties pareizi, ja tās temperatūra pārsniedz norādīto robežu. Šādos gadījumos nekavējoties izmantojiet citu Pārveidotājs, lai atjaunotu darbību, vai izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai noteiktu kļūdas cēloni un izpētītu izvēles atjaunošanas metodes:

- Ļaujiet Pārveidotājs atdzist istabas temperatūrā vismaz 45 minūtes. Šo atdzesēšanas metodi piemēro arī tad, ja Pārveidotājs kļūst karsts pēc ilgstošas darbības ar lielu jaudu.

- Ja Pārveidotājs pārkaršana nav redzama un problēma nav atrisināta, sazinieties ar ražotāja tehniskās apkopes pārstāvjiem, lai saņemtu palīdzību.
- Izņemot drošinātājus, ierīce ģenerator nav lietotāja apkalpojama detaļa. Ja ir nepieciešama nomainīva vai apkope, lūdz, sazinieties ar servisa personālu, kas ir apmācīts un pilnvarots no Reach Surgical, Inc., vai ar vietējo pārstāvi.

Aparāta ģenerator apkopi un modernizāciju drīkst veikt tikai servisa darbinieki, kurus apmācījis un pilnvarojis uzņēmums Reach Surgical.

Lai novērstu iespējamos apdraudējumus, ir jāapsver kibero drošības piesardzības pasākumi. Kibero drošības riskus rada šādi incidenti:

- Nesankcionēta piekļuve jebkādiem ar ierīci nesaitītiem produktiem.
- Jebkāda nesankcionēta tīkla saziņa ar ierīci.
- programmaparātūras vai programmatūras atjauninājumi, kurus nav autorizējis Reach Surgical.

Jebkura no iepriekš minētajiem gadījumiem gadījumā, lūdz, sazinieties ar Reach Surgical, Inc. tirdzniecības pārstāvi vai tieši sazinieties ar Reach Surgical, Inc. pa e-pastu Reachquality@reachsurgical.com.

Uzturēšana

ģenerator un bipolārā enerģijas pamatkonektora tīrīšana un dezinfekcija

Tīrīšana

Tīriet ģenerator LCD ekrānu un bipolāro savienotāju Basic saskaņā ar slimnīcas procedūram un noteikumiem. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ģenerator galvenais barošanas avots ir atvienots un barošanas vads ir noņemts no izejas bloka.

BRĪDINĀJUMS: tīrīšanas procedūras jāveic uzmanīgi, lai nesabojātu ierīci ģenerator, neradītu elektriskās strāvas triecienu vai ugunsbīstamību. Neizlejiet vai neizšakstiet šķidrums uz ģenerator vai uz tā, kā arī nepiemērciet to šķīdumā.

Veiciet šādas tīrīšanas darbības:

- Sagatavojiet neitrāla pH mazgāšanas līdzekli vai neitrāla pH fermentu mazgāšanas līdzekli, kā norādījis mazgāšanas līdzekļa ražotājs.
- Ar tīru, mikstu drānu, kas samitrināta ar nelielu daudzumu tīrīšanas šķīduma, manuāli noslaukiet visas virsmas, tostarp ekrānu ģenerator.
- Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mikstu drānu, kas samērcēta siltā krāna ūdenī.
- Visbeidzot noslaukiet visas virsmas ar tīru, mikstu drānu, lai nodrošinātu, ka tās ir sausas.

Dezinfekcija

Ja ģenerator ir piesārņots ar asinīm vai ķermeņa šķidrumiem, pirms atkārtotas lietošanas tas ir jādezinficē. ģenerator ir apstiprināti šādi ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi: 70% izopropilspirts, 6% nātrija hipohlorīts, 10% ūdeņraža peroksīds.

- Ievērojiet ražotāja ieteikumus par dezinfekcijas līdzekļu pareizu lietošanu, koncentrāciju un kontakta laiku.
- Pārliecinieties, ka dezinfekcijas līdzekļi ir konfigurēti un tiek izmantoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Kāju slēdža tīrīšana

Pēc katras lietošanas reizes notīriet kāju slēdzi un kabeli, izmantojot šādu procedūru:

- Atvienojiet kājas slēdzi no ierīces ģenerator.
- Pagatavojiet neitrāla pH fermentu mazgāšanas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Cieši savienojiet kabeli ar kājas slēdzi un iegremdējiet tās tīrīšanas šķīdumā uz 2 minūtēm.

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka kājas slēdža kabelis, ko izmanto, lai savienotu ģenerator, ir pilnīgi sauss, lai novērstu nejaucību aktivizēšanu.

- Pēc iegremdēšanas manuāli notīriet kājas slēdzi un kabeli ar mikstu saru birsti tīrīšanas šķīdumā.
- Rūpīgi noskalojiet kājas slēdzi un kabeli ar siltu krāna ūdeni vismaz 1 minūti.

UZMANĪBU: skalošanas laikā turiet kabeli un kāju slēdzi droši savienotus.

- Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mikstu drānu.

BRĪDINĀJUMS: Kāju slēdža tīrīšanai neizmantojiet ultraskaņas tīrīšanas iekārtu.

BRĪDINĀJUMS: Pirms mainīšanas barošanas kabeļa pievienošanas neieslēdziet ierīces ģenerator barošanas avotu. Pirms montāžas pārliecinieties, ka visi savienojumi ir sausi.

Pārveidotājs tīrīšana un dezinfekcija

Pārveidotājs tiek piegādāti nesterili, un pirms katras lietošanas reizes tie ir rūpīgi jānotīra un jāsterilizē.

Tīrīšana:

Rūpīgi iztīriet pārveidotāju saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem soļiem:

- Noskalojiet pārveidotāju ar skrūves pusi uz augšu un notīriet to ar mikstu saru birsti ar attīrītu ūdeni, līdz uz virsmas nav traipu;
- Pārveidotājs tiek mērcēts pH neitrālā fermentatīvā mazgāšanas līdzeklī (galvenās sastāvdaļas: proteāze, lipāze, amilāze, celuloze, pektināze un citi bioloģiskie fermenti, videi draudzīga virsmaktīva viela, rūsas novēršanas faktors un stabilizators) līdz 10 minūtem atbilstošā temperatūrā 15 °C ~ 65 °C. Mazgāšanas līdzekļa un attīrītā ūdens attiecība ir 1:400.
- Izskalojiet pārveidotāju ar skrūves pusi uz augšu ar attīrītu ūdeni 2 minūtes;
- Notīriet Savienojuma skrūvi, Skalpeļa stiprinājuma virsmu un Savienotāju ar spirta tīrīšanas līdzekli.
- Iemērciet Pārveidotāju 75% medicīniskajā spirtā, turiet un kratiet to 30 reizes;
- Izskalojiet Pārveidotāju ar skrūves pusi uz augšu ar attīrītu ūdeni 2 minūtes.

Piezīme: Pārveidotājam nav ieteicams izmantot ultraskaņas tīrīšanas līdzekļus.

Žāvēšana:

Žāvēšanas temperatūra: 50 ~ 70 °C, žāvēšanas laiks: 30 min.

Pārveidotāja sterilizācija:

Pēc iepriekšminētajām tīrīšanas un žāvēšanas darbībām Pārveidotājs jāsterilizē, izmantojot vienu no turpmāk minētajām metodēm.

Sterilizācija ar tvaiku (121 °C)

- Apvalks jāuzstāda pirms sterilizācijas. Sterilizācijas laikā Pārveidotājs ir jāaptin. Sterilizācijai ievietojiet Pārveidotāju augsttemperatūras tvaika sterilizācijas katlā ar 121 °C temperatūru un 30 min ilgumu.
- Žāvēšanas temperatūra: 50 ~ 70 °C, žāvēšanas laiks: 30 min.

Sterilizācija ar tvaiku (134 °C)

- Apvalks jāuzstāda pirms sterilizācijas. Sterilizācijas laikā Pārveidotājs ir jāaptin. Sterilizācijai ievietojiet Pārveidotāju augsttemperatūras tvaika sterilizācijas katlā, kura temperatūra ir 134 °C un ilgums 10 min.
- Žāvēšanas temperatūra: 50 ~ 70 °C, žāvēšanas laiks: 30 min.

Drošības un funkcionālie testi

Nodrošināt Pārveidotājs, ģenerator un kāju slēdža drošības un funkcionālo testu veikšanu saskaņā ar slimnīcas procedūram un noteikumiem. Attiecībā uz citu komponentu, kurus izmanto vairāki pacienti, drošības un funkcionālajiem testiem skatiet katrai sastāvdaļai raksturīgās lietošanas instrukcijas.

Drošības tests

ģenerators: Sertificētiem slīmnicu tehniķiem jāveic noplūdes strāvas tests.

Kāju slēdzis: Pārbaudiet pedāli, kabeļa savienotāju un kabeli, vai nav radušās plaisas vai bojājumi. Bojātās sastāvdaļas nomainiet.

Citas sastāvdaļas: Pārbaudiet visus pārējos komponentus, kā norādīts to attiecīgajās lietošanas instrukcijās.

Funkcionālais tests

Ultraskaņas režīms

- Sagatavojiet PD Ultraskaņas šķēres komplektu un pievienojiet Pārveidotājs, ievērojot II nodaļā - Iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija - sniegtos norādījumus.
- Pārbaudiet, vai ir iespējams pāriet darba stāvoklī. Dažādiem Ultraskaņas šķēres var būt dažādas ieejas saskarnes. Sīkāki norādījumi ir sniegti 2. nodaļas 1. daļas 3. iedaļā.
- Ultraskaņas, kā tiek parādīts MIN jaudas līmenis 3 un MAX jaudas līmenis 5.
- Nospiediet jaudas palielināšanas un samazināšanas pogas, lai nodrošinātu, ka MIN jaudas līmeni var regulēt no 1 līdz 5 līmenim.
- Ieslēdziet ierīci ģenerator un pārslēdziet to uz ultraskaņas darba režīmu. Pārbaudiet, vai ir pareizi savienoti Pārveidotājs un Ultraskaņas šķēres.
- Kad spaiļe ir atvērta, nospiediet "MAX" pogu uz kājas slēdža. LCD ekrānā jāparādās MAX jaudas līmenim "5" un jāskan aktivizācijas signālam.
- Kad spaiļe ir atvērta, nospiediet kājā esošā slēdža pogu "MIN". LCD ekrānā jāparādās MIN jaudas līmenim un jāskan aktivizācijas signālam.

BRĪDINĀJUMS: Pirms sistēmas aktivizēšanas pārliecinieties, ka žoklis atrodas tālu no ausiem, citiem instrumentiem vai citiem priekšmetiem, lai novērstu lietotāja traumas.

Bipolārais elektroķirurģijas režīms

- Pievienojiet uzlaboto bipolāro elektroķirurģisko instrumentu/ bipolāro pamatinstrumentu saskaņā ar instrukcijām.
- Pārbaudiet, vai sistēma var ietīt darba saskarnē. Pamata bipolārajā režīmā jāparādās 30 jaudas līmeņa ikona, bet paplašinātajā bipolārajā režīmā - ikona "paplašinātais bipolārais režīms".
- Viegli pieskarieties jaudas palielināšanas un samazināšanas taustiņiem bipolārajā pamatrežīmā, lai apstiprinātu, ka jaudas līmeni var regulēt no 1 līdz 9 līd 95. Pieskarieties zema, vidēja un augsta līmeņa joslām, lai tieši pārslēgtos starp 15, 30 un 60.
- Ieslēdziet ierīci ģenerator un pagaidiet 5 sekundes. Pēc tam ieslēdziet ģenerator barošanas avotu un pagaidiet 10 sekundes. Pārbaudiet, vai bipolārajā pamatrežīmā tiek parādīts 30 jaudas līmeņa interfeiss, bet uzlabotajā bipolārajā režīmā tiek parādīts interfeiss "Advanced bipolar". Pārbaudiet, vai ģenerator ir aktivizēts atbilstoši iepriekš noteiktajām prasībām.
- Pievienojiet uzlaboto pamata dipolāro Elektroķirurģijas instrumentu un nospiediet vienu kājas slēdzi. Pārbaudiet, vai uz vadības paneļa mirgo jaudas līmeņa indikācijas, un klausieties, vai atskan aktivizēšanas skaņa.

BRĪDINĀJUMS: Pirms sistēmas aktivizēšanas ir stingri aizliegts pieļaut jebkādu Ultraskaņas šķēres saskari ar ausiem, citiem instrumentiem vai jebkādiem citiem priekšmetiem, lai novērstu lietotāja traumas.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ar sistēmu saistīts

- Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet slīmnicās vadlīnijas par ultraskaņas ķirurģijas, elektroķirurģijas, ginekoloģijas un laparoskopijas klīnisko praksi.
- Minimāli invazīvas ierīces var atšķirties atkarībā no ražotāja. Ja vienā operācijā vienlaikus tiek izmantoti dažādu ražotāju minimāli invazīvi instrumenti un piederumi, pirms operācijas pārbaudiet instrumentu un piederumu saderību un pārliecinieties, vai cilvēka ķermenī ievietotajiem piederumiem nav raupjas virsmas, asas malas vai izvirzījumu, kas var radīt drošības apdraudējumu.
- Šo ierīci drīkst lietot tikai apmācīti un licencēti ķirurģi. Neizmantojiet elektroķirurģiskās ierīces, ja neesat pienācīgi apmācīts to lietošanā konkrētajai procedūrai, kas jums būs jāveic. Neapmācītās šīs ierīces lietošana var izraisīt neparedzētus nopietnus pacienta ievainojumus, tostarp zarnu perforāciju un bezsamaņu un neatgriezenisku audu nekrozi.
- Lai izvairītos no iespējama šoka briesmām, neatveriet korpusu ģenerator bez atļaujas. Jebkurš instrumenta remonts un modernizācija jāveic servisa personai, kas ir apmācīta un pilnvarota Reach Surgical, Inc. Neizmantojiet šo instrumentu citiem mērķiem, izņemot medicīnisko ķirurģiju.
- Lai novērstu triecienu un apdegumu risku pacientam un medicīniskajam personālam, kā arī šīs ierīces vai citu medicīnas ierīču bojājumus, ir svarīgi labi izprast lāzera, elektroķirurģijas un ultraskaņas procedūru principus un metodes. Elektriskā izolācija vai zemējums nedrīkst tikt apdraudēts. Neiegremdējiet elektroķirurģiskās ierīces šķidrums, ja vien to neparedz konstrukcija un marķējumā nav norādīts, ka tās ir iegremdējamas.
- Droša un efektīva ultraskaņas ķirurģija ir atkarīga ne tikai no iekārtas konstrukcijas, bet lielā mērā arī no daudzdiem faktoriem, kuru kontrolē operators. Lai uzlabotu drošību un efektivitāti, izlasiet, izprotiet un ievērojiet ierīcei pievienoto lietošanas instrukciju.
- Tāpat kā ar visiem enerģijas avotiem (elektroķirurģiskiem, lāzeru vai ultraskaņu), jāņem vērā kancerogēno un infekcijas risku, ko var radīt daudzi audu blakusprodukti, piemēram, dūmi un aerosoli. Gan atklātu, gan endoskopisku procedūru laikā jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi, piemēram, aizsargbrilles, filtrējamās maskas un efektīvs dūmu evakuācijas aprīkojums.
- Pēc ierīces noņemšanas pārbaudiet, vai audi ir hemostāzēti. Ja hemostāzes nav, jāizmanto atbilstošas metodes, lai panāktu hemostāzi.
- Produkti, ko ražojusi vai izplatījuši uzņēmumi, kuru nav autorizējusi kompānija Reach Surgical, Inc., var nebūt saderīgi ar ierīci. Šādu izstrādājumu lietošana var radīt neparedzētus rezultātus un var savainot lietotāju vai pacientu.
- Lai samazinātu traucējumu risku, ierīci un apvalku pievieno neatkarīgi strāvas ķēdei.
- Iekārta nav piemērota lietošanai uzliesmojošā anestēzijas maisījuma gaisū, skābekli vai slāpekļa oksīdu. Iespējama dzirksteļošana sadursmes ar citām metāla ierīcēm dēļ. Dzirksteles var aizdedzināt uzliesmojošās gāzes, piemēram, lauka gāzes.
- Tam jādarbojas nepieciešamajā apkārtējās vides darba temperatūras diapazonā.
- Izējas kontaktlīdzspiedīgu spriegumam jāatbilst ģenerator prasībām (nodaļa "Sistēmas tehniskie nosacījumi"). Ja barošanas avots nav pareizi pieslēgts, tas var sabojāt ģenerator un izraisīt elektrošoka vai ugunsgrēka risku.
- Neizmantojiet pagarinātājus, lai izvairītos no ugunsbīstamības.
- Nepārslēdziet aktivizēšanas signālu līdz nedzirdnamam līmenim. Aktivizācijas signālus var pamanīt ķirurģiskās brigādes personāls, kamēr ģenerator piegādā enerģiju.
- Ir pierādīts, ka elektroķirurģijas laikā radušies dūmi var potenciāli kaitēt pacientiem vai ķirurģijas komandas personālam. Ierosiniet atbilstošu ventilāciju ar ķirurģisko dūmu evakuatoru vai citiem līdzekļiem.
- Dažas ultraskaņas ķirurģiskās integrētās ierīces ģenerator sastāvdaļas tiek piegādātas nesterilas (piem., Pārveidotājs). Pirms sistēmas uzstādīšanas sāksanas sterilizējiet izstrādājumu atbilstoši prasībām. Tīrīšanas un sterilizācijas norādījumus skatiet katrā attiecīgajā instrukcijā.
- Lai izvairītos no lietotāju vai pacientu ievainojumiem, pirms testa pogas nospiešanas un sistēmas pārbaudes laikā Ultraskaņas šķēres nedrīkst lietot citas ierīces, ķirurģiskos pārkļājus, pacientus vai citus priekšmetus. Sistēmas pārbaudes un testēšanas metode jāievieš drošības pasākumi aerosola gadījumā (saskaņā ar slīmnicās noteikumiem).
- Nepieļaujiet pārāk lielu spiedienu uz žokli, lai netraucētu ultraskaņas enerģijas padevi.
- Lai izvairītos no lietotāja traumām, pirms sistēmas aktivizēšanas asmenim jāizvairās no saskares ar ausiem, citām ierīcēm vai citiem priekšmetiem.
- Ja šķidrums izšļakstās vai uzlec uz ģenerator vai uz tā, vai ģenerator tiek izliets vai uzliets šķidrumā, tas var sabojāt ģenerator un izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēka risku.
- Gan dzirksteļošana, gan sildīšana, kas saistīta ar tvertnes aizvēršanas panēmieniem, var kalpot par aizdedzēšanas avotiem. Marēli un sūklīm jābūt mitriem. Elektroķirurģiskos elektrodrošības glabājiem tālu no degošiem materiāliem un skābekli saturošas (O2) vides.
- Ja Pārveidotājs ir ievērojami bojājumi vai ja pēc tīrīšanas un dezinfekcijas apskopes kādai detaļai ir bojājumu pazīmes, tās jāizmet. Bojātās daļas ir skaidri marķētas, lai izvairītos no nepareizas lietošanas pirms turpmākas apstrādes.

- Vienreizlietojamie atkritumi un elektroniskie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar slimnīcas noteikumiem, un tos nedrīkst izmest pēc saviem ieskatiem, lai izvairītos no vides piesārņojuma.
- Izvairieties lietot ģeneratoru tuvu citām iekārtām vai novietotu uz tām. Ja nepieciešams lietot blakus vai sakrautas iekārtas, uzraugiet ģeneratoru un citas iekārtas, lai nodrošinātu to pareizu darbību.
- Ierīcē nav operatora apkalpojamu detaļu. Lai veiktu apkopi, sazinieties ar Reach Surgical tirdzniecības pārstāvi vai servisa personālu.
- Pirms lietošanas pārbaudiet visas sistēmai pievienotās ierīces un savienojumus. Pārbaudiet, vai ierīce darbojas, kā paredzēts. Nepareizs savienojums var izraisīt loku, dzirkstelošanu, ierīces darbības traucējumus vai neparedzētus ķirurģiskus rezultātus.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, šo iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie barošanas tīkla ar aizsargzēmējumu.
- Nodaliet ierīci ģeneratoru no citām elektroniskajām ierīcēm (piemēram, monitoriem) pēc iespējas tālāk. Nekrustojiet un nesavienojiet elektriskos vadus ar elektroniskajām ierīcēm. Ierīce ģeneratoru var radīt traucējumus citām elektroniskajām ierīcēm.
- Sistēma jālieto piesardzīgi, ja ir iekšējie arējie elektrokardiostimulatori. Sistēmas Elektroķirurģijas instrumenti lietošanas radītie traucējumi var izraisīt elektrokardiostimulatora pāreju asinhronā stāvoklī vai pilnībā traucēt elektrokardiostimulatora darbību. Ja elektroķirurģijas vai ausu hermetizācijas ierīces ir paredzētas lietošanai pacientiem ar sirds darbības stimulatoriem, sazinieties ar elektrokardiostimulatora ražotāju vai slimnīcas kardioloģijas nodaļu, lai saņemtu papildu informāciju.
- Ja instrumentus uz ģeneratoru uzliek vīrsū vai novieto ģeneratoru uz elektriskiem instrumentiem, rīkojieties piesardzīgi. Šāda konfigurācija ir nestabila un nenodrošina atbilstošu dzesešānu.
- Ja ģeneratoru neizdodas, tas var izraisīt ķirurģisku pārtraukumu. Ir jābūt pieejamai rezerves sistēmai.
- Ja to pieprasa vietējie normatīvie akti, ierīce ģeneratoru jāpievieno slimnīcas ekvipotenciālām savienotajām, izmantojot ekvipotenciālo kabeli.
- Ja sistēmu un fizioloģiskās uzraudzības iekārtu vienlaikus izmanto vienam un tam pašam pacientam, jebkurš uzraudzības elektrods jānovieto pēc iespējas tālāk no instrumenta.
- Bipolārajā pamat režīmā izvēlējies mazāko iespējamo izejas jaudu vēlamajam efektam.
- Augstas frekvences ķirurģisko iekārtu atteece var izraisīt negaidītu izejas jaudas palielināšanos.
- Ģeneratoru un bipolāro elektroķirurģisko savienotāju var aizskart ūdens vai cietais daļiņas. Lietošanas un tīrīšanas procesā ir jāizvairās no ūdens vai daļiņu iekļūšanas.
- Ja sistēma tiek izmantota kopā ar endoskopu, tā var palielināt noplūdes strāvu uz pacienta ķermeņa. Procedūras laikā pievērsiet uzmanību.
- Pazinojums lietotājam un/vai pacientam, ka par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar ierīci, jāziņo uzņēmumam Reach Surgical, Inc., izmantojot Reachquality@reachsurgical.com., un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.

Ar instrumentu saistītie

Ķirurģisku procedūru laikā ir svarīgi apzināties, ka instrumenta Ultraskaņas šķēres, Ultraskaņas šķēres spilventiņa un Stobrs gala daļā var būt paaugstināta temperatūra, ja ultraskaņu vai bipolāro elektrokauteriju ilgstoši pieliek ausiem. Lai nodrošinātu drošību, procedūras laikā ir ļoti svarīgi izvairīties no nejaūšas šo instrumentu sastāvdaļu saskares ar ausiem, ķirurģiskajiem pārkļājiem, ķirurģiskajiem mēteliem vai citām nesaiestītām vietām.

Turklāt ir ļoti svarīgi ievērot piesardzību, novietojot bipolāro instrumentu. Jo īpaši to nedrīkst novietot tuvu degtspējīgiem materiāliem, piemēram, marlei vai ķirurģiskiem pārkļājiem, vai saskarē ar tiem. Šajā kontekstā izmantotie bipolārie instrumenti lietošanas laikā var radīt karstumu, kas potenciāli var izraisīt ugunsbīstamību. Kad bipolārais elektroķirurģiskais instruments ģeneratoru netiek lietots, tas pienācīgi jāglabā aizsargapvalkā vai drošā atālmūnā no pacienta, ķirurģiskās komandas locekļiem un jebkādiem uzliesmojošiem materiāliem.

PIEZĪME: papildu brīdinājumus un piesardzības pasākumus skatīt attiecīgajā lietošanas instrukcijā.

EMC informācija

Produkts ir izturējis elektromagnētiskās saderības testu, kas atbilst IEC60601-1-2 standarta ierobežojumu prasībām medicīnas iekārtām. Šie ierobežojumi nodrošina pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem parastās medicīnas iekārtās.

Produkta sastāvs

Sērijas numurs	Daļas nosaukums	Modeļa/versijas Nr.	Piezīmes
1	Elektroķirurģijas instruments	OP9	/
2	Ultraskaņas ķirurģisko iekārtu pārveidotājs	TRA6	Saderīga lietošana
3	Ultraskaņas šķēres Vienreizējās lietošanas sistēma Ultraskaņas šķēres	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Saderīga lietošana
4	Vienreizējās lietošanas ultraskaņas augstfrekvences ķirurģijas iekārta Ausu hermētiskis	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultraskaņas kāju slēdzis	OP-FSD	/
6	Elektroķirurģiskais kājas slēdzis	OP-FSS	/
7	Elektroķirurģijas bipolārais savienotājs	OP-BPC	/

Produkta kabelis

Sērijas numurs	Kabeļa nosaukums	Garums (m)	Ekranēts
1	Kāju vadības kabelis	3	Jā
2	Strāvas vads	5	Nē
3	Bipolārais elektroķirurģijas kabelis	3	Nē
4	Pārveidotājs kabelis	2.9	Jā

EMC veiktspēja

Šī iekārta var tikt pakļauta radiofrekvencu traucējumiem, ko rada citas medicīnas iekārtas un radiosakari. Lai novērstu šādus traucējumus, šis izstrādājums ir pārbaudīts saskaņā ar IEC 60601-1-2 un atbilst tās prasībām. Tomēr Reach Surgical, Inc. negarantē, ka atsevišķās uzstādīšanas vidēs nebūs absolūti nekādu traucējumu.

Ja tiek konstatēts, ka ierīce ir traucēta (to var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci), lietotājam (vai uzņēmuma Reach Surgical, Inc. apstiprinātām apkopes personālam) jāmēģina veikt vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem, lai atbrīvotu traucējumu problēmu:

Pielāgojiet ierīces virzienu vai pozīciju, kas to ietekmē.

Palieliniet atālmūnu starp šo ierīci un sūtītāju ierīci.

Iekārtas barošanai izmantojiet citus barošanas avotus (nevis to, kas tiek izmantots, lai iedarbotos uz iekārtu).

Par citiem ieteikumiem konsultējieties ar piegādātāju vai servisa pārstāvi.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem, kas rodas šādās situācijās: izmantojot citus starpsavienojuma kabelus, kas nav ieteiktie kabeli; mainot vai pārveidojot šo iekārtu bez atļaujas. Neatļautas izmaiņas vai modifikācijas var izraisīt iekārtas neefektivitātes zudumu.

Visu veidu elektroniskās iekārtas var radīt elektromagnētiskus traucējumus citām iekārtām, izmantojot gaisu vai citus tām pievienotos kabelus. Šīs ierīces tuvumā nelietojiet ierīces, kas var radīt radiofrekvencu signālus, piemēram, mobilos tālrunus, radiouztvērtējus vai radio vadības ierīces, jo tas var izraisīt

Šīs ierīces darbības neatbilstību noteiktajām specifikācijām. Ja šādas ierīces atrodas šīs ierīces tuvumā, izslēdziet šo ierīču barošanu. Medicīniskajam personālam, kas atbild par šo ierīci, jāinstruē tehnīķi, pacienti un cits personāls, kas var atrasties šīs ierīces tuvumā, pilnībā ievērot iepriekš minētās prasības.

Lai pilnībā sasniegtu norādīto EMC veiktspēju, lietotājam pareizi jāuzstāda izstrādājums saskaņā ar rokasgrāmatā aprakstītajiem soļiem. Ja rodas ar EMC saistītas problēmas, sazinieties ar Reach Surgical, Inc. apstiprinātu tehniskās apkalpes personālu.

Pārveidotājs (ar kabeli) un Ultraskaņas šķēres ir definēti kā visas sistēmas lietotajām daļā.

Piesardzības pasākumi produkta uzstādīšanai

Iekārtu var izmantot slimnīcas vidē, bet tajā nav iekļautas radiofrekvenču ekranēšanas telpas ap aktīvām radiofrekvenču ķirurģijas iekārtām vai vietās, kur izvietotas magnētiskās rezonanses trieciena iekārtas, jo elektromagnētisko traucējumu intensitāte šajās vietās ir augsta.

Stacionāro radiosakarņu iekārtu atdalīšanas attālums un ietekme: magnētiskā lauka intensitāti, ko rada stacionārie raidītāji, piemēram, bezvadu (mobilo/ bezvadu) tālrunu bāzes stacijas, sauszemes mobilie radio uztvērēji, amatieru radio uztvērēji, AM un FM radio raidījumi, TV raidījumi ģenerators u.c., nevar precīzi izmērīt teoretiski. Lai novērtētu stacionāro RF raidītāju radīto elektromagnētisko vidi, jāapsver elektromagnētiskā lauka mērījumi. Ja izmērītā magnētiskā lauka intensitātes vērtība ierīces atrašanās vieta pārsniedz attiecīgo radiofrekvences līmeni, kas norādīts "Pazīņojumā pret traucējumiem", ierīce jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tā var normāli darboties. Ja tiek konstatēti neparasti darbības apstākļi, jāapsver papildu mērījumu veikšana, piemēram, iekārtas pārorientēšana vai pārvietošana, vai pretradiofrekvenču telpas izmantošana.

1) Izmantojiet Reach Surgical, Inc. piegādāto vai norādīto barošanas kabeli. Izstrādājumi, kas aprīkoti ar strāvas kontaktakšus, jāiesprauc stacionārā strāvas kontaktligzdā ar aizsargzņēmumu. Strāvas kontaktakšas pieslēgšanai neizmantojiet nekāda veida adapterus vai savienotājus.

2) Uglabājiet šo ierīci pēc iespējas tālāk no citām elektroniskajām ierīcēm.

3) Izpildiet darbības, lai savienotu ierīci.

Vispārīgas piezīmes

(1) Kabeļa specifikācija.

Uzņēmuma Reach Surgical, Inc. piedāvāto kabeļu izmantošana nesabojā šī izstrādājuma elektromagnētiskās saderības rādītājus. Ja tiek izmantoti nespecifificēti kabeļi, šīs iekārtas EMC veiktspēja var ievērojami pasliktināties.

(2) Piesardzības pasākumi nesankcionētu modifikāciju gadījumā

Lietotājs nedrīkst pārveidot šo izstrādājumu, pretējā gadījumā var samazināties šī izstrādājuma elektromagnētiskā savietojamība.

Izstrādājuma modifikācija ietver šādas izmaiņas:

a. Kabeļi (garums, materiāls, vadi utt.).

b. Iekārtu uzstādīšana/ izvietojums.

c. Aprīkojuma konfigurācija/komponenti.

d. Iekārtas aizsardzības daļas (vāka atvēršanas/aizvēršanas un vāka stiprinājuma daļas).

(3) Lietojot iekārtu, visiem aizsargvācīņiem jābūt aizvērtiem.

Paredzams, ka šo ražojumu izmantos turpmāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē, un šā ražojuma pircējam un lietotājam jānodrošina, lai tas tiktu izmantots šajā elektromagnētiskajā vidē.

Būtiska veiktspēja

1. Augstfrekvences radio enerģijas izvadei sistēma nodrošina, ka nominālās izejas jaudas novirze nepārsniedz 20 % no standarta vērtības.

2. Augstfrekvences radio pamatjautājuma enerģijas izvadei sistēma nodrošina, ka nominālās izejas jaudas novirze nepārsniedz 20 % no standarta vērtības.

Norādījumi un IZSTRĀDĀTĀJA deklarācija - ELEKTROMAGNETISKĀS IZSTIPRINĀJUMI		
Ierīce ir paredzēta lietošanai elektromagnētiskajā vidē, kas noteikta šādi. Klientam vai ierīcei lietotājam ir jānodrošina, ka tas tiek izmantots šādā vidē.		
Emisiju tests	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide - norādījumi
RF emisijas CISPR 11	1. grupa	Ierīce izmanto radiofrekvenču enerģiju tikai savām iekšējām funkcijām. Tāpēc tā radiofrekvenču emisija ir ļoti zema un nevar radīt nekādus traucējumus tuvumā esošajām elektroniskajām iekārtām.
RF emisijas	A klase	Šīs iekārtas EMISIJU raksturojums padara to piemērotu lietošanai rūpniecības zonās un slimnīcās.
Harmoniskā strāva IEC 61000-3-2	A klase	
Sprieguma izmaiņas / sprieguma svārstības / mīrģošana IEC 61000-3-3	Atbilst	

Norādījumi un ražotāja deklarācija - elektromagnētiskā noturība			
Ierīce ir paredzēta lietošanai elektromagnētiskajā vidē, kas norādīta šādi. Klientam vai ierīcei lietotājam jānodrošina, ka ierīce tiek izmantota šādā vidē.			
IMMUNITĀTES tests	IEC 60601 testa līmenis	Atbilstības līmenis	Elektromagnētiskā vide - norādījumi
Elektrostatiskais izlāde (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakts ± 2,4,8,15kV gaiss	± 8 kV kontakts ± 2,4,8,15kV gaiss	Grīdām jābūt koka, betona vai keramikas flīzēm. Ja grīdas ir klatas ar sintētisku materiālu, Relatīvajam mitrumam jābūt vismaz 30 %.
Ātrs elektriskais pārejošais elektriskais process/sprādziens IEC 61000-4-4	± 2 kV barošanas līnijām ± 1 kV ieejas/izejas līnijām	± 2 kV barošanas līnijām ± 1 kV ieejas/izejas līnijām	Strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda ir tipiskā komerciālā vai slimnīcas vidē.
Pārspriegums IEC 61000-4-5	± 1 kV līnija(-as) līdz līnijai(-ām) ± 2 kV līnija(-as) uz zemes	± 1 kV līnija(-es) līdz līnijai(-ēm) ± 2 kV līnija (s) līdz zemei	Strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda ir tipiskā komerciālā vai slimnīcas vidē.
Sprieguma kritumi, īss pārtraukumi uz barošanas avota ieejas līnijām IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cikla 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° un 315° leņķī. 0 % UT; 1 cikls un 70 % UT; 25/30 cikli Vienfāzes: pie 0° 0 % UT; 250/300 cikls	0 % UT; 0,5 cikls 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° un 315° leņķī. 0 % UT; 1 cikls un 70 % UT; 25/30 cikli Vienfāzes: pie 0° 0 % UT; 250/300 cikls	Strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda ir tipiskā komerciālā vai slimnīcas vidē. Ja ultraskaņas ķirurģiskā aparāta lietotājs iekārtai ir nepieciešama nepārtraukta darbība elektroliķa darbības pārtraukumu laikā, ieteicams, lai ultraskaņas ķirurģiskā iekārtas jābaro no nepārtrauktas barošanas avota vai akumulatora.
Jaudas frekvence (50/60 Hz) Magnētiskais lauks IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Jaudas frekvences magnētiskā laukiem jābūt raksturīgā līmenī. Par tipisku atrašanās vietu tipiskā komerciālā vai slimnīcas vidē.

Norādījumi un ražotāja deklarācija - elektromagnētiskā noturība			
Ierīce paredzēta lietošanai elektromagnētiskajā vidē, kas norādīta šādi. Klientam vai ierīces lietotājam jānodrošina, ka tā tiek izmantota šādā vidē.			
IMMUNITĀTE tests	IEC 60601 tests līmenis	Atbilstība līmenis	Elektromagnētiskā vide - norādījumi
Vadīts RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz līdz 80 MHz 6 V ISM joslās no 0,15 MHz līdz 80 MHz	3V	Portatīvie un mobilie RF sakari Iekārtas nedrīkst izmantot tuvāk nevienai ierīces daļai, tostarp kabeljiem, par ieteicamo atdalīšanas attālumu, kas aprēķināts pēc raidītāja frekvences vienādojuma. Ieteicamais atdalīšanas attālums $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$
Izstarotā radiofrekvence IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz līdz 2,7 GHz 80 % AM pie 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz līdz 800MHz $d = \left[\frac{7}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz līdz 2,7 GHz kur P ir maksimālā izejas jauda raidītāja jauda vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja datiem un d ir ieteicamais attālums metros (m). Lauka intensitātei no stacionāriem RF raidītājiem, kas noteikta, veicot elektromagnētisko apsekojumu.3 katrā frekvenču diapazonā jābūt mazākai par atbilstības līmeni. Var rasties traucējumi to iekārtu tuvumā, kas marķētas ar šādu simbolu:  ME IEKĀRTU un ME SISTĒMU ENCLOSURE PORT testē, kā norādīts IEC 60601-1-2 9. tabulā, izmantojot IEC 61000-4-3 noteiktās testēšanas metodes.

Ieteicamie attālumi starp pārnēsājamām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām un ierīcēm.

Ultraskaņas ķirurģijas iekārtas mērķis ir pielietojums elektromagnētiskajā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi. Ierīces klients var lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, saglabājot minimālo attālumu starp pārnēsājamām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām (raidītājiem) un ierīci, kā norādīts turpmāk., saskaņā ar sakaru iekārtu maksimālo izejas jaudu.

	Atdalīšanas attālums atkarībā no raidītāja frekvences /m		
Maksimālā nominālā raidītāja izejas jauda (w)	150 kHz līdz 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$	80 MHz līdz 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$	800 MHz līdz 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{\sqrt{f}} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

PIEZĪME: Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma izplatīšanās ietekmē absorbcija un atstarošana no konstrukcijām, objektiem un cilvēkiem.

Tehniskie nosacījumi

Sistēmas darbībai nepieciešamie komponenti: Elektroķirurģijas instruments, Pārveidotājs, Ultraskaņas kāju slēdzis, Elektroķirurģiskais kājas slēdzis, Ultraskaņas šķēres vai Elektroķirurģijas rokas instrumenti, elektroķirurģijas bipolārais savienotājs Bipolārais instruments.

Skatiet produkta aprakstu par šo komponentu.


Aizsardzības pakāpe pret elektrošoku	Ultraskaņa:  CF tipa lietišķā daļa; bipolārā elektroķirurģiskā  CF tipa lietišķā daļa, izturīga pret defibrilāciju.
Aizsardzības pakāpe pret elektrošoku ģenerator līdz kaitīgām infūzijām	I klase
Aizsardzības pakāpe pret kaitīgu ūdens iekļūšanu	Parasts aprīkojums
Vadība Kategorija	Kāju slēdžiem: IP68 Ilb klase
Ultraskaņas režīma parametru prasības:	
Ieejas jauda	Barošanas spriegums: 100-240 V Barošanas frekvence: 50Hz/60Hz Ieejas jauda: 400VA
Ultraskaņas režīma parametru prasības:	
Uzbudinājuma frekvence	54 kHz - 57 kHz
Primārā uzgaļa vibrācijas izkļiede	25 μm - 110 μm
Ultraskaņas šķēres uzgaļa galvenā akustiskā izejas virsma Izstrādājums:	1,53~2,75 mm2
Sekundārā šķērssaite Akustiskā pie Ultraskaņas šķēres uzgaļa Izvades apgabals:	19,32~35,88 mm2
Atvasinātā izejas skaņa pie Ultraskaņas šķēres uzgaļa pie atskaites uzgaļa Primārā amplitūdas jauda	< 30W
Sistēmas frekvences kontroles veids	Neatkarīgi no slodzes ierosmes frekvence tiek automātiski nepārtraukti regulēta.
Jaudas rezerves indekss	Ne mazāk kā 2,5
Prasības attiecībā uz elektroķirurģiskajiem parametriem:	
Darba frekvence	400 kHz ± 5%

Maksimālais izejas spriegums	≤ 250V
Uzlabotais bipolārais režīms Maksimālā izejas strāva	≤ 5.5A
Bipolārais pamatrežīms Maksimālā izejas strāva	≤ 2.2A
Maksimālais izejas spriegums no maksimuma līdz maksimumam	≤ 500Vpk
Maksimuma koeficients	1.6 ± 0.4
Nominālā jauda	Radiofrekvences uzlabotas bipolārs: 270 W Radiofrekvence Pamata bipolārais: 95W
Nominālā slodze	Radiofrekvences uzlabotas bipolārs: 30Ω Radiofrekvence Pamata bipolārais: 200Ω

Darbības vides apstākļi	Temperatūra: 10 ° C līdz 30 ° C Relatīvais mitrums: ≤ 70% Atmosfēras spiediena diapazons: no 800 hPa līdz 1060 hPa
Transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: no -30 ° C līdz +55 ° C (Ģenerator, kājstarpes slēdzis, adapteris) Temperatūra: no -10 ° C līdz +55 ° C (Ultraskaņas šķēres) Mitrums: ≤ 80% Atmosfēras spiediena diapazons: no 800 hPa līdz 1060 hPa
Izgatavošanas datums	Ražošanas datumu var noteikt pēc sērijas numura uz ģenerator aizmugurējā panelā.
Strāvas vads	Atbilstība CCC sertifikācijas prasībām Pašreizējais vērtējums: 10A
Noturības koeficients	Noteikts pēc Pārveidotājs rokas uzgaļa un izmantotā Ultraskaņas šķēres. Lai iegūtu informāciju par noturības koeficientu, skatiet piemērojamos Ultraskaņas šķēres un Ultraskaņas šķēres Pārveidotājs Rokas ierīces lietošanas instrukcija vai 7. nodaļa - Bridinājumi un piesardzības pasākumi.
Drošinātājs	± 5 * 20 T8AH250V
Svars (bez iepakojuma)	ģenerator: nominālais svars 8 kg
Kopējais apjoms	OP9 ģenerator: (garums * platums * augstums): 34 cm-34 cm-16 cm
Izvietojums	Dažas ģenerator, kāju slēdža un kāju slēdža kabeļa iekšējās sastāvdaļas satur svinu. Saskaņā ar vietējiem Prasības un noteikumi par apglabāšanu. Izmetiet baterijas saskaņā ar atbilstošu atkritumu iznīcināšanas praksi.
AP/APG klasifikācija	Ne AP/APG aprīkojums.
Kalpošanas laiks:	Kalpošanas laiks: 7 gadi
Programmatūras izlaiduma versija	V01.01

Bipolāra izejas viļņu forma


Uzlabota bipolāra izejas jaudas un slodzes līkne

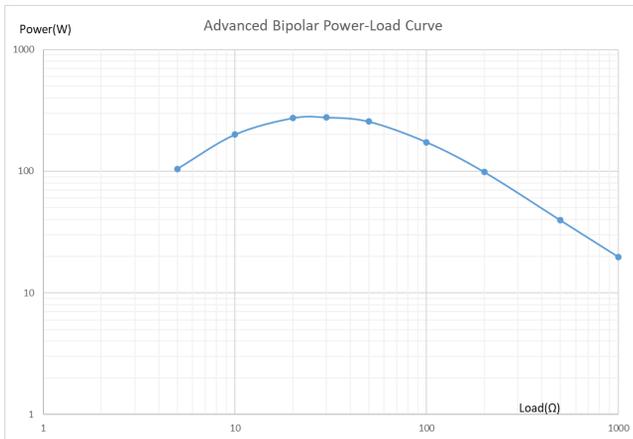

Jaudas līknes ierobežojums Maksimālā jauda: 270[W]			
Slodze (Ω)	Apakšējā robeža	Nominālais	Augšējā robeža
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Nominālās jaudas līkne 270 vati pie nominālās slodzes saskaņā ar jaudas līknes mērītāja strāvas/sprieguma ierobežojumu. Jaudas līkne attēlo aplokšni, kas mainās ekspluatācijas apstākļos.


Bipolārās bipolārās izejas pilnas jaudas un slodzes līkne

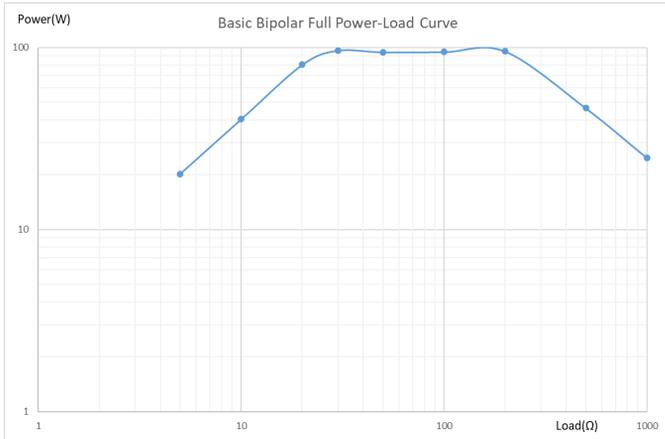

Pilnas jaudas līknes robeža [W]: Maksimālā jauda 95 W

Slodze (Ω)	Apakšējā robeža	Nominālais	Augšējā robeža
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Bipolārās izejas pusjaudas un slodzes pamatlīnija

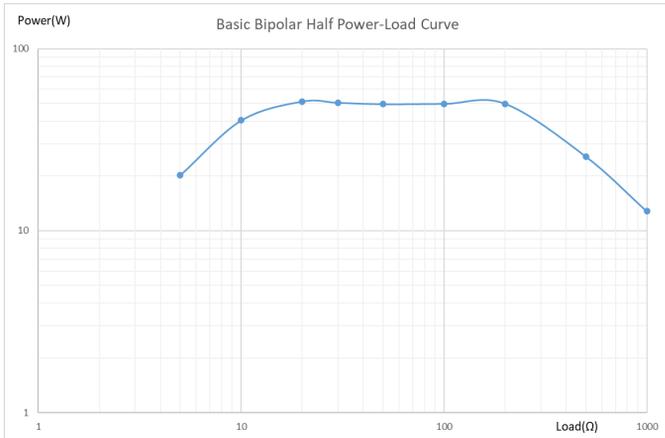

Pusjaudas līknes robeža [W]: Maksimālā jauda 50 W

Slodze (Ω)	Apakšējā robeža	Nominālais	Augšējā robeža
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Izejas jauda atkarībā no jaudas iestatījumiem normālā bipolārā režīmā

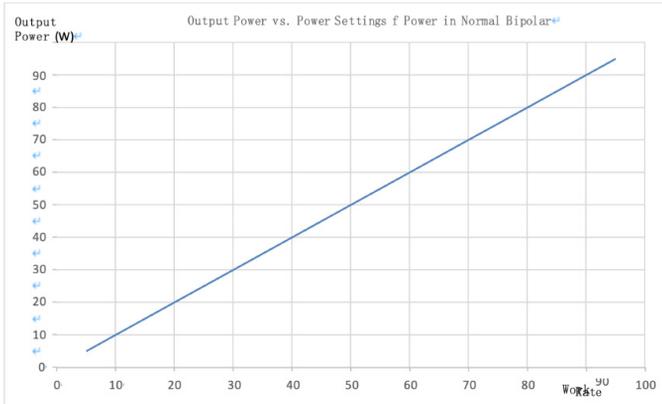

Izejas jauda atkarībā no jaudas iestatītās vērtības normālai divpolārai [W]; Slodze: 200Ω

Iestatītā jauda (W)	Izejas jaudas apakšējā robeža (W)	Nominālā jauda (W)	Augšējā izejas jaudas robeža (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Serviss un garantija

Uzņēmums Reach Surgical, Inc. garantē, ka šim produktam nav materiālu un izgatavošanas defektu normālas lietošanas un profilaktiskās apkopes apstākļos turpmāk norādītajā garantijas periodā. Reach Surgical pienākums saskaņā ar šo garantiju ir tikai labot vai nomainīt, pēc tās izvēles, jebkuru defektīvu izstrādājumu vai daļu, kas ir atgriezta Reach Surgical, Inc. vai tās pilnvarotajam izplatītājam piemērojamā garantijas perioda laikā un ir atzīta par defektīvu, lai apmierinātu Reach Surgical. Šī garantija neattiecas uz produktiem vai daļām, kas ir:

- Nelabvēlīgi ietekmē lietošana ar neautorizētām ierīcēm, ko ražojušas vai izplatījušas personas, kuras nav pilnvarotas Reach Surgical, Inc.
- Remontēts vai pārveidots ārpus Reach Surgical rūpnīcas, ja tas ietekmē ierīces stabilitāti vai uzticamību, kā to nosaka Reach Surgical.
- nepareizas lietošanas, nolaidības vai nelaimes gadījuma dēļ.
- Lietots neatbilstoši izstrādājuma konstrukcijai, lietošanas parametriem, instrukcijām un vadlīnijām vai nozarē pieņemtajiem līdzīgu izstrādājumu funkcionālajiem, ekspluatācijas vai vides standartiem.

Garantijas termiņi

Bipolārā enerģijas pamatkonektors (OP-BPC): 1 gads komponentiem un darbam.

ģenerator (OP9): 1 gads komponentiem un darbam.

Kāju slēdzis/jaudas vads: 1 gads komponentiem un darbam.

Šī garantija ir ekskluzīvs sākotnējā pircēja tiesiskās aizsardzības līdzeklis un aizstāj visas citas garantijas, tiešas vai netiešas, tostarp garantijas par piemērotību pārdošanai un piemērotību konkrētam mērķim. Uzņēmums Reach Surgical, Inc. nav atbildīgs par īpašiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp par zaudējumiem, kas radušies lietošanas, peļņas, uzņēmējdarbības vai labas reputācijas zaudējumu rezultātā, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti piemērojamos tiesību aktos.

Uzņēmums Reach Surgical, Inc. neatļauj nevienai personai uzņemties papildu atbildību saistībā ar tā izstrādājumu pārdošanu un lietošanu. Nav nekādu garantiju, kas pārsniegtu šeit minētos noteikumus.

Uzņēmums Reach Surgical, Inc. patur tiesības veikt izmaiņas savos produktos, uzņemoties saistības ar atpakaļejošu spēku piemērot šīs izmaiņas iepriekš pārdotajiem vai izgatavotajiem produktiem.

Overzicht

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Het bevat belangrijke instructies over de juiste bediening, mogelijke risico's en mogelijke schade aan het product of personen. Volg in het geval van een abnormale situatie de gespecificeerde instructies om schade aan uzelf of aan de apparatuur te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verminderde veiligheid, prestaties, garantie of onderhoud, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Lees ook de instructies voor de Omvormer en Ultrasonische Schaar voordat u het apparaat gebruikt. Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij het gebruik van dit apparaat. Het is geen referentie voor chirurgische technieken.

Gebruikte standaardconventies: Let op, WAARSCHUWING en opmerkingen

Let op de volgende verklaringen, gecategoriseerd als VOORZICHTIG, WAARSCHUWING of OPMERKING, die essentiële richtlijnen geven om taken veilig en grondig uit te voeren. Deze verklaringen staan overal in de documentatie en moeten worden gelezen voordat u verdergaat met de volgende stap in een procedure.

WAARSCHUWING: Deze verklaring wijst op een bedienings- of onderhoudsprocedure, -praktijk of -omstandigheid die, indien niet strikt opgevolgd, kan leiden tot persoonlijk letsel of verlies van leven.

LET OP: Deze waarschuwing wijst de gebruiker op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel voor de gebruiker of de patiënt, en tot schade aan de apparatuur of andere eigendommen. Het kan ook dienen als waarschuwing tegen onveilige praktijken. Dit omvat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor een veilig en effectief gebruik van het instrument en de zorg die nodig is om schade als gevolg van juist of onjuist gebruik te voorkomen.

OPMERKING: Deze verklaring geeft een bedieningspraktijk of -voorwaarde aan die essentieel is voor het efficiënt uitvoeren van een taak.

Beschrijving

Het ENER REACH Elektrochirurgisch Instrument (hierna 'het apparaat' genoemd) wordt gebruikt in medische operatiekamers voor chirurgische procedures voor het snijden, coaguleren van menselijk weefsel en het afbinden van vaten. Het heeft twee afzonderlijke sleuven: één voor ultrasonische energie en de andere voor radiofrequente golfvormoutput.

In radiofrequentiemodus levert de generator verschillende energieschema's, afhankelijk van het aangesloten instrument/elektrochirurgisch apparaat. Wanneer een geavanceerd bipolair instrument is aangesloten, levert de generator RF golfvormen voor het afbinden van arteriële en veneuze vaten, lymfaten en weefselbundels met een diameter tot 7 mm. Wanneer een basis bipolair instrument is aangesloten, wordt constante energie afgegeven voor het snijden en coaguleren van zachte weefsels.

In de ultrasonische energie-uitvoermodus, met gebruik van de TRA6 omvormer in combinatie met de Ultrasonische scalpels voor eenmalig gebruik CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, snijdt het apparaat zachte weefsels waarvoor bloeding onder controle moet zijn en minimale thermische schade, en sluit het vaten af met een maximale diameter van 5 mm. Wanneer aangesloten op Ultrasonische Schaar voor éénmalig gebruik SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 en SRE45, snijdt het apparaat zachte weefsels waarbij bloeding onder controle moet worden gehouden en minimale thermische schade moet worden toegebracht, en dicht het vaten af tot een maximale diameter van 7 mm.

Beoogd gebruik

Het apparaat levert radiofrequente energie om elektrochirurgische handstukken aan te drijven die bedoeld zijn om vaten door te snijden en af te sluiten en om weefsels te snijden, vast te pakken en te ontdeden.

Daarnaast levert de Generator ultrasonische energie om ultrasonische chirurgische instrumenten aan te drijven die geïndiceerd zijn voor incisies in zachte weefsels wanneer bloeding onder controle en minimaal thermisch letsel gewenst zijn.

Indicaties

Het apparaat levert radiofrequente energie om elektrochirurgische handstukken aan te drijven die worden gebruikt tijdens open operaties of laparoscopische operaties in de algemene, pediatrie, gynaecologische, urologische en thoraxchirurgie om vaten tot en met 7 mm door te snijden en af te sluiten en om weefsels te snijden, vast te pakken en te ontdeden.

Bovendien levert de Generator stroom om ultrasonische chirurgische instrumenten aan te drijven die geïndiceerd zijn voor incisies in zachte weefsels wanneer bloeding onder controle en minimaal thermisch letsel gewenst zijn. De ultrasonische chirurgische instrumenten kunnen worden gebruikt als aanvulling op of ter vervanging van elektrochirurgie, lasers en stalen scalpels voor het snijden en/of coaguleren van weefsel bij open chirurgie of laparoscopische chirurgie bij algemene, pediatrie, gynaecologische, urologische en thoraxchirurgie en het afbinden en doorsnijden van lymfaten.

Beoogde gebruiker

Het apparaat is bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg voor chirurgische toepassingen.

Beoogde gebruiksomgeving

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een ziekenhuis.

Beoogde patiëntenpopulatie

Dit hulpmiddel is geschikt voor patiënten van 3 jaar en ouder die chirurgische ingrepen moeten ondergaan waarbij incisies in zachte weefsels worden gemaakt met controle over de bloeding en minimaal thermisch letsel.


Klinisch voordeel

Het apparaat kan veilig en effectief worden gebruikt voor ligatie en deling van vaten, weefselbundels en lymfaten.

Contra-indicaties

Dit hulpmiddel is gecontra-indiceerd voor botincisies, anticonceptieve tubus occlusie en stollingsprocedures. Het is ook niet bedoeld voor gebruik bij neurochirurgie.

Systemensamenstelling

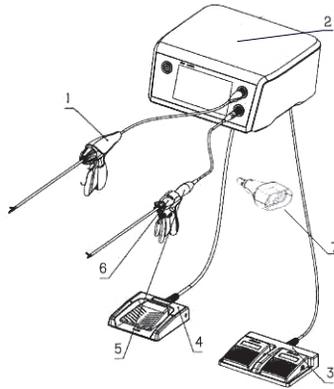

[01] Handstukken voor elektrochirurgie	[02] OP9 Generator
[03] Ultrasonische voetschakelaar	[04] Elektrochirurgische voetschakelaar
[05] Omvormer	[06] Ultrasonische Schaar
[07] Bipolaire connector voor elektrochirurgie	

[01] Elektrochirurgisch handstuk

Het elektrochirurgische handstuk, aangesloten op een generator, wordt tijdens de procedure door de chirurg bediend. Het past RF elektrochirurgische energie toe op weefsel tussen zijn kaken om te coaguleren of af te dichten. Het instrument bevat ook een mes om weefsel te verdelen. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Raadpleeg de instructies voor gedetailleerde informatie.

[02] OP9 Generator

De Generator levert zowel elektrochirurgische energie als energie voor ultrasonische therapie via aparte aansluitporten voor instrumenten. Hij bestaat uit een chassis, omhulsel, elektronische kaart, LCD aanraakscherm, aan/uit-schakelaar en interfaces voor het aansluiten van accessoires.

Model: OP9

[03] Ultrasonische voetschakelaar

Wordt gebruikt om de aan/uitgang van ultrasonische energie te regelen met twee schakelaars ("MIN" en "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrochirurgische voetschakelaar

Wordt gebruikt om de aan/uitvoer van hoogfrequente energie met één schakelaar te regelen.

Model: OP-FSS

[05] Omvormer

De omvormer zet elektrische energie van een compatibele generator om in mechanische beweging voor de bladen van het instrument. Het is een herbruikbaar instrument met een beperkte levensduur. De omvormer is niet steriel en moet voor gebruik volgens de instructies worden gesteriliseerd. Raadpleeg de instructies van de TRA6 Omvormer voor gedetailleerde informatie.

Model: TRA6.

[06] Ultrasonische Schaar

De Ultrasonische Schaar maken gebruik van de mechanische beweging van de omvormer en leveren ultrasonische energie voor het snijden of coaguleren van weefsel. Voorzichtigheid is geboden omdat de mechanische trilling niet waarneembaar is en onbedoeld invloed kan hebben op niet-beoogde gebieden. De Ultrasonische Schaar worden gesteriliseerd met ethyleenoxide. Als de houdbaarheidsdatum wordt overschreden of de sterilisatieverpakking beschadigd is, mag de Ultrasonische Schaar niet worden gebruikt en moet deze worden weggegooid. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Ultrasonische Schaar voor gedetailleerde informatie.

De volgende Ultrasonische Schaar zijn compatibel met de OP9 generator:

PD-serie: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

SRB-serie: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


SRE-serie: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Bipolaire connector voor elektrochirurgie

Wordt gebruikt om bipolaire basisinstrumenten voor elektrochirurgie aan te sluiten op de generator voor weefselcoagulatie.

Model: OP-BPC

Voorpaneel Generator

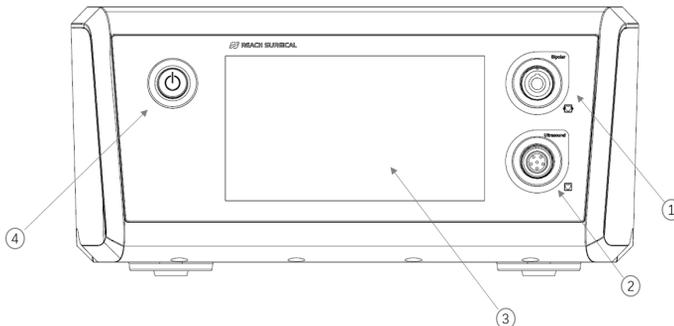

[01] Elektrochirurgische contactdoos

Gebruikt om geavanceerde bipolaire elektrochirurgische instrumenten of bipolaire connector voor elektrochirurgie aan te sluiten.

[02] Omvormeraansluiting

Verbindt de Omvormer met de Generator.


[03] LCD-aanraakscherm

Toont systeem informatie en dient als interface voor het aanpassen van bedieningselementen en instellingen.

[04] Aan/uit-schakelaar Knop

Indrukken om de Generator aan te zetten; ingedrukt houden om uit te zetten.

Achterpaneel Generator

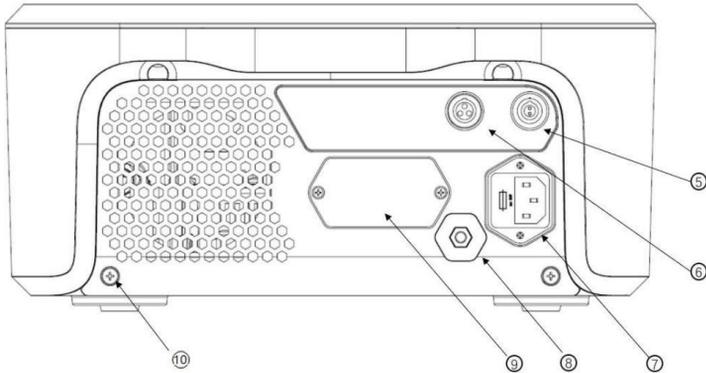

[05] Elektrochirurgische voetschakelaar

Ronde fitting voor aansluiting van een voetschakelaar voor elektrochirurgie.

[06] Ultrasonische Voetschakelaar Contactdoos

Ronde aansluiting voor het aansluiten van de ultrasonische voetschakelaar.

[07] Stopcontact

Sluit het netsnoer aan op de Generator.

[08] Potentiële egalisatiepoort

Als de aarding van het stopcontact niet zeker is, kan deze poort worden aangesloten op een beveiligde aarde.

[09] Uitbreidingsinterface

Gebruikt voor functie-uitbreiding en onderhoud.

[10] Bevestigingsgat

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de meegeleverde richtlijnen voor de gebruiksomgeving.

Uitpakken

Volg de onderstaande instructies bij ontvangst van de onderdelen.

- Controleer op zichtbare transportschade. Als er schade wordt gevonden, neem dan contact op met Reach Surgical, Inc of de plaatselijke vertegenwoordiger voor assistentie.

(Raadpleeg het hoofdstuk 'Technische voorwaarden van het systeem' voor gedetailleerde technische specificaties en productcodes):

Model	Beschrijving	Component
OP9	Generator	Generator, Netsnoer, Instructies
TRA6	Omvormer	Omvormer met kabel
OP-FSD	Ultrasonische voetschakelaar	/
OP-FSS	Bipolaire voetschakelaar	/
OP-BPC	Basis Bipolaire Energie Connector	/

Veiligheidsmaatregelen

- Houd tijdens de inspectie van de apparatuur het distale uiteinde van het instrument uit de buurt van andere apparaten, operatiedoeken, de patiënt of andere voorwerpen om letsel te voorkomen.
- De nodige veiligheidsmaatregelen treffen in de aanwezigheid van dampen, volgens de procedures en voorschriften van het ziekenhuis.

Ultrasonische energie met Ultrasonische Schaar uit de PD-serie

- Sluit de transducer, voetschakelaar en Ultrasonische Schaar uit de PD-serie aan op de generator.
- Nadat de Omvormer en Ultrasonische Schaar zijn getest, past u het vermogensniveau (1-5) aan met de +/- pictogrammen op het LCD-scherm.
- Druk op de knop 'Min' op de Ultrasonische Schaar of op het pedaal Min op de Voetschakelaar om de ultrasonische energie te activeren op het vooraf ingestelde vermogensniveau.
- Druk op de knop 'Max' op de Ultrasonische Schaar of op het pedaal Min op de Voetschakelaar om het maximale energieniveau te leveren.
- Laat de sleutel of voetschakelaar los om de energieafgifte te stoppen.

Ultrasonische energie met Ultrasonische Schaar uit de SRB/SRE-serie

- Nadat de Omvormer en Ultrasonische Schaar zijn getest, past u het vermogensniveau (1-5) aan met de +/- pictogrammen op het LCD-scherm.
- Druk op de Energieknop op het instrument of de Min-knop op het voetpedaal om de ultrasonische energie op het vooraf ingestelde vermogen te activeren.
- Druk op de Energieknop met geavanceerde hemostase op het instrument om de modus Geavanceerde hemostase te activeren.
- Laat de knop op de Ultrasonische Schaar of de knop op de voetschakelaar los om de energietoevoer te stoppen.

Elektrochirurgische bipolaire energie met geavanceerde bipolaire instrumenten

- Het LCD-scherf toont het geavanceerde bipolaire pictogram en het pictogram voor instelbare handbediening.
- Trek aan de Hengel op het instrument of druk op het pedaal van de voetschakelaar om de radiofrequentie te activeren.
- De generator stopt met de energie-uitvoer wanneer de afsluiting is voltooid, wat wordt aangegeven door het pictogram Voltlooid op het scherm.
- Als de ligatie onvolledig is, klinkt er een waarschuwingstoon en wordt er een waarschuwingspictogram weergegeven.

Elektrochirurgische bipolaire energie met bipolair elektrochirurgisch instrument

- Het LCD-scherf toont de vermogenswaarde, instelbare pictogrammen en balken voor het vermogensniveau.
- Het vermogen varieert van 1-95 watt, met instelbare stappen.
- Selecteer de gewenste vermogensstand: Laag (15 watt), Gemiddeld (30 watt) of Hoog (60 watt).
- Druk op de knop op de handschakelaar of het voetpedaal om de radiofrequentie te activeren.
- Laat de knop los om de energie-uitgang te deactiveren.

Aanbevelingen instellen

Effectinstellingen	Vermogen Instellingen Bereik	Klinische toepassing	Geoptimaliseerd apparaat
Laag	1-15 watt	Zoals zenuwen/wervelkolom, handen en gezichts chirurgie	- Apparaten met kleinere oppervlakken - Microtip pincet (0,4 - 2,2 mm)
Midden	16-40 watt	Zoals coagulatie tijdens hoofd/hals, wervelkolom en anatomie	- Apparaten met gemiddeld oppervlak - Microtip pincet (1,0 - 2,2 mm) - Kleine laparoscopische tang met platte kop - Bipolaire schaar
Hoog	45-95 watt (stappen van 5 watt)	Zoals hoofd-/nek- en plastische chirurgie (vergelijkbaar met medium effect, maar met sneller effect)	- Apparaten met grote oppervlakken - Grote laparoscopische tang met platte kop

OPMERKING: Dit apparaat is niet compatibel met een neutrale elektrode.

OPMERKING: De Ultrasonische Schaar en RF elektrische scalpels zijn onderdelen die in contact komen met de patiënt.


De generator gebruiken

Schakel het apparaat in

- Het systeem is klaar voor gebruik zodra het is ingeschakeld. Als de generator is aangesloten op het elektriciteitsnet en het lampje van de stand-byschakelaar brandt, is het systeem klaar voor gebruik.
- Nadat u op de stand-byknop hebt gedrukt, wordt de volgende afbeelding weergegeven:




- Als er geen Omvormer of Ultrasonische Schaar is aangesloten op de Generator, of als ze niet goed zijn aangesloten, wordt het volgende beeld weergegeven:

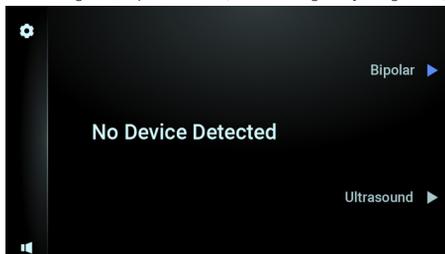


Ultrason instrument gebruiken (Omvormer en Ultrasonische Schaar)

Wanneer Omvormer en Ultrasonische Schaar worden gedetecteerd, wordt het volgende beeld weergegeven.

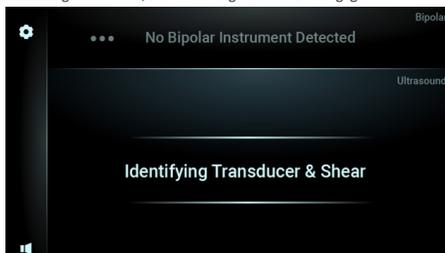


OPMERKING: als het resterende gebruik van de Omvormer minder dan 10 is, wordt de volgende afbeelding weergegeven. Let op het aantal resterende gebruiksuren, want de Omvormer moet worden vervangen als het aantal nul is geworden.

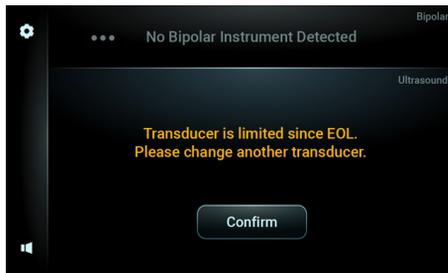


Vervolgens wordt de volgende afbeelding weergegeven en wordt u gevraagd op een willekeurige knop op de Ultrasonische Schaartest met open bekken te starten.



Druk op de willekeurige knop en de volgende afbeelding wordt weergegeven.

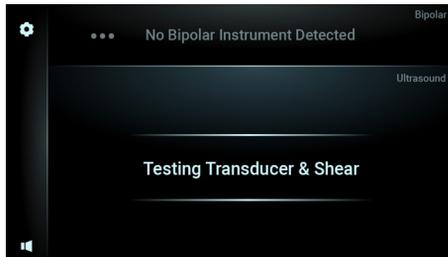


Als de test van de omvormer mislukt, wordt de volgende afbeelding weergegeven:

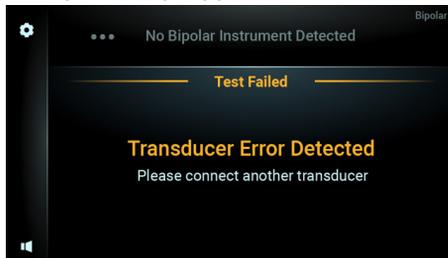

Als de Ultrasonische Schaar test mislukt, wordt de volgende afbeelding weergegeven




Als de omvormer en de Ultrasonische Schaar-test geslaagd zijn, wordt de volgende afbeelding weergegeven:

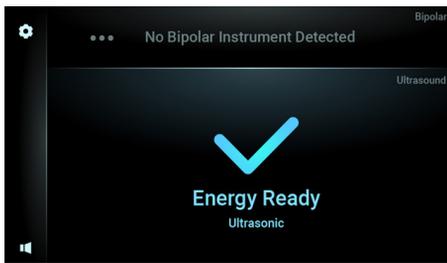

Het volgende werkscherm wordt weergegeven bij het aansluiten van Ultrasonische Schaar zonder geavanceerde hemostasefunctie.




Het volgende werkscherm wordt weergegeven wanneer de SRE Ultrasonische Schaar met Advanced Hemostasis wordt verbonden.

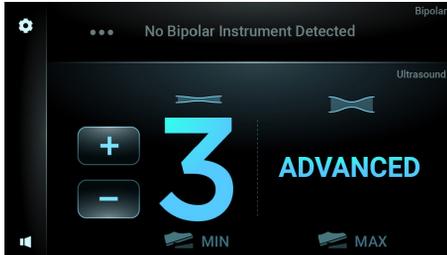


De geactiveerde uitvoermodus wordt gemarkeerd.

Elektrochirurgisch instrument gebruiken


Wanneer Omvormer en Ultrasonische Schaar worden gedetecteerd, wordt het volgende beeld weergegeven.

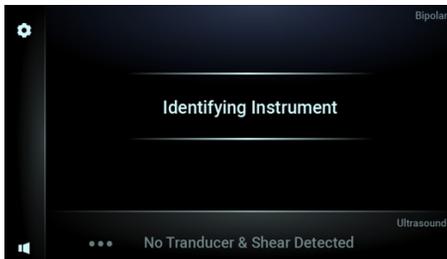


Als de test van het elektrochirurgische instrument slaagt, wordt de volgende afbeelding weergegeven:

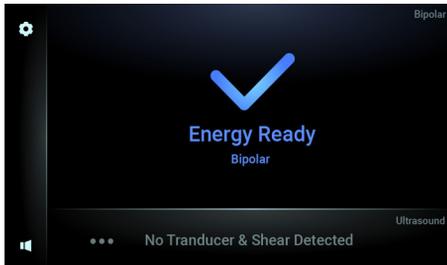

Het volgende werkscherm wordt weergegeven wanneer er verbinding wordt gemaakt met een geavanceerd bipolair instrument.

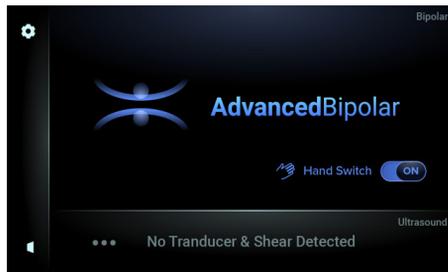

Het volgende werkscherm wordt weergegeven bij het aansluiten op een regulier bipolair instrument.




Gebruik van elektrochirurgisch instrument en Ultrasonische Schaar

Let op: wanneer de Generator is aangesloten op zowel een bipolair elektrochirurgisch instrument als een Ultrasonische Schaar, werkt het systeem in een gesplitste schermmodus om de huidige status weer te geven. Het apparaat dat prioriteit heeft, zal als eerste de energie activeren. Deze gesplitste schermtoestand wordt hieronder weergegeven:



Systeeminstellingen


Om de systeeminstellingen te openen, klikt u op het instellingenpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. De volgende systeeminstellingen zijn beschikbaar:

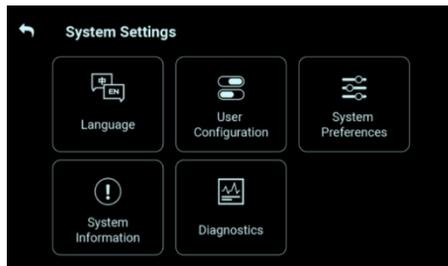

Taal: Als u op het item Taal klikt, wordt het taalkeuzescherm weergegeven:



Gebruikersconfiguratie: Als u op Gebruikersconfiguratie klikt, wordt het gebruikersconfiguratiescherm weergegeven:

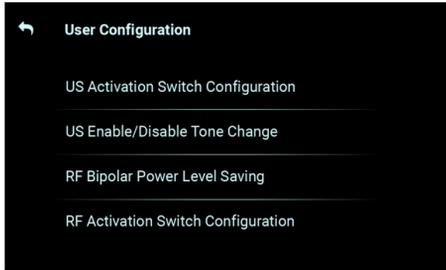


Systeemvoorkeuren: Als u op Systeemvoorkeuren klikt, wordt het scherm met systeemvoorkeuren weergegeven:



Systeeminfo: Klik zachtjes op het item System Info om het systeeminformatiescherm weer te geven:



Diagnostiek: Als je op Diagnostics klikt, wordt het diagnosescherm weergegeven:

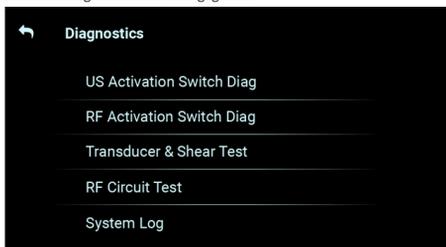

Om de systeeminstellingen te verlaten en terug te keren naar de stand-by-modus van het systeem, drukt u op het pictogram 'Return' in de linkerbovenhoek van het scherm.

Het systeem afsluiten

Volg de onderstaande stappen om het systeem veilig af te sluiten:

Druk op de Stand-by-knop: Zoek de Stand-by-knop op de Generator en druk erop om het uitschakelproces te starten.

Omvormer en Ultrasonische Schaar loskoppelen: Koppel de Omvormer en de Ultrasonische Schaar voorzichtig los van het systeem. Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de juiste hantering van de Omvormer en Ultrasonische Schaar.

Reinigen: Reinig de Generator, Voetschakelaar en Omvormer volgens de gespecificeerde procedures in hoofdstuk 'Onderhoud'.

Problemen oplossen

De Generator bevat verschillende waarschuwingssignalen en foutcodes om te helpen bij de identificatie en diagnose van componentfouten. Het is belangrijk op te merken dat deze signalen en codes ontworpen zijn om het klinisch oordeel en de observatie te ondersteunen, niet om deze te vervangen.

Geluidswaarschuwing

Werkstatus	Type geluid	Mogelijke oorzaak en actie
Status zelf controleren	Normaal geluid	/
	Abnormaal geluid	Er is een hardwarefout gedetecteerd. Neem contact op met de fabrikant voor reparatie.
Ultrason instrument gebruiken	Max. geluidsniveau	/
	Min. geluidsniveau	/
	Abnormaal geluid	De Ultrasonische Schaar is in contact gekomen met te veel weefsel. Verminder het weefselcontact met de Ultrasonische Schaar. Als het continue geluid aanhoudt, verwijder dan voorzichtig weefsel dat zich rond het uiteinde van de Ultrasonische Schaar heeft opgehoopt.
	GEAVANCEERD geluid	/
	ITS-geluid	/
Activerend Elektrochirurgisch Instrument	Geavanceerde bipolaire waarschuwingstoon	/
	Normaal tweepolig geluid	/
	Abnormaal geluid	Niet succesvol snijden: Als het weefsel waarmee het instrument in contact komt niet voldoet aan de snijvereisten, verminder dan de hoeveelheid weefsel die in contact komt met het instrument. Als de fouttoon aanhoudt, verwijder dan zorgvuldig al het weefsel dat zich aan het uiteinde van het instrument heeft opgehoopt. Hardwarefout: Deze fout geeft een mogelijke storing in het circuit of de connector aan. In het geval van een storing of fout wordt aanbevolen de fabrikant te raadplegen of ondersteuning te zoeken voor de juiste begeleiding en oplossing.
		/


Foutcodes

De Energy Platform Generator is uitgerust met een uitgebreid foutidentificatiesysteem dat bestaat uit waarschuwingen en systeemfouten. Als er een fout wordt gedetecteerd, geeft de Generator een waarschuwingstoon, verschijnt er een waarschuwingssignaal op het bedieningspaneel en wordt er een bijbehorende foutcode weergegeven op het LCD-scherm. Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

Tabel met foutcodes

Foutcode	Overeenkomstige foutmelding
Waarschuwing	Ultrasonische Schaar met Omvormer correct aansluiten a.u.b.
Waarschuwing	Zorg ervoor dat de kaken open zijn tijdens het testen
Waarschuwing	Ultrasonische Schaarfout gedetecteerd
Waarschuwing	De resterende tijd van de omvormer is nul
Waarschuwing	Activeer slechts één knop tegelijk
Waarschuwing	Verminder de kracht op de Ultrasonische Schaar
Waarschuwing	Ultrasonische Schaar knop en voetschakelaar kunnen niet tegelijkertijd worden gesloten
Waarschuwing	Knop zit vast, controleren en doorgaan
Waarschuwing	Kaken aanpassen of minder weefsel vastklemmen
Waarschuwing	Verwijder het apparaat uit de weefsels
Systeemfout	Systeemfout
Systeemfout	Zelfcontrole mislukt

Als er tijdens het testen een fout op het scherm verschijnt, voer dan de volgende acties uit:

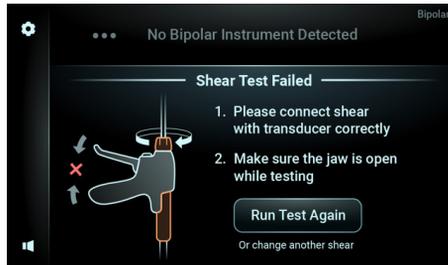

- Zorg ervoor dat de kabel van de Omvormer volledig in de juiste richting is gestoken.
- Controleer of de Ultrasonische Schaar goed is vastgedraaid en of zich weefsel heeft opgehoopt rond het uiteinde van de Ultrasonische Schaar. Pas de spanning

van de Ultrasonische Schaar aan en verwijder voorzichtig weefseloophoping rond de behuizing van de Ultrasonische Schaar. (Als de test vóór de operatie wordt gestart, moet u ervoor zorgen dat de Ultrasonische Schaar naar de lucht wijst. Als de Ultrasonische Schaar wordt gebruikt, controleer dan of de klembek open is en geen voorwerpen raakt).

- Als het probleem aanhoudt, kunt u overwegen de Omvormer of Ultrasonische Schaar te vervangen.
- Ga naar de werkmodus van de apparatuur.

OPMERKING: De Omvormer werkt mogelijk niet goed als de temperatuur de gespecificeerde limiet overschrijdt. Gebruik in dergelijke gevallen onmiddellijk een andere Omvormer voor herstel of volg de onderstaande stappen om de oorzaak van de fout vast te stellen en optionele herstelmethode te onderzoeken:

- Laat de Omvormer minimaal 45 minuten afkoelen bij kamertemperatuur. Deze afkoelmethode is ook van toepassing als de Omvormer heet wordt na langdurig gebruik op hoog vermogen.
- Als Omvormer niet duidelijk oververhit raakt en het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de onderhoudsafdeling van de fabrikant voor assistentie.
- Afgezien van de zekeringen bevat de Generator geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem voor vervanging of service contact op met onderhoudspersoneel dat is opgeleid en geautoriseerd door Reach Surgical, Inc. of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Onderhoud en upgrades van de Generator mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat is opgeleid en geautoriseerd door Reach Surgical.

Er moeten voorzorgsmaatregelen op het gebied van cyberbeveiliging worden overwogen om potentiële bedreigingen te voorkomen. De volgende incidenten vormen een risico voor cyberbeveiliging:

- Onbevoegde toegang tot niet-gerelateerde producten voor het apparaat.
- Elke niet-geautoriseerde netwerkcommunicatie met het apparaat.
- Firmware- of software-updates die niet zijn goedgekeurd door Reach Surgical.

Neem in het geval van een van de bovenstaande incidenten contact op met de verkoopvertegenwoordiger van Reach Surgical, Inc. of neem rechtstreeks contact op met Reach Surgical, Inc. via Reachquality@reachsurgical.com.

Onderhoud

Generator en Basic Bipolar Energy Connector reinigen en desinfecteren

Schoonmaken

Reinig het LCD-scherm van de Generator en de bipolaire basisconnector volgens de procedures en voorschriften van het ziekenhuis. Voordat u begint met reinigen, moet u ervoor zorgen dat de hoofdvoeding van de Generator is losgekoppeld en dat het netsnoer uit de uitgangseenheid is verwijderd.

WAARSCHUWING: Reinigingsprocedures moeten zorgvuldig worden gevolgd om schade aan de Generator, elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Mors geen vloeistoffen op of in de Generator en dompel hem niet onder in vloeistof.

Volg deze stappen voor het schoonmaken:

- Bereid een neutraal pH-detergent of neutraal pH-enzymdetergent zoals aangegeven door de fabrikant van het detergens.
- Veeg alle oppervlakken, inclusief het scherm van de Generator, handmatig schoon met een schone, zachte doek die gedrenkt is in een kleine hoeveelheid reinigingsoplossing.
- Neem alle oppervlakken af met een schone, zachte doek gedrenkt in warm kraanwater.
- Veeg ten slotte alle oppervlakken af met een schone, zachte doek om ervoor te zorgen dat ze droog zijn.

Desinfectie

• Als de generator besmet raakt met bloed of lichaamsvloeistoffen, moet hij worden gedesinfecteerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt. De volgende chemische ontsmettingsmiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik op de generator: 70% isopropylalcohol, 6% natriumhypochloriet, 10% waterstofperoxide.

- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor het juiste gebruik, de concentratie en de contacttijd van de ontsmettingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat desinfecterende middelen geconfigureerd en gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.

De Voetschakelaar Reinigen

Reinig de Voetschakelaar en kabel na elk gebruik volgens de onderstaande procedure:

- Koppel de Voetschakelaar los van de Generator.
- Bereid een neutraal pH-enzymreinigingsmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Sluit de kabel goed aan op de Voetschakelaar en dompel deze 2 minuten onder in de reinigingsoplossing.

LET OP: Zorg ervoor dat de kabel van de Voetschakelaar die wordt gebruikt om de Generator aan te sluiten volledig droog is om te voorkomen dat deze per ongeluk wordt geactiveerd.

- Schrob de Voetschakelaar en kabel na het onderdompelen met de hand met een zachte borstel in de reinigingsoplossing.
- Spoel de Voetschakelaar en kabel grondig af met warm kraanwater gedurende minstens 1 minuut.

LET OP: Houd de kabel en Voetschakelaar goed aangesloten tijdens het spoelen.

- Veeg alle oppervlakken schoon met een schone, zachte doek.

WAARSCHUWING: Gebruik geen ultrasoon reinigingsapparaat om de Voetschakelaar te reinigen.

WAARSCHUWING: Schakel de voeding van de Generator niet in voordat de AC-stroomkabel is aangesloten. Zorg ervoor dat alle aansluitingen droog zijn voor de montage.

Omvormer reinigen en desinfecteren

Omvormers worden niet-steriel verzonden en moeten voor elk gebruik grondig gereinigd en gesteriliseerd worden.

Schoonmaken:

Maak de Transducer grondig schoon volgens de onderstaande stappen:

- Spoel de Transducer met de schroefzijde naar boven en reinig hem met een zachte borstel met gezuiverd water tot er geen vegen meer op het oppervlak zitten;
- De Transducer wordt geweekt in een pH-neutraal enzymatisch reinigingsmiddel (hoofdbestanddelen: protease, lipase, amylase, cellulase, pectinase en andere biologische enzymen, milieuvriendelijk oppervlakte-actieve stof, roestwerende factor en stabilisator) gedurende een periode van maximaal 10 minuten bij een geschikte temperatuur van 15°C-65°C. De verhouding wasmiddel en gezuiverd water is 1:400.
- Spoel de Transducer met de schroefzijde naar boven gedurende 2 minuten af met gezuiverd water;
- Reinig de aansluitschroef, Scalpel montage oppervlak en de connector met een alcoholdoekje.
- Dompel de Transducer in 75% medische alcohol en houd hem 30 keer vast en schud hem;
- Spoel de Transducer met de schroefzijde naar boven gedurende 2 minuten af met gezuiverd water.

Opmerking: Het gebruik van ultrasone reinigingsmiddelen wordt niet aanbevolen voor de Transducer.

Drogen:

Droogtemperatuur: 50-70°C, droogtijd: 30min.

Sterilisatie van de Transducer:

Na de bovenstaande reinigings- en droogstappen moet de Transducer worden gesteriliseerd volgens een van de onderstaande methoden.

Stoom Sterilisatie (121°C)

- De schede moet vóór de sterilisatie worden geïnstalleerd. De Transducer moet tijdens de sterilisatie worden omwikkeld. Plaats de Transducer in een

hoge-temperatuur stoomsterilisatie pot voor sterilisatie, met een temperatuur van 121°C en een duur van 30min.

- Droogtemperatuur: 50-70°C, droogtijd: 30min.

Stoom Sterilisatie (134°C)

- De schede moet vóór de sterilisatie worden geïnstalleerd. De Transducer moet tijdens de sterilisatie worden omwikkeld. Plaats de transducer in een hoge-temperatuur stoomsterilisatie pot voor sterilisatie, met een temperatuur van 134°C en een duur van 10min.
- Droogtemperatuur: 50-70°C, droogtijd: 30min.

Veiligheid en functionele tests

Zorg voor de uitvoering van veiligheids- en functietests voor de Omvormer, Generator en Voetschakelaar in overeenstemming met de procedures en voorschriften van het ziekenhuis. Voor veiligheids- en functietests van andere componenten die door meerdere patiënten worden gebruikt, raadpleegt u de specifieke gebruiksaanwijzing van elke component.

Veiligheidstest

Generator: Gecertificeerde ziekenhuistechnici moeten een lekstroomtest uitvoeren.

Voetschakelaar: Controleer het pedaal, de kabelconnector en de kabel op scheurtjes of beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen.

Andere onderdelen: Controleer alle andere componenten zoals aangegeven in hun respectievelijke gebruiksaanwijzingen.

Functionele test

Ultrasonische modus

- Maak de complete set PD Ultrasonische Schaar gereed en sluit de Omvormer aan volgens de instructies in Hoofdstuk II - Installatie en bediening van de apparatuur.
 - Controleer of het mogelijk is om de werkstatus te openen. Verschillende Ultrasonische Schaar kunnen verschillende invoerinterfaces hebben. Raadpleeg Deel 1, Sectie 3 van Hoofdstuk 2 voor gedetailleerde instructies.
 - Bevestig de weergave van MIN vermogen niveau 3 en MAX vermogen niveau 5.
 - Druk op de knoppen voor het verhogen en verlagen van het vermogen om ervoor te zorgen dat het MIN-vermogensniveau kan worden aangepast van niveau 1 tot 5.
 - Zet de Generator aan en schakel hem in ultrasonische werkmodus. Controleer de juiste aansluiting van de omvormer en Ultrasonische Schaar.
 - Druk met de bek open op de knop "MAX" op de Voetschakelaar. Het LCD-scherm moet het MAX-vermogensniveau "5" weergeven en er moet een activeringstoon klinken.
 - Druk met de bek open op de knop "MIN" op de Voetschakelaar. Het LCD-scherm moet het MIN vermogen weergeven en er moet een activeringstoon klinken.
- WAARSCHUWING:** Voordat u het systeem activeert, moet u ervoor zorgen dat de kaak uit de buurt blijft van weefsels, andere instrumenten of andere voorwerpen om letsel bij de gebruiker te voorkomen.

Bipolaire elektrochirurgische modus

- Sluit het geavanceerde bipolaire Elektrochirurgische instrument/basis bipolaire instrument aan volgens de instructies.
- Controleer of het systeem de werkinterface kan openen. De bipolaire basismodus moet het pictogram met 30 vermogensniveaus weergeven, terwijl de bipolaire geavanceerde modus het pictogram "advanced bipolar" moet weergeven.
- Raak de toetsen voor het verhogen en verlagen van het vermogen onder de bipolaire basismodus lichtjes aan om te bevestigen dat het vermogensniveau kan worden aangepast tussen 1 en 95. Raak de balken Low, Medium en High aan om direct te schakelen tussen 15, 30 en 60.
- Schakel de generator uit en wacht 5 seconden. Schakel vervolgens de voeding van de generator in en wacht 10 seconden. Controleer of in de bipolaire basismodus de interface met 30 vermogensniveaus wordt weergegeven en in de bipolaire geavanceerde modus de interface "advanced bipolar". Controleer of de generator geactiveerd is volgens de vooraf bepaalde vereisten.
- Sluit de bipolaire Elektrochirurgische instrumenten advanced en Basic aan en druk op de enkele voetschakelaar. Controleer of het energieniveau op het bedieningspaneel knippert en luister of u een activeringsgeluid hoort.

WAARSCHUWING: Voordat het systeem wordt geactiveerd, is het ten strengste verboden om de Ultrasonische Schaar in contact te laten komen met weefsels, andere instrumenten of andere voorwerpen om letsel bij de gebruiker te voorkomen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Systeemgerelateerd

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik en volg de ziekenhuisrichtlijnen voor klinische praktijken voor ultrasonische chirurgie, elektrochirurgie, gynaecologie en laparoscopie.
- Minimale invasieve hulpmiddelen kunnen per fabrikant verschillen. Als minimaal invasieve instrumenten en accessoires van verschillende fabrikanten tegelijkertijd bij een operatie worden gebruikt, controleer dan vóór de operatie de compatibiliteit van de instrumenten en accessoires en controleer of de in het menselijk lichaam ingebrachte accessoires een ruw oppervlak, scherpe rand of uitsteeksel hebben dat veiligheidsrisico's kan veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door opgeleide en bevoegde chirurgen. Gebruik geen elektrochirurgische apparaten tenzij u goed bent opgeleid in het gebruik ervan voor de specifieke procedure die u moet uitvoeren. Ongetraind gebruik van dit apparaat kan onbedoeld ernstig letsel bij de patiënt veroorzaken, waaronder darmp perforatie en onbewuste en onherstelbare weefselnecrose.
- Open de behuizing van de generator niet zonder toestemming om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. Reparaties en upgrades van het instrument moeten worden uitgevoerd door een onderhoudspersoon die is opgeleid en geautoriseerd door Reach Surgical, Inc. Gebruik dit instrument niet voor andere doeleinden dan medische chirurgie.
- Een grondig begrip van de principes en technieken die betrokken zijn bij laser-, elektrochirurgische en ultrasonische procedures is essentieel om schokken en brandwonden bij zowel de patiënt als medisch personeel en schade aan dit apparaat of andere medische apparaten te voorkomen. De elektrische isolatie of aarding mag niet worden aangetast. Dompel elektrochirurgische apparaten niet onder in vloeistoffen, tenzij het ontwerp dit vereist en op het etiket staat dat ze moeten worden ondergedompeld.
- Veilige en effectieve ultrasonische chirurgie en elektrochirurgie zijn niet alleen afhankelijk van het ontwerp van de apparatuur, maar ook grotendeels van vele factoren die door de gebruiker worden gecontroleerd. Lees, begrijp en volg de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd om de veiligheid en effectiviteit te verbeteren.
- Zoals bij alle energiebronnen (elektrochirurgie, laser of ultrageluid) moet rekening worden gehouden met de kankerverwekkende en infectieuze risico's die veel weefselsbijproducten, zoals rook en aerosolen, met zich mee kunnen brengen. Passende voorzorgsmaatregelen zoals veiligheidsbrillen, filtratiemaskers en effectieve ontrokkingsapparatuur moeten in acht worden genomen bij zowel open als endoscopische procedures.
- Controleer na het verwijderen van de prothese of het weefsel hemostase heeft. Als er geen hemostase is, moeten geschikte methoden worden gebruikt om hemostase te bereiken.
- Producten die zijn gefabriceerd of gedistribueerd door bedrijven die niet zijn geautoriseerd door Reach Surgical, Inc. zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat. Het gebruik van dergelijke producten kan leiden tot onverwachte resultaten en kan de gebruiker of patiënt letsel toebrengen.
- Om het risico op interferentie te verminderen, moeten het apparaat en de behuizing worden aangesloten met een onafhankelijk voedingscircuit.
- De apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of met zuurstof of lachgas. Kans op velen door botsing met andere metalen apparaten. Vonken kunnen ontvlambare gassen, zoals veldgassen, ontsteken.
- Het moet werken binnen het vereiste omgevingsdruktemperatuurbereik.
- De spanning van het stopcontact moet voldoen aan de vereisten van de generator (hoofdstuk "Technische voorwaarden van het systeem"). Als de

voeding niet correct is aangesloten, kan dit de generator beschadigen en elektrische schokken of brand veroorzaken.

- Gebruik geen verlengsnoeren om brandgevaar te voorkomen.
- Zet de activeringstroom niet op een onhoudbaar niveau. Activeringstonen kunnen worden opgemerkt door het chirurgisch personeel terwijl de generator energie levert.
- Er is aangehouden dat rook die vrijkomt tijdens elektrochirurgie mogelijk schadelijk is voor patiënten of chirurgisch teampersoneel. Stel adequate ventilatie vast met een chirurgische rookafzuiging of andere middelen.
- Sommige onderdelen van de Ultrasonic Surgical Integrated Generator worden niet-steriel verzonden (bijv. Omvormer). Steriliseer het product zoals vereist voordat u begint met de installatie van het systeem. Raadpleeg elke relevante instructie voor reinigings- en sterilisatie-instructies.
- Om letsel bij gebruikers of patiënten te voorkomen, moet het Ultrasonic Schaar andere apparaten, operatiedoeken, patiënten of andere voorwerpen vermijden voordat op de testknop wordt gedrukt en tijdens de systeemcontrole. Veiligheidsmaatregelen in geval van aerosol (volgens ziekenhuvoorschriften) moeten worden geïmplementeerd in de systeeminspectie en testmethode.
- Oefen niet te veel druk uit op de kaak om te voorkomen dat de ultrasonische energie niet wordt afgegeven.
- Om letsel bij de gebruiker te voorkomen, moet het mes contact met weefsel, andere apparaten of andere voorwerpen vermijden voordat het systeem wordt geactiveerd.
- Als er vloeistof op of in de generator wordt gespoten of gegoten, of als de generator in de vloeistof wordt gemorst of gegoten, kan dit de generator beschadigen en elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Vonken en verhitting bij het sluiten van vaten kunnen beide als ontstekingsbron dienen. Gaas en een spons moeten vochtig blijven. Houd elektroden uit de buurt van brandbare materialen en zuurstofrijke (O2) omgevingen.
- Als de Omvormer ernstig beschadigd is of als onderdelen tekenen van beschadiging vertonen na reiniging en desinfectie, gooi ze dan weg. Beschadigde onderdelen zijn duidelijk gemarkeerd om verkeerd gebruik te voorkomen voordat ze opnieuw worden gebruikt.
- Wegwerpaafval en elektronisch afval moeten worden afgevoerd volgens de ziekenhuvoorschriften en mogen niet zomaar worden weggegooid om milieuvuiling te voorkomen.
- Gebruik de generator niet in de buurt van of gestapeld op andere apparatuur. Als gebruik in de buurt van of gestapeld op andere apparatuur noodzakelijk is, controleer dan de generator en andere apparatuur om een juiste werking te garanderen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem voor service contact op met uw Reach Surgical vertegenwoordiger of onderhoudspersoneel.
- Controleer alle apparaten die op het systeem zijn aangesloten en de aansluitingen vóór gebruik. Controleer of het apparaat werkt zoals bedoeld. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot vonken, vonkvorming, defecten aan het apparaat of onbedoelde chirurgische resultaten.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Houd zo ver mogelijk afstand tussen de generator en andere elektronische apparaten (bijv. monitors). Elektrische draden niet kruisen of vastmaken aan elektronische apparaten. De generator kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
- Het systeem moet met voorzichtigheid worden gebruikt in aanwezigheid van interne en externe pacemakers. Interferentie veroorzaakt door het gebruik van elektrochirurgische instrumenten kan ertoe leiden dat de pacemaker in een asynchrone toestand komt of dat de pacemaker helemaal niet meer functioneert. Neem contact op met de fabrikant van de pacemaker of de cardiologische afdeling van het ziekenhuis voor aanvullende informatie wanneer elektrochirurgische of weefsel dichtingsinstrumenten bedoeld zijn voor gebruik bij patiënten met pacemakers.
- Wees voorzichtig als u instrumenten op de generator stapelt of als u de generator op elektrische instrumenten plaatst. Dit is een onstabiele configuratie en zorgt niet voor voldoende koeling.
- Als de generator uitvalt, kan dit een chirurgische onderbreking veroorzaken. Er moet een back-upsysteem beschikbaar zijn.
- Als de plaatseleke voorschriften dit vereisen, moet de generator met een equipotentiaal label worden aangesloten op de equipotentiaalaansluiting van het ziekenhuis.
- Wanneer het systeem en fysiologische bewakingsapparatuur tegelijkertijd bij dezelfde patiënt worden gebruikt, moet elke bewakingselektrode zo ver mogelijk van het instrument worden geplaatst.
- Kies in de bipolaire basismodus het laagst mogelijke uitgangsvermogen voor het gewenste effect.
- Het falen van hoogfrequente chirurgische apparatuur kan een onverwachte toename van het uitgangsvermogen veroorzaken.
- De Generator en de bipolaire basisconnector voor elektrochirurgie kunnen worden aangetast door water of deeltjes. Tijdens gebruik en reiniging moet het binnendringen van water of deeltjes worden voorkomen.
- Wanneer het systeem wordt gebruikt in combinatie met een endoscoop, kan de lekstroom op het lichaam van de patiënt toenemen. Let hierop tijdens de procedure.
- Een kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt dat elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan Reach Surgical, Inc. via reachquality@reachsurgical.com. en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Instrument gerelateerd

Tijdens chirurgische ingrepen is het belangrijk om te weten dat het uiteinde van de Ultrasonische Schaar, het Ultrasonische Schaarkompres en de schacht verhoogde temperaturen kunnen bereiken wanneer ultrasoon of bipolaire elektrocauterisatie gedurende langere tijd op weefsel wordt toegepast. Om de veiligheid te garanderen, is het van cruciaal belang om elk onopzettelijk contact tussen deze instrumentonderdelen en weefsel, operatiedoeken, operatiejassen of andere ongerelateerde gebieden tijdens de procedure te vermijden.

Verder is het essentieel om voorzichtig te zijn bij het plaatsen van het bipolaire instrument. Het mag met name niet in de buurt van of in contact met brandbare materialen zoals gaas of chirurgisch afdek materiaal worden geplaatst. De bipolaire instrumenten die in deze context worden gebruikt, kunnen tijdens het gebruik warme producten, wat tot brandgevaar kan leiden. Wanneer de bipolaire elektrochirurgische generator niet in gebruik is, moet deze op de juiste wijze worden opgeborgen in de beschermhoes of op veilige afstand worden gehouden van de patiënt, leden van het chirurgisch team en brandbare materialen.

OPMERKING: Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor aanvullende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

EMC-informatie

Het product heeft de elektromagnetische compatibiliteitstest doorstaan en voldoet aan de beperkingseisen van de IEC60601-1-2 norm voor medische apparatuur. Deze beperkingen bieden een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in normale medische installaties.

Samenstelling van het product

Serienummer	Naam onderdeel	Model/Versienr.	Opmerkingen
1	Elektrochirurgisch instrument	OP9	/
2	Transducer voor ultrasonische chirurgische apparatuur	TRA6	Compatibel gebruik
3	Ultrasonische Schaar voor eenmalig gebruik Ultrasonische Schaar	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Compatibel gebruik
4	Wegwerpbaar ultrasonische hoogfrequente chirurgie-eenheid Weefselafdichting	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrasonische voetschakelaar	OP-FSD	/
6	Elektrochirurgische voetschakelaar	OP-FSS	/
7	Bipolaire connector voor elektrochirurgie	OP-BPC	/

Kabel

Serienummer	Naam Kabel	Lengte (m)	Afgeschermd
1	Kabel voor voetbediening	3	Ja
2	Netsnoer	5	Geen
3	Bipolaire elektrochirurgische kabel	3	Geen
4	De kabel van Omvormer	2,9	Ja

EMC-prestaties

Deze apparatuur kan onderhevig zijn aan radiofrequentiestoring veroorzaakt door andere medische apparatuur en radiocommunicatie. Om dergelijke interferentie te voorkomen, is dit product getest volgens IEC 60601-1-2 en voldoet het aan de vereisten. Reach Surgical, Inc. garandeert echter niet dat er absoluut geen storing zal optreden in individuele installatieomgevingen.

Als wordt vastgesteld dat het apparaat wordt gestoord (wat kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten), moet de gebruiker (of door Reach Surgical, Inc. goedgekeurd onderhoudspersoneel) proberen een of meer van de volgende maatregelen te nemen om het storingsprobleem op te lossen: Pas de richting of positie aan van het apparaat dat dit beïnvloedt.

Vergroot de afstand tussen dit apparaat en het verzendende apparaat.

Gebruik andere voedingsbronnen (in plaats van de stroom die wordt gebruikt om de apparatuur te beïnvloeden) om deze apparatuur van stroom te voorzien.

Raadpleeg de leverancier of servicevertegenwoordiger voor andere suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor interferentie veroorzaakt door de volgende situaties: gebruik andere dan de aanbevolen verbindingskabels; wijzig of modificeer dit apparaat zonder toestemming. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de apparatuur minder goed werkt.

Alle soorten elektronische apparatuur kunnen elektromagnetische storingen veroorzaken in andere apparatuur via de lucht of andere kabels die erop zijn aangesloten. Gebruik geen apparatuur in de buurt van dit apparaat die RF-signalen kunnen uitzenden, zoals mobiele telefoons, radiozondontvangers of radiobedieningsproducten, omdat dit ertoe kan leiden dat de prestaties van dit apparaat niet aan de opgegeven specificaties voldoen. Wanneer dergelijke apparaten zich in de buurt van dit apparaat bevinden, schakelt u deze apparaten uit. Het medisch personeel dat verantwoordelijk is voor deze apparatuur moet technici, patiënten en ander personeel dat zich in de buurt van deze apparatuur bevindt, instrueren om de bovenstaande vereisten volledig na te leven.

Om de gespecificeerde EMC-prestaties volledig te bereiken, moet de gebruiker het product correct installeren volgens de in de handleiding beschreven stappen. Als er EMC-gerelateerde problemen zijn, neem dan contact op met het onderhoudspersoneel dat is goedgekeurd door Reach Surgical, Inc. De Omvormer (met kabel) en Ultrasonische Schaar worden gedefinieerd als het toegepaste deel van het hele systeem.

Voorzorgsmaatregelen voor installatie van het product

De apparatuur kan worden gebruikt in een ziekenhuisomgeving, maar bevat geen ruimten met radiofrequente afscherming rond actieve chirurgische apparatuur met radiofrequentie of waar apparatuur voor magnetische resonantie wordt geplaatst, omdat de intensiteit van elektromagnetische storingen op deze locaties hoog is.

Scheidingsafstand en invloed van vaste radiocommunicatieapparatuur: de magnetische veldsterkte die wordt gegenereerd door vaste zenders, zoals basisstations van draadloze (cellulaire/draadloze) telefoons, landmobiele radio-ontvangers, radioamateurontvangers, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen Generators, enz. kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden gemeten. Om de elektromagnetische omgeving die wordt gegenereerd door vaste RF-zenders te beoordelen, moet de meting van het elektromagnetische veld worden overwogen. Als de gemeten waarde van de magnetische veldsterkte op de locatie van het apparaat hoger is dan het overeenkomstige radiofrequentieniveau dat is gespecificeerd in de "Anti-Interference Statement", moet het apparaat worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat het normaal kan functioneren. Als er abnormale werkomstandigheden worden gevonden, moeten aanvullende metingen worden overwogen, zoals het heroriënteren of verplaatsen van het apparaat, of het gebruik van een radiofrequentieruimte.

1) Gebruik het bijgeleverde of door Reach Surgical, Inc. aangewezen netsnoer. Producten met een stekker moeten worden aangesloten op een vast stopcontact met randaarde. Gebruik geen enkel type adapter of connector om de stekker aan te sluiten.

2) Houd dit apparaat zo veel mogelijk uit de buurt van andere elektronische apparaten.

3) Volg de stappen om het apparaat aan te sluiten.

Algemene opmerkingen

(1) De specificatie van de kabel.

Het gebruik van kabels geleverd door Reach Surgical, Inc zal de EMC-prestaties van dit product niet schaden. Als niet-gespecificeerde kabels worden gebruikt, kunnen de EMC-prestaties van dit apparaat aanzienlijk worden verminderd.

(2) Voorzorgsmaatregelen voor ongeoorloofde wijzigingen

De gebruiker mag dit product niet wijzigen, anders kunnen de EMC-prestaties van dit product afnemen.

De aanpassing van het product omvat de volgende wijzigingen:

a. Kabel (lengte, materiaal, bedrading, enz.).

b. Installatie/lay-out van apparatuur.

c. Apparatuurconfiguratie/onderdelen.

d. Onderdelen ter bescherming van de apparatuur (openen/sluiten van de afdekking en bevestigingsonderdelen van de afdekking).

(3) Alle beschermkappen moeten gesloten zijn wanneer de apparatuur wordt gebruikt.

Dit product zal naar verwachting worden gebruikt in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd, en de koper en gebruiker van dit product dienen ervoor te zorgen dat het in deze elektromagnetische omgeving wordt gebruikt.

Essentiële prestaties

1. Voor geavanceerde hoogfrequente radio-energieoutput moet het systeem ervoor zorgen dat de afwijking van het nominale uitgangsvermogen niet meer dan 20% van de standaardwaarde bedraagt.

2. Voor de uitgangsfrequentie van hoogfrequente radio-energie moet het systeem ervoor zorgen dat de afwijking van het nominale uitgangsvermogen niet meer dan 20% van de standaardwaarde bedraagt.

Leidraad en verklaring van de fabrikant - ELEKTROMAGNETISCHE EMISSIES		
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die als volgt wordt gespecificeerd.		
De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.		
Emissietest	Naleving	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
RF-emissies CISPR 11	Groep1	Het apparaat gebruikt alleen RF energie voor zijn interne werking. Daarom zijn de RF-emissies zeer laag en zullen ze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in elektronische apparatuur in de buurt.
RF-emissies	Klasse A	De EMISSIE-eigenschappen van dit apparaat maken het geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en ziekenhuizen.
Harmonische stroom IEC 61000-3-2	Klasse A	

Spanningsveranderingen/ spanningsschommelingen/ flickering IEC 61000-3-3	Voldoet	
--------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die als volgt is gespecificeerd.
De klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Elektrostatisch ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2,4,8,15kV lucht	± 8 kV contact ± 2,4,8,15kV lucht	De vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, De relatieve vochtigheid moet minstens 30% zijn.
Elektrische snelle stroomstoot/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor voedingslijnen ± 1 kV voor ingangs-/ uitgangsledingen	± 2 kV voor voedingslijnen ± 1 kV voor ingangs-/ uitgangsledingen	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Overspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV lijn(en) naar lijn(en) ± 2 kV lijn(en) naar aarde	± 1 kV lijn(en) naar lijn(en) ± 2 kV lijn (s) naar aarde	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Spanningsdips, kortsluiting onderbrekingen op voedingsingangslijnen IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315°. 0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Enkele fase: bij 0° 0% UT; 250/300 cycli	0 % UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Enkele fase: bij 0° 0% UT; 250/300 cycli	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van de chirurgische echografie apparatuur moet blijven werken tijdens stroomonderbrekingen, wordt aanbevolen om de Ultrasonische chirurgische apparatuur te vervangen door de Ultrasonische chirurgische apparatuur. Apparatuur moet worden gevoed door een ononderbrekbare stroomvoorziening of een batterij.
Stroomfrequentie (50/60 Hz) Magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Vermogen frequentie magnetisch velden moeten op niveau karakteristiek zijn. Van een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Het apparaat is bedoeld voor toepassing in de elektromagnetische omgeving die als volgt is gespecificeerd.
De klant of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

IMMUNITEIT test	IEC 60601-test niveau	Naleving niveau	Elektromagnetische omgeving begeleiding
Geleid RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz 6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz	3V	Draagbare en mobiele RF-communicatie Apparatuur mag niet dicht bij een onderdeel van het apparaat, inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend op basis van de frequentievergelijking van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz 80 % AM bij 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz tot } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz tot } 2,7 \text{ GHz}$ <p>waarbij P het maximale uitgangsvermogen is van de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender en d is de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch locatieonderzoek.3 moeten lager zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik. In de buurt van apparatuur met het volgende symbool kan storing optreden:</p>  <p>De ENCLOSURE PORT van ME UITRUSTING en ME SYSTEMEN wordt getest zoals gespecificeerd in tabel 9 van IEC 60601-1-2 volgens de testmethoden die zijn gespecificeerd in IEC 61000-4-3.</p>

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de apparaten.

Ultrasonische chirurgische apparatuur is gericht op toepassing in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De klant of gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat, zoals hieronder wordt aanbevolen. overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal uitgangsvermogen van zender (w)	Scheidingsafstand volgens frequentie van zender /m		
	150 kHz tot 80 MHz	80 MHz tot 800 MHz	800 MHz tot 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

OPMERKING: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

Technische voorwaarden


Componenten die nodig zijn voor de werking van het systeem: Elektrochirurgisch Instrument, Omvormer, Elektrochirurgische voetschakelaar, Ultrasonische Schaaf of Handstukken voor elektrochirurgie Bipolaire Connector Bipolair Instrument.

Raadpleeg de productbeschrijving voor dit onderdeel.

Beschermingsgraad tegen elektrische schokken	Ultrageluid:  Type CF Toegepast onderdeel; Bipolair elektrochirurgisch  Defibrillatiebestendig Type CF Toegepast onderdeel
Beschermingsgraad tegen elektrische schokken	Klasse I
Generator voor schadelijke infusen	Normale uitrusting
Beschermingsgraad tegen schadelijk binnendringend water	Voetschakelaar: IP68
Categorie Beheer	Klasse IIb
Parametereisen ultrasonische modus:	
Ingangsvermogen	Voedingsspanning: 100-240V Voedingsfrequentie: 50Hz/60Hz Ingangsvermogen: 400VA
Parametereisen ultrasonische modus:	
Opwekkingsfrequentie	54 kHz - 57 kHz
Primaire trillingsexkursie van de tip	25 µm ~ 110 µm
Ultrasonische Schaaf punt akoestisch hoofddoppervlak Product:	1,53-2,75 mm2
Secundaire crosslink akoestisch bij Ultrasonische Schaaf tip Uitvoergebied:	19,32~35,88 mm2
Afgeleid uitgangsgeluid bij Ultrasonische Schaaf bij referentiepoint Primaire amplitude Vermogen	< 30W
Type frequentieregeling van het systeem	Onafhankelijk van de belasting wordt de bekrachtigingsfrequentie automatisch en continu aangepast.
Gangreserve-index	Niet minder dan 2,5
Eisen voor elektrochirurgische parameters:	
Werkfrequentie	400 kHz ± 5%
Maximale uitgangsspanning	≤ 250V
Geavanceerde bipolaire modus Maximale uitgangsstroom	≤ 5.5A
Basis bipolaire modus Maximale uitgangsstroom	≤ 2.2A
Maximale piek-top uitgangsspanning	≤ 500Vpk
Piekfactor	1.6 ± 0.4
Nominaal vermogen	Radiofrequentie geavanceerd bipolair: 270 W Radiofrequentie Basis bipolair: 95W
Nominale belasting	Geavanceerde bipolaire radiofrequentie: 30Ω Radiofrequentie Basis bipolair: 200Ω
Omstandigheden bedrijfsomgeving	Temperatuur: 10 °C tot 30 °C
	Relatieve vochtigheid: ≤ 70%
	Luchtdrukgebied: 800 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	Temperatuur: -30 °C tot + 55 °C (generator, voetschakelaar, adapter)
	Temperatuur: -10 °C tot + 55 °C (Ultrasonische Schaaf)
	Vochtigheid: ≤ 80%
Productiedatum	Luchtdrukgebied: 800 hPa tot 1060 hPa
	De productiedatum kan worden bepaald aan de hand van het serienummer op het achterpaneel van de generator.
Netsnoer	Voldoen aan CCC-certificatievereisten Stroomsterkte: 10A
Persistentie	Bepaald door het handstuk van de omvormer en de gebruikte Ultrasonische Schaaf. Raadpleeg voor informatie over persistentie de toepasselijke Ultrasonische Schaaf en Instructies voor het handstuk van de Omvormer of Hoofdstuk 7 - Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
Zekering	5 * 20 T8AH250V
Gewicht (zonder verpakking)	Generator: nominaal 8 kg
Totaal volume	OP9 Generator: (lengte * breedte * hoogte): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispositie	Sommige interne onderdelen van de generator, de voetschakelaar en de voetschakelaarkabel bevatten lood. Volgens plaatselijke Eisen en voorschriften voor verwijdering. Gooi batterijen weg volgens de juiste afvalverwijderingspraktijken.
AP/APG-classificatie	Geen AP/APG-apparatuur.
Levensduur:	Levensduur: 7 jaar
Levens softwareversie	V01.01

Bipolaire uitgangsgolfvorm

Geavanceerde bipolaire uitgangsvermogen-belastingskromme

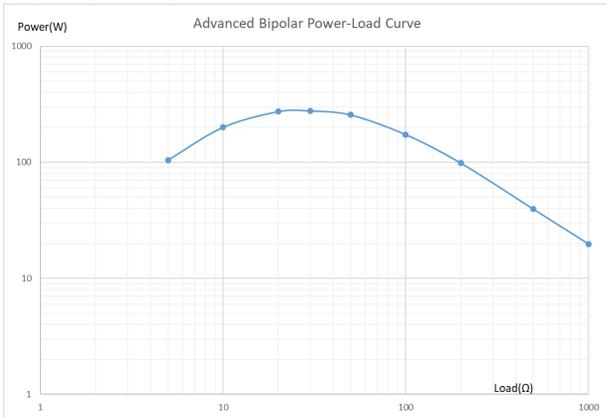


POWER CURVE LIMIT Max. uitgangsvermogen: 270[W]

Belasting (Ω)	Ondergrens	Nominaal	Bovengrens
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Nominale vermogenscurve van 270 watt uitgangsvermogen bij nominale belasting in overeenstemming met de stroom-/spanningslimiet van de vermogenscurve meter. De vermogenscurve vertegenwoordigt de omhullende die varieert onder bedrijfsomstandigheden.


Basiscurve bipolaire uitvoer volvermogen-belasting

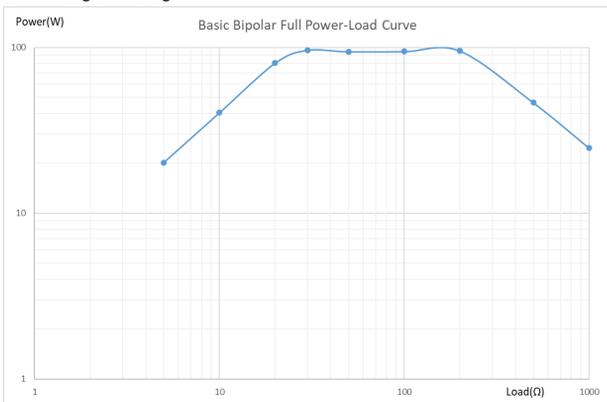

Limiet volledige vermogenscurve [W]: Max. vermogen 95 watt

Belasting (Ω)	Ondergrens	Nominaal	Bovengrens
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Basis bipolaire uitgangscurve half vermogen-belasting

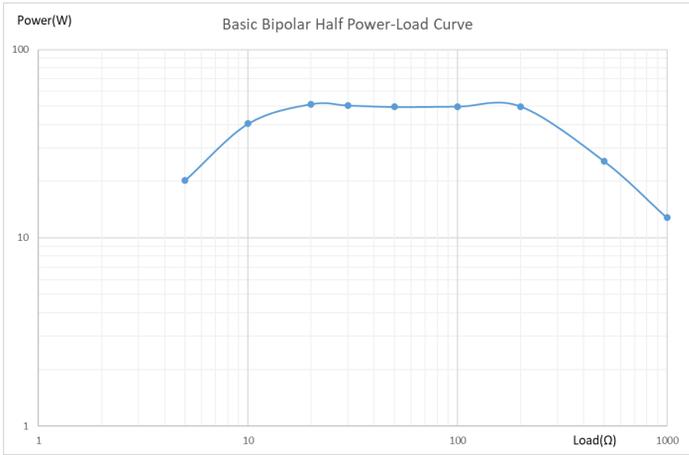

Limiet halve vermogenscurve [W]: Max. vermogen 50 watt

Belasting (Ω)	Ondergrens	Nominaal	Bovengrens
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Uitgangsvermogen vs. vermogensinstellingen voor vermogen in normaal bipolair

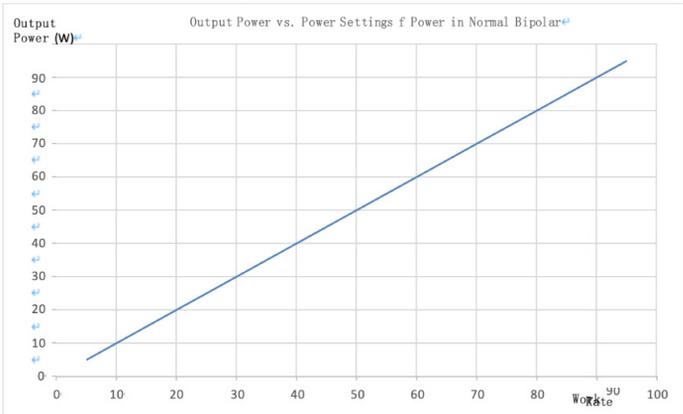

Uitgangsvermogen vs. ingestelde waarde voor normaal bipolair vermogen [W]; belasting: 200Ω

Ingesteld vermogen (W)	Uitgangsvermogen ondergrens (W)	Nominaal vermogen (W)	Bovenste grens uitgangsvermogen (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Service en garantie

Reach Surgical, Inc. garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en preventief onderhoud gedurende de hieronder vermelde garantieperiode. De verplichting van Reach Surgical onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen, naar eigen keuze, van elk defect product of onderdeel dat is geretourneerd aan Reach Surgical, Inc. of zijn geautoriseerde distributeur binnen de toepasselijke garantieperiode en naar tevredenheid van Reach Surgical defect is bevonden. Deze garantie geldt niet voor producten of onderdelen die:

- Nadelig beïnvloed door gebruik met niet-geautoriseerde apparaten die zijn vervaardigd of gedistribueerd door partijen die niet zijn geautoriseerd door Reach Surgical, Inc.
- Gerepareerd of gewijzigd buiten de fabriek van Reach Surgical, als dit van invloed is op de stabiliteit of betrouwbaarheid van het apparaat zoals bepaald door Reach Surgical.
- Onderhevig aan onjuist gebruik, nalatigheid of ongelukken.
- Gebruikt op een manier die niet overeenkomt met het ontwerp, de gebruiksparameters, instructies en richtlijnen voor het product of met door de industrie geaccepteerde functionele, operationele of milieunormen voor soortgelijke producten.

Garantieperiodes

Basis bipolaire energieconnector (OP-BPC): 1 jaar voor onderdelen en arbeid.

Generator (OP9): 1 jaar voor onderdelen en arbeid.

Voetschakelaar/voedingskabel: 1 jaar voor onderdelen en arbeidsloon.

Deze garantie is het exclusieve rechtsmiddel voor de oorspronkelijke koper en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reach Surgical, Inc. is niet aansprakelijk voor speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief schade als gevolg van verlies van gebruik, winst, zaken of goodwill, tenzij uitdrukkelijk bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Reach Surgical, Inc. machtigt niemand tot het aanvaarden van enige aanvullende aansprakelijkheid in verband met de verkoop of het gebruik van zijn producten. Er zijn geen garanties die verder gaan dan de hierin vermelde voorwaarden.

Reach Surgical, Inc. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn producten zonder de verplichting op zich te nemen om deze wijzigingen met terugwerkende kracht toe te passen op eerder verkochte of gebouwde producten.

Przegląd

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Zawierają one ważne instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi, potencjalnych zagrożeń i możliwości uszkodzenia produktu lub osób. W przypadku jakiegokolwiek nienormalnej sytuacji należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami, aby zapobiec obrażeniu ciała lub uszkodzeniu sprzętu. Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować naruszeniem bezpieczeństwa, wydajności, gwarancji lub konserwacji, za co producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami obsługi Przetwornika i Nożyc ultradźwiękowych.

Niniejszy dokument ma na celu pomóc w korzystaniu z tego urządzenia. Nie stanowi on odniesienia do technik chirurgicznych.

Stosowane konwencje standardowe: Przestroga, OSTRZEŻENIE i Uwagi

Należy zwrócić uwagę na poniższe stwierdzenia, skategoryzowane jako PRZESTROGA, OSTRZEŻENIE lub UWAGA, które zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego i dokładnego wykonywania zadań. Stwierdzenia te można znaleźć w całej dokumentacji i należy je przeczytać przed przejściem do następnego kroku procedury.

OSTRZEŻENIE: To stwierdzenie zwraca uwagę na procedurę obsługi lub konserwacji, praktykę lub warunki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała lub utraty życia.

PRZESTROGA: To stwierdzenie ostrzega użytkownika o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia użytkownika lub pacjenta, a także uszkodzenie sprzętu lub innego mienia. Może również służyć jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi praktykami. Obejmuje to niezbędne środki ostrożności w celu bezpiecznego i skutecznego korzystania z urządzenia oraz ostrożność wymaganą w celu zapobiegania uszkodzeniom wynikającym z właściwego lub niewłaściwego użytkownika.

UWAGA: To stwierdzenie wskazuje praktykę operacyjną lub warunek, który jest niezbędny do skutecznego wykonania zadania.

Opis

Urządzenia elektrochirurgiczne ENER REACH (zwane dalej "urządzeniem") są używane w medycznych salach operacyjnych do zabiegów chirurgicznych cięcia, koagulacji tkanek ludzkich i podwiązywania naczyń. Posiada dwa oddzielne gniazda: jedno dla energii ultradźwiękowej, a drugie dla fali o częstotliwości radiowej.

W trybie częstotliwości radiowej Generator dostarcza różne schematy energii w zależności od podłączonego instrumentu/urządzenia elektrochirurgicznego. Po podłączeniu zaawansowanego instrumentu bipolarnego, Generator dostarcza fale RF do zamykania naczyń tętniczych i żylnych, limfatycznych i wiązek tkanek o średnicy do 7 mm. Gdy podłączony jest podstawowy instrument bipolarny, generowana jest energia o stałej mocy do cięcia i koagulacji tkanek miękkich.

W trybie wyjścia energii ultradźwiękowej, przy użyciu przetwornika TRA6 w połączeniu z Jednorazowymi nożycami ultradźwiękowymi CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, urządzenie tnie tkanki miękkie wymagające kontroli krwawienia i minimalnych uszkodzeń termicznych oraz zamyka naczynia o maksymalnej średnicy 5 mm. W połączeniu z Jednorazowymi nożycami ultradźwiękowymi SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 i SRE45 urządzenie tnie tkanki miękkie wymagające kontroli krwawienia i minimalnych uszkodzeń termicznych oraz zamyka naczynia o maksymalnej średnicy 7 mm.

Przeznaczenie

Urządzenie dostarcza energię o częstotliwości radiowej do napędzania końcówek elektrochirurgicznych, które są przeznaczone do cięcia i uszczelniania naczyń krwionośnych oraz do cięcia, chwytania i wycinania tkanek.

Ponadto Generator zapewnia moc ultradźwiękową do napędzania ultradźwiękowych instrumentów chirurgicznych, które są wskazane do nacięcia tkanek miękkich, gdy pożądana jest kontrola krwawienia i minimalne obrażenia termiczne.

Wskazania

Urządzenie zapewnia moc o częstotliwości radiowej do napędzania końcówek elektrochirurgicznych, które są używane podczas operacji otwartych lub laparoskopowych w chirurgii ogólnej, pediatrycznej, ginekologicznej, urologicznej i klatki piersiowej do cięcia i zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz do cięcia, chwytania i wycinania tkanek.

Ponadto, Generator zapewnia moc do napędzania ultradźwiękowych instrumentów chirurgicznych, które są wskazane do nacinania tkanek miękkich, gdy pożądana jest kontrola krwawienia i minimalne obrażenia termiczne. Ultradźwiękowe instrumenty chirurgiczne mogą być stosowane jako uzupełnienie lub substytut elektrochirurgii, laserów i stalowych skalpeli do cięcia i/lub koagulacji tkanek w otwartych operacjach lub operacjach laparoskopowych w chirurgii ogólnej, pediatrycznej, ginekologicznej, urologicznej, klatki piersiowej oraz uszczelniania i przecinania naczyń limfatycznych.

Zamierzony użytkownik

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia w zastosowaniach chirurgicznych.

Zamierzone środowisko użytkownika

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w szpitalu.

Docelowa populacja pacjentów

To urządzenie jest odpowiednie dla pacjentów w wieku 3 lat i starszych, którzy wymagają zabiegów chirurgicznych obejmujących nacięcia tkanek miękkich z kontrolą krwawienia i minimalnym urazem termicznym.


Korzyści kliniczne

Urządzenie może być bezpiecznie i skutecznie stosowane do podwiązywania i dzielenia naczyń, wiązek tkankowych i limfatycznych.

Przeciwwskazania

Urządzenie jest przeciwwskazane w przypadku nacięcia kości, antykoncepcyjnej okluzji jajowodów i zabiegów koagulacji. Nie jest również przeznaczone do stosowania w neurochirurgii.

Skład systemu

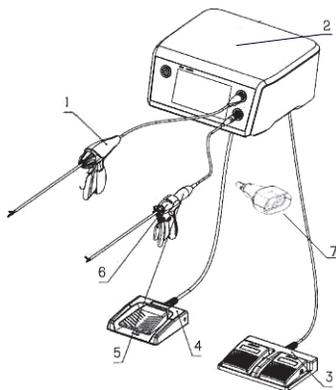

[01] Rękojeści elektrochirurgiczne	[02] Generator OP9
[03] Ultradźwiękowy przełącznik nożny	[04] Elektrochirurgiczny przełącznik nożny
[05] Przetwornik	[06] Nożyce ultradźwiękowe
[07] Złącze bipolarne do elektrochirurgii	

[01] Rękojeść elektrochirurgiczna

Rękojeść elektrochirurgiczna, podłączona do Generатора, jest obsługiwana przez chirurga podczas zabiegu. Stosuje ona energię elektrochirurgiczną RF do tkanki pomiędzy jej Szczękami w celu koagulacji lub uszczelnienia. Instrument zawiera również ostrze do podziału tkanki. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach.

[02] Generator OP9

Generator dostarcza zarówno energię elektrochirurgiczną, jak i energię do terapii ultradźwiękowej poprzez oddzielne porty przyłączeniowe instrumentów. Składa się z obudowy, obudowy, płyty elektronicznej, ekranu dotykowego LCD, wyłącznika zasilania i interfejsów do podłączenia akcesoriów.

Model: OP9

[03] Ultradźwiękowy przełącznik nożny

Służy do sterowania włączaniem/wyłączaniem energii ultradźwiękowej za pomocą dwóch przełączników ("MIN" i "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrochirurgiczny przełącznik nożny

Służy do sterowania włączaniem/wyłączaniem energii o wysokiej częstotliwości za pomocą pojedynczego przełącznika.

Model: OP-FSS

Przetwornik [05]

Przetwornik przekształca energię elektryczną z kompatybilnego generатора w ruch mechaniczny ostrzy instrumentu. Jest to instrument wielokrotnego użytku o ograniczonej żywotności. Przetwornik nie jest sterylny i przed użyciem należy go wysterylizować zgodnie z instrukcjami. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika TRA6.

Model: TRA6.

[06] Nożyce ultradźwiękowe

Nożyce ultradźwiękowe wykorzystują ruch mechaniczny przetwornika i dostarczają energię ultradźwiękową do cięcia lub koagulacji tkanek. Należy zachować ostrożność, ponieważ wibracje mechaniczne nie są wykrywalne i mogą nieumyślnie wpłynąć na obszary niebędące celem. Nożyce ultradźwiękowe są sterylizowane tlenkiem etylenu. Jeśli okres przydatności do użycia zostanie przekroczony lub opakowanie sterylizacyjne zostanie uszkodzone, Nożyce ultradźwiękowe nie powinny być używane i powinny zostać zutylizowane. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji Nożyc ultradźwiękowych.

Następujące Nożyce ultradźwiękowe są kompatybilne z Generatorem OP9:

Seria PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Seria SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Seria SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Złącze bipolarne do elektrochirurgii

Służy do podłączania podstawowych bipolarnych urządzeń elektrochirurgicznych do Generatora w celu koagulacji tkanek.

Model: OP-BPC

Panel przedni Generatora

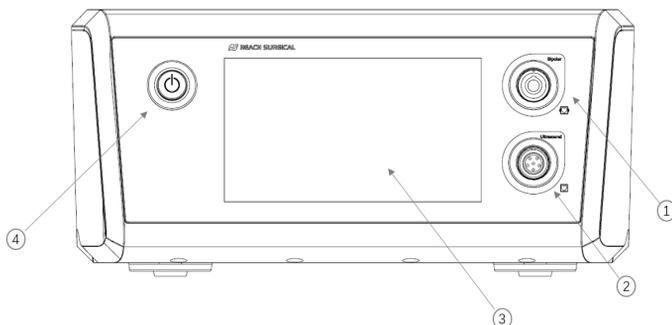

[01] Gniazdo elektrochirurgiczne

Służy do podłączania zaawansowanych bipolarnych urządzeń elektrochirurgicznych lub bipolarnego złącza elektrochirurgicznego.

[02] Gniazdo Przetwornika

Łączy Przetwornik z Generatorem.


[03] Ekran dotykowy LCD

Wyświetla informacje o systemie i służy jako interfejs do regulacji elementów sterujących i ustawień.

[04] Przycisk wyłącznika zasilania

Naciśnij, aby włączyć Generator; naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć.

Panel tylny Generatora

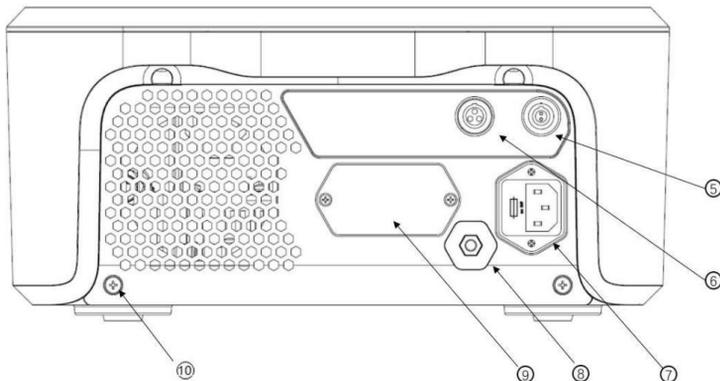

[05] Elektrochirurgiczne gniazdo przetwornika nożnego

Okrągłe gniazdo do podłączenia elektrochirurgicznego przetwornika nożnego.

[06] Gniazdo ultradźwiękowego przetwornika nożnego

Okrągłe gniazdo do podłączenia ultradźwiękowego przetwornika nożnego.

[07] Gniazdo zasilania

Podłącza przewód zasilający do Generatora.

[08] Port wyrównania potencjału

Jeśli uziemienie gniazda zasilania jest niepewne, port ten umożliwia podłączenie do chronionego uziemienia.

[09] Interfejs rozszerzeń

Służy do rozszerzania funkcji i konserwacji.

[10] Otwór montażowy

Instrukcja użytkownika

Należy zapoznać się z dostarczonymi wytycznymi dotyczącymi środowiska pracy.

Rozpakowywanie

Po otrzymaniu komponentów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń transportowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się z firmą Reach Surgical, Inc. lub lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania pomocy.

Elementy wchodzące w skład systemu (szczegółowe specyfikacje techniczne i kody produktów znajdują się w rozdziale "Warunki techniczne systemu"):

Model	Opis	Komponent
OP9	Generator	Generator, przewód zasilający, instrukcje
TRA6	Przetwornik	Przetwornik z kablem
OP-FSD	Przetwornik nożny ultradźwiękowy	/
OP-FSS	Przetwornik nożny dwubiegowy	/
OP-BPC	Podstawowe dwubiegowe złącze energetyczne	/

Środki ostrożności

- Podczas kontroli sprzętu należy trzymać dystalny koniec instrumentu z dala od innych urządzeń, obciążeń chirurgicznych, pacjenta lub innych przedmiotów, aby uniknąć obrażeń.
- Wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa w obecności oparów, zgodnie z procedurami i przepisami szpitalnymi.

Energia ultradźwiękowa z Nożcami ultradźwiękowymi serii PD

- Podłącz przetwornik, przetwornik nożny i Nożyce ultradźwiękowe serii PD do Generatora.
- Po przejściu testu przetwornika i Nożyce ultradźwiękowe, wyreguluj poziom mocy (1-5) za pomocą ikon +/- na ekranie LCD.
- Naciśnij przycisk "Min" na Nożycach ultradźwiękowych lub pedał Min na Przetworniku nożnym, aby aktywować energię ultradźwiękową na ustawionym poziomie mocy.
- Naciśnij przycisk "Max" na Nożycach ultradźwiękowych lub pedał Min na Przetworniku nożnym, aby dostarczyć maksymalny poziom energii.
- Zwolnij przycisk lub przetwornik nożny, aby zatrzymać produkcję energii.

Energia ultradźwiękowa z Nożcami ultradźwiękowymi serii SRB/SRE

- Po przejściu testu przetwornika i Nożyce ultradźwiękowe, wyreguluj poziom mocy (1-5) za pomocą ikon +/- na ekranie LCD.
- Naciśnij Przycisk wspomagania elektrycznego na urządzeniu lub przycisk Min na pedale nożnym, aby aktywować energię ultradźwiękową na ustawionym poziomie mocy.

- Naciśnij Przycisk wspomagania elektrycznego z trybem zaawansowanej hemostazy na urządzeniu, aby włączyć tryb zaawansowanej hemostazy.
- Zwolnij przycisk na Nożycach ultradźwiękowych lub przycisk na przetworniku nożnym, aby zatrzymać dostarczanie energii.

Urządzenia elektrochirurgiczne bipolarne z zaawansowanymi instrumentami bipolarnymi

- Wyświetlacz LCD pokazuje zaawansowaną ikonę dwubiegunową i ikonę regulowanego sterowania ręcznego.
- Pociągnij Dźwignię na urządzeniu lub naciśnij pedał nożny, aby aktywować częstotliwość radiową.
- Generator zatrzyma wytwarzanie energii po zakończeniu zamykania, co zostanie zasygnalizowane ikoną zakończenia na ekranie.
- Jeśli podwiązanie jest niekompletne, zostanie odtworzony dźwięk ostrzegawczy i wyświetlona zostanie ikona ostrzeżenia.

Elektrochirurgiczna energia bipolarna z bipolarnym urządzeniem elektrochirurgicznym

- Ekran LCD wyświetla wartość mocy, regulowane ikony i paski poziomu mocy.
- Ustawienia mocy wahają się od 1 do 95 watów, z regulowanymi przyrostami.
- Wybierz żądane ustawienie mocy wyjściowej: Niska (15 W), Średnia (30 W) lub Wysoka (60 W).
- Naciśnij przycisk na przetworniku ręcznym lub pedale nożnym, aby aktywować częstotliwość radiową.
- Zwolnij przycisk, aby wyłączyć wyjątkie energii.

Zalecenia dotyczące ustawień

Ustawienia efektu	Zakres ustawień mocy	Zastosowanie kliniczne	Zoptymalizowane urządzenie
Niski	1-15 watów	Takie jak nerwy/kregostup, dtonie i chirurgia twarzy	- Urządzenia o mniejszej powierzchni - Kleszcze mikrokońcówkowe (0,4 - 2,2 mm)
Średni	16-40 watów	Takie jak koagulacja w obrębie głowy/szyi, kregostupa i anatomii	- Urządzenia o średniej powierzchni - Kleszcze mikrokońcówkowe (1,0 - 2,2 mm) - Małe kleszcze laparoskopowe z płaską główką - Nożyczki bipolarne
Wysoki	45-95 watów (co 5 W)	Takie jak chirurgia głowy/szyi i chirurgia plastyczna (podobny do średniego efektu, ale z szybszym efektem).	- Urządzenia o dużej powierzchni - Duże kleszcze laparoskopowe z płaską główką

UWAGA: To urządzenie nie jest kompatybilne z elektrodą neutralną.

UWAGA: Nożyce ultradźwiękowe i elektryczny skalpel RF są częściami przeznaczonymi do kontaktu z pacjentem.


Korzystanie z Generators

Włącz urządzenie

- Po włączeniu system jest gotowy do pracy. Gdy Generator jest podłączony do zasilania sieciowego, a kontrolka przetwornika trybu gotowości świeci się, system jest gotowy do pracy.
- Po naciśnięciu przycisku czuwania wyświetlony zostanie następujący obraz:




- Jeśli do Generators nie jest podłączony żaden Przetwornik lub Nożyce ultradźwiękowe, lub jeśli są one podłączone nieprawidłowo, wyświetlony zostanie następujący obraz:

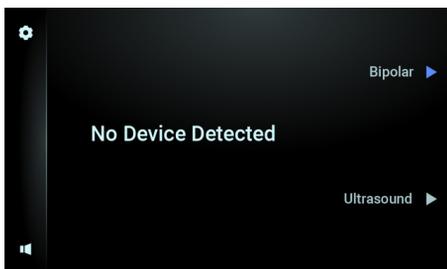

Korzystanie z przyrządu ultradźwiękowego (Przetwornik i Nożyce ultradźwiękowe)


Po wykryciu Przetwornika i Nożyc ultradźwiękowych wyświetlony zostanie następujący obraz.

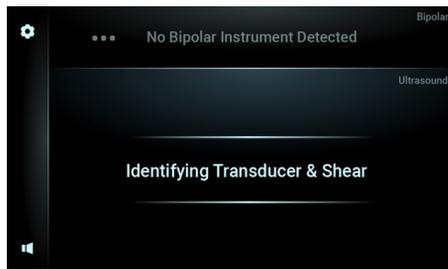


UWAGA: jeśli liczba pozostałych użyć Przetwornika jest mniejsza niż 10, wyświetlony zostanie następujący obraz. Należy zwrócić uwagę na liczbę pozostałych użyć, ponieważ Przetwornik musi zostać wymieniony, gdy liczba ta spadnie do zera.




Następnie zostanie wyświetlony następujący obraz, użytkownik zostanie poproszony o naciśnięcie dowolnego przycisku na Nożycach ultradźwiękowych, aby rozpocząć test Nożyc ultradźwiękowych z otwartymi szczękami.

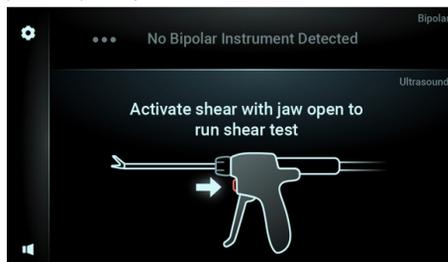


Po naciśnięciu dowolnego przycisku wyświetlony zostanie następujący obraz.

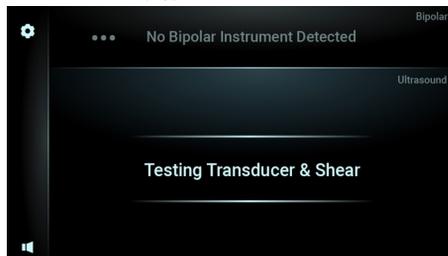


Jeśli test Przetwornika nie powiedzie się, wyświetlony zostanie następujący obraz:

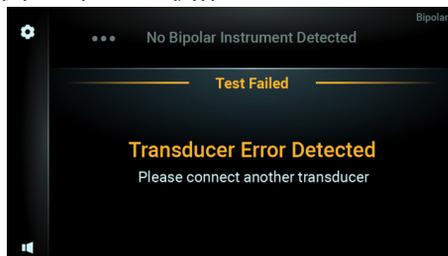


Gdy test Nożyce ultradźwiękowe zakończy się niepowodzeniem, wyświetlony zostanie następujący obraz

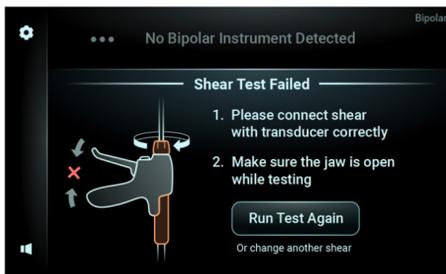

Po pozytywnym przejściu testu Przetwornika i Nożyc ultradźwiękowych wyświetlony zostanie następujący obraz:

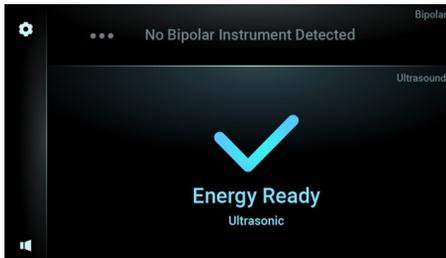

Poniższy ekran roboczy zostanie wyświetlony po podłączeniu Nożyc ultradźwiękowych bez funkcji zaawansowanej hemostazy.

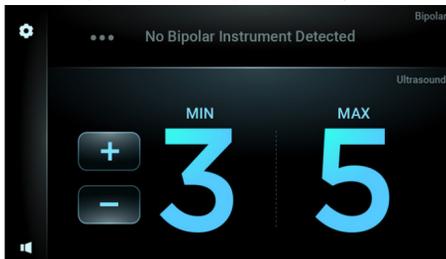


Poniższy ekran roboczy zostanie wyświetlony po podłączeniu Nożyc ultradźwiękowych SRE do urządzenia Advanced Hemostasis.




Tryb wyjścia zostanie podświetlony, gdy zostanie aktywowany.

Korzystanie z urządzeń elektrochirurgicznych


Po wykryciu Przetwornika i Nożyc ultradźwiękowych wyświetlony zostanie następujący obraz.

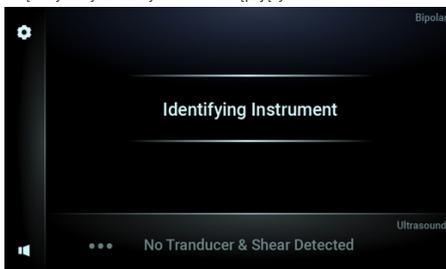

Gdy test urządzeń elektrochirurgicznych zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący obraz:



Poniższy ekran roboczy zostanie wyświetlony po podłączeniu do zaawansowanego urządzenia dwubiegunowego.

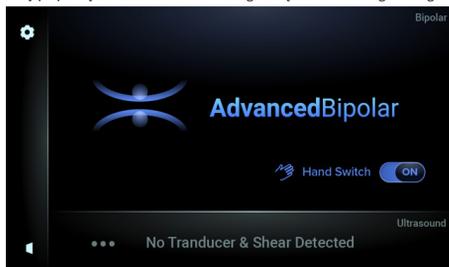


Poniższy ekran roboczy zostanie wyświetlony po podłączeniu do zwykłego urządzenia dwubiegunowego.




Korzystanie z urządzeń elektrochirurgicznych i nożyc ultradźwiękowych

Należy pamiętać, że gdy Generator jest podłączony zarówno do bipolarnego urządzenia elektrochirurgicznego, jak i Nożyc ultradźwiękowych, system działa w trybie podzielonego ekranu w celu wyświetlenia bieżącego stanu. Urządzenie, któremu nadano priorytet, jako pierwsze aktywuje energię. Ten stan podzielonego ekranu pokazano poniżej:

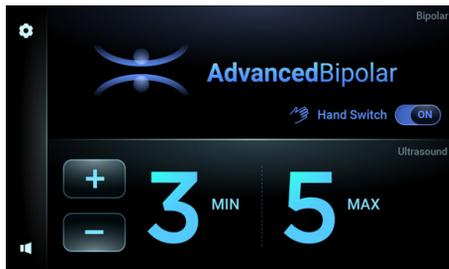

Ustawienia systemowe


Aby uzyskać dostęp do ustawień systemu, kliknij ikonę ustawień znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu. Dostępne są następujące opcje ustawień systemowych:

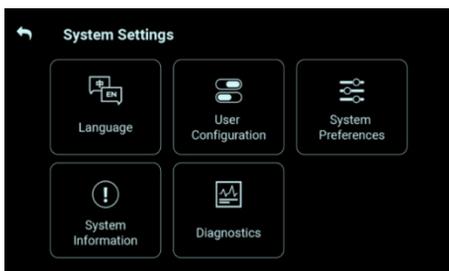


Język: Kliknięcie pozycji Język spowoduje wyświetlenie ekranu wyboru języka:




Konfiguracja użytkownika: Kliknięcie pozycji Konfiguracja użytkownika spowoduje wyświetlenie ekranu konfiguracji użytkownika:




Preferencje systemowe: Kliknięcie pozycji Preferencje systemowe spowoduje wyświetlenie ekranu preferencji systemowych:



Informacje o systemie: Delikatnie kliknij pozycję Informacje o systemie, aby wyświetlić ekran informacji o systemie:



Diagnostyka: Kliknięcie pozycji Diagnostyka spowoduje wyświetlenie ekranu diagnostyki:



Aby wyjść z ustawień systemu i powrócić do trybu gotowości systemu, naciśnij ikonę "Return" znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu.

Wyłączanie systemu

Wykonaj poniższe kroki, aby bezpiecznie wyłączyć system:

Naciśnij przycisk trybu gotowości: Znajdź przycisk czuwania na Generatorze i naciśnij go, aby rozpocząć proces wyłączania.

Odłącz Przetwornik i Nożyce ultradźwiękowe: Ostrożnie odłącz przetwornik i nożyce ultradźwiękowe od systemu. Informacje na temat prawidłowego obchodzenia się z przetwornikiem i nożycami ultradźwiękowymi znajdują się w instrukcji obsługi.

Czyszczenie: Generator, Przełącznik nożny i Przetwornik należy czyścić zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale "Konserwacja".

Rozwiązywanie problemów

Generator zawiera różne sygnały ostrzegawcze i kody błędów, aby pomóc w identyfikacji i diagnozowaniu usterek komponentów. Należy zauważyć, że te sygnały i kody zostały zaprojektowane w celu wsparcia oceny klinicznej i obserwacji, a nie ich zastąpienia.

Alarm dźwiękowy

Status pracy	Typ dźwięku	Możliwa przyczyna i działanie
Status samokontroli	Normalny dźwięk	/
	Nieprawidłowy dźwięk	Wykryto usterkę sprzętową. Prosimy o kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy w naprawie.
Korzystanie z urządzenia ultradźwiękowego	Maksymalny poziom dźwięku	/
	Min. poziom dźwięku	/
	Nieprawidłowy dźwięk	Nożyce ultradźwiękowe weszły w kontakt z nadmierną ilością tkanki. Zmniejszyć kontakt tkanki z nożycami ultradźwiękowymi. Jeśli ciągły dźwięk utrzymuje się, ostrożnie usunąć tkankę, która może gromadzić się wokół końcówki nożyc ultradźwiękowych. Wykryto błąd Przetwornika i/lub Nożyc ultradźwiękowych. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z producentem lub działem pomocy technicznej.
	Dźwięk ZAAWANSOWANY	/
	Dźwięk ITS	/
Aktywacja urządzeń elektrochirurgicznych	Zaawansowany dwubiegunowy sygnał ostrzegawczy	/
	Normalny dźwięk dwubiegunowy	/
	Nieprawidłowy dźwięk	Nieudane cięcie: Jeśli tkanka, z którą styka się instrument, nie spełnia wymogów cięcia, należy zmniejszyć ilość tkanki stykającej się z instrumentem. Jeśli sygnał błędu utrzymuje się, należy ostrożnie usunąć tkankę, która może gromadzić się na końcu instrumentu. Awaria sprzętu: Ten błąd wskazuje na potencjalną awarię obwodu lub złącza. W przypadku jakiegokolwiek usterek lub błędów zaleca się skonsultowanie się z producentem lub zwrócenie się o pomoc w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i rozwiązania.


Kody błędów

Generator Platformy Energetycznej jest wyposażony w kompleksowy system identyfikacji usterek, na który składają się alerty i błędy systemowe. W przypadku wykrycia usterek, Generator emituje sygnał ostrzegawczy, wyświetla sygnał ostrzegawczy na panelu sterowania i pokazuje odpowiedni kod usterek na ekranie LCD. Wykonaj kroki opisane poniżej, aby rozwiązać problem:

Tabela kodów błędów

Kod błędu	Odpowiedni komunikat o błędzie
Ostrzeżenie	Należy prawidłowo podłączyć Nożyce ultradźwiękowe z Przetwornikiem.
Ostrzeżenie	Upewnij się, że Szczęki są otwarte podczas testowania.
Ostrzeżenie	Wykryto błąd Nożyce ultradźwiękowe
Ostrzeżenie	Pozostały czas Przetwornika wynosi zero
Ostrzeżenie	Aktywuj tylko jeden przycisk na raz
Ostrzeżenie	Należy zmniejszyć siłę przyłożoną do Nożyc ultradźwiękowych.
Ostrzeżenie	Przycisk Nożyce ultradźwiękowe i przełącznik nożny nie mogą być zamknięte jednocześnie.
Ostrzeżenie	Przycisk zablokowany, sprawdź i kontynuuj
Ostrzeżenie	Wyreguluj Szczęki lub zaciśnij mniej tkanki
Ostrzeżenie	Usuń urządzenie z tkanki
Błąd systemu	Błąd systemu
Błąd systemu	Autokontrola nie powiodła się

Jeśli podczas testowania na ekranie pojawi się błąd, należy wykonać następujące czynności:



- Upewnij się, że kabel Przetwornika jest całkowicie włożony we właściwym kierunku.
- Sprawdź, czy nożyce ultradźwiękowe zostały prawidłowo dokręcone lub czy wokół ich końca nie nagromadziła się tkanka. Wyregulować szczelność nożyc ultradźwiękowych i ostrożnie usunąć wszelkie tkanki nagromadzone wokół obudowy nożyc ultradźwiękowych. (Jeśli test jest inicjowany przed operacją, upewnij się, że Nożyce ultradźwiękowe są skierowane w stronę powietrza. Jeśli używane są Nożyce ultradźwiękowe, upewnij się, że szczelka zaciskowa jest otwarta i nie styka się z żadnymi przedmiotami).

- Jeśli problem nie ustąpi, należy rozważyć wymianę Przetwornika lub Nożyc ultradźwiękowych.
- Przejdź do trybu pracy urządzenia.

UWAGA: Przetwornik może nie działać prawidłowo, jeśli jego temperatura przekroczy określony limit. W takich przypadkach należy natychmiast użyć innego Przetwornika w celu przywrócenia działania lub wykonać poniższe czynności w celu ustalenia przyczyny błędów i zbadania opcjonalnych metod przywrócenia działania:

- Przetwornik powinien ostygnąć w temperaturze pokojowej przez co najmniej 45 minut. Ta metoda chłodzenia ma również zastosowanie, jeśli Przetwornik nagrzeje się po dłuższej pracy z dużą mocą.
- Jeśli przegrzanie Przetwornika nie jest widoczne i problem pozostaje nierozwiązany, należy skontaktować się z przedstawicielami producenta ds. konserwacji w celu uzyskania pomocy.
- Poza bezpiecznikami w Generatorze nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W przypadku konieczności wymiany lub serwisowania należy skontaktować się z personelem serwisowym przeszkolonym i autoryzowanym przez Reach Surgical, Inc. lub lokalnym przedstawicielem.

Konserwacja i modernizacja Generatora powinny być wykonywane wyłącznie przez personel serwisowy przeszkolony i autoryzowany przez Reach Surgical. Należy rozważyć środki ostrożności w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom. Następujące incydenty stwarzają ryzyko dla cyberbezpieczeństwa:

- Nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek produktów niezwiązanych z urządzeniem.
- Jakakolwiek nieautoryzowana komunikacja sieciowa z urządzeniem.
- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania, które nie zostały autoryzowane przez Reach Surgical.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych incydentów prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Reach Surgical, Inc. lub bezpośrednio z Reach Surgical, Inc. pod adresem Reachquality@reachsurgical.com.

Konserwacja

Czyszczenie i dezynfekcja Generatora i Złącza Basic Bipolar Energy

Czyszczenie

Ekran LCD Generatora i podstawowe złącze dwubiegunowe należy czyścić zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi w szpitalu. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że główne zasilanie Generatora jest odłączone, a przewód zasilający jest odłączony od jednostki wyjściowej.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia Generatora, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy dokładnie przestrzegać procedur czyszczenia. Nie wolno rozlewać ani rozpryskiwać płynów na Generator ani zanurzać go w płynach.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami czyszczenia:

- Przygotować detergent o neutralnym pH lub detergent enzymatyczny o neutralnym pH zgodnie z zaleceniami producenta detergentu.
- Używając czystej, miękkiej ściereczki nasączonej niewielką ilością roztworu czyszczącego, ręcznie przetrzyj wszystkie powierzchnie, w tym ekran Generatora.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie czystą, miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą z kranu.
- Na koniec wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą, miękką szmatką, aby upewnić się, że są suche.

Dezynfekcja

• Jeśli Generator zostanie zanieczyszczony krwią lub płynami ustrojowymi, należy go zdezynfekować przed ponownym użyciem. Następujące chemiczne środki dezynfekujące zostały zatwierdzone do użytku z generatorem: 70% alkohol izopropylowy, 6% podchloryn sodu, 10% nadtlenek wodoru.

• Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, stężenia i czasu kontaktu środków dezynfekujących.

• Upewnij się, że dezynfekatory są skonfigurowane i używane zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie przętącznika nożnego

Przetącznik nożny i kabel należy czyścić po każdym użyciu, stosując poniższą procedurę:

- Odczłuzić Przetącznik nożny od Generatora.
- Przygotuj detergent enzymatyczny o neutralnym pH zgodnie z instrukcjami producenta.
- Połącz kabel bezpiecznie z Przetącznikiem nożnym i zanurz je w roztworze czyszczącym na 2 minuty.

UWAGA: Upewnij się, że kabel Przetącznika nożnego używany do podłączenia Generatora jest całkowicie suchy, aby zapobiec przypadkowej aktywacji.

• Po zanurzeniu w roztworze czyszczącym należy ręcznie wyszorować przetącznik nożny i kabel szcztoką z miękkim włosiem.

• Dokładnie płuć Przetącznik nożny i kabel ciepłą wodą z kranu przez co najmniej 1 minutę.

PRZESTROGA: Podczas płukania kabel i Przetącznik nożny powinny być bezpiecznie podłączone.

• Przetrzyj wszystkie powierzchnie czystą, miękką ściereczką.

OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia przetącznika nożnego nie należy używać myjki ultradźwiękowej.

OSTRZEŻENIE: Nie należy włączać zasilania Generatora przed podłączeniem kabla zasilania AC. Przed montażem należy upewnić się, że wszystkie połączenia są suche.

Czyszczenie i dezynfekcja przetwornika

Przetworniki są dostarczane w stanie niesterylnym i wymagają dokładnego czyszczenia i sterylizacji przed każdym użyciem.

Czyszczenie:

Dokładnie wyczyść przetworniki zgodnie z poniższymi krokami:

- Optukaj przetwornik stroną ze śrubą do góry i wyczyść szcztoką z miękkim włosiem w wodzie oczyszczonej, aż na powierzchni nie będzie żadnych smug;

- Przetwornik może być moczony w neutralnym pH detergentu enzymatycznym (Główne składniki: proteaza lipaza amylaza celulaza pektynaza i inne biologiczne enzymy, przyjazny dla środowiska środek powierzchniowo czynny, czynnik zapobiegający rdzy i stabilizator) przez okres do 10 minut i w odpowiedniej temperaturze 15°C-65°C. Stosunek detergentu i wody oczyszczonej wynosi 1 : 400;
- Przepłukać przetwornik stroną ze śrubą do góry wodą oczyszczoną przez 2 minuty;
- Wyczyścić śrubę łączącą, powierzchnię montażową skalpela i łącze za pomocą chusteczki z alkoholem.
- Zanurzyć przetwornik w 75% alkoholu medycznym, przytrzymać i potrząsać nim około 30 razy;
- Przepłukać przetwornik stroną ze śrubą do góry wodą oczyszczoną przez 2 minuty.

Uwaga: W przypadku przetwornika nie zaleca się stosowania myjek ultradźwiękowych.

Suszenie:

Temperatura suszenia: 50-70°C, Czas suszenia: 30 min.

Sterylizacja przetworników:

Po wykonaniu powyższych czynności związanych z czyszczeniem i suszeniem, przetwornik należy wysterylizować za pomocą jednej z metod wymienionych poniżej.

Sterylizacja parowa (121°C)

- Zażyczyć osłonę przed sterylizacją. Podczas sterylizacji przetwornik powinien być owinięty. Umieścić przetworniki w naczyniu do sterylizacji parowej w wysokiej temperaturze 121°C i czasie 30 minut.
- Temperatura suszenia: 50-70°C, Czas suszenia: 30min.

Sterylizacja parowa (134°C)

- Zażyczyć osłonę przed sterylizacją. Podczas sterylizacji przetwornik powinien być owinięty. Umieścić przetworniki w naczyniu do sterylizacji parowej w wysokiej temperaturze 134°C i czasie 10 minut.
- Temperatura suszenia: 50-70°C, Czas suszenia: 30min.

Testy bezpieczeństwa i funkcjonalne

Należy zapewnić przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych Przetwornika, Generatora i Przetącznika nożnego zgodnie z procedurami i przepisami szpitalnymi. Testy bezpieczeństwa i działania innych komponentów używanych przez wielu pacjentów można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych komponentów.

Test bezpieczeństwa

Generator: Certyfikowani technicy szpitalni powinni przeprowadzić test prądu upływowego.

Przetącznik nożny: Sprawdzić pedał, łącze kabla i kabel pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Wymień wszystkie uszkodzone elementy.

Inne podzespoły: Sprawdzić wszystkie pozostałe komponenty zgodnie z ich instrukcjami obsługi.

Test funkcjonalny

Tryb ultradźwiękowy

- Przygotować kompletny zestaw Nożyc ultradźwiękowych PD i podłączyć Przetwornik zgodnie z instrukcjami podanymi w Rozdziale II - Instalacja i obsługa sprzętu.
- Sprawdzić, czy możliwe jest przejście do stanu roboczego. Różne Nożyce ultradźwiękowe mogą mieć różne interfejsy wejściowe. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części 1, sekcja 3 rozdziału 2.
- Potwierdzić wyświetlenie mocy MIN na poziomie 3 i mocy MAX na poziomie 5.
- Naciśnij przyciski zwiększania i zmniejszania mocy, aby zapewnić możliwość regulacji poziomu mocy MIN w zakresie od 1 do 5.
- Włącz zasilanie Generatora i przetącz go w tryb pracy ultradźwiękowej. Sprawdź poprawność podłączenia Przetwornika i Nożyc ultradźwiękowych.
- Przy otwartej szczęce naciśnij przycisk "MAX" na przetączniku nożnym. Na ekranie LCD powinien zostać wyświetlony poziom mocy MAX "5" i powinien zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy.
- Przy otwartej szczęce naciśnij przycisk "MIN" na przetączniku nożnym. Na ekranie LCD powinien zostać wyświetlony poziom mocy MIN i powinien zostać wyemitowany sygnał dźwiękowy.

OSTRZEŻENIE: Przed aktywacją systemu należy upewnić się, że Szczęka znajduje się z dala od tkanek, innych instrumentów lub jakichkolwiek innych przedmiotów, aby zapobiec obrażeniu użytkownika.

Tryb elektrochirurgii bipolarnej

- Podłączyć zaawansowany bipolarny instrument elektrochirurgiczny/podstawowy instrument bipolarny zgodnie z instrukcjami.
- Sprawdzić, czy system może wejść do interfejsu roboczego. Podstawowy tryb dwubiegunowy powinien wyświetlać ikonę 30 poziomów mocy, podczas gdy zaawansowany tryb dwubiegunowy powinien wyświetlać ikonę "zaawansowany dwubiegunowy".
- Lekko dotknij przycisków zwiększania i zmniejszania mocy w podstawowym trybie dwubiegunowym, aby potwierdzić, że poziom mocy można regulować w zakresie od 1 do 95. Dotknij pasków Niski, Średni i Wysoki, aby przetaczać bezpośrednio między 15, 30 i 60.
- Wyłącz zasilanie Generatora i odczekaj 5 sekund. Następnie włącz zasilanie Generatora i odczekaj 10 sekund. Zażyczyć, czy podstawowy tryb dwubiegunowy wyświetla interfejs 30 poziomów mocy, a zaawansowany tryb dwubiegunowy wyświetla interfejs "zaawansowany dwubiegunowy". Sprawdzić, czy Generator jest aktywowany zgodnie z wcześniej określonymi wymaganiami.
- Podłączyć zaawansowane i podstawowe bipolarne urządzenia elektrochirurgiczne i naciśnij pojedynczy przetącznik nożny. Sprawdź migające wskazania poziomu mocy na panelu sterowania i postuchaj dźwięku aktywacji.

OSTRZEŻENIE: Przed aktywacją systemu surowo zabrania się dopuszczania do jakiegokolwiek kontaktu Nożyc ultradźwiękowych z tkankami, innymi instrumentami lub innymi przedmiotami, aby zapobiec obrażeniu użytkownika.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Związane z systemem

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami i postępować zgodnie z wytycznymi szpitalnymi dotyczącymi praktyki klinicznej w zakresie chirurgii ultradźwiękowej, elektrochirurgii, ginekologii i laparoskopii.
- Minimalnie inwazyjne urządzenia mogą różnić się w zależności od producenta. Jeśli instrumenty i akcesoria do zabiegów minimalnie inwazyjnych różnorodność są używane w tym samym czasie, przed zabiegiem należy sprawdzić kompatybilność instrumentów i akcesoriów oraz sprawdzić, czy akcesoria wprowadzane do ciała ludzkiego nie mają szorstkiej powierzchni, ostrych krawędzi lub występów, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłączone przez przeszkolonych i licencjonowanych chirurgów. Nie należy korzystać z urządzeń elektrochirurgicznych, jeśli nie zostało się odpowiednio przeszkolonym w zakresie ich obsługi w odniesieniu do konkretnego zabiegu, który trzeba będzie wykonać. Nieprzeszkolone użycie tego urządzenia może spowodować niezamierzone poważne obrażenia u pacjenta, w tym perforację jelita oraz nieprzymkniętą i nieodwracalną martwicę tkanek.
- Nie należy otwierać obudowy Generatora bez zezwolenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Wszelkie naprawy i modernizacje urządzenia powinny być wykonywane przez osobę przeszkoloną i autoryzowaną przez firmę Reach Surgical, Inc. Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż chirurgia medyczna.
- Dokładne zrozumienie zasad i technik związanych z procedurami laserowymi, elektrochirurgicznymi i ultradźwiękowymi jest niezbędne, aby zapobiec porażeniu prądem i poparzeniu zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego, a także uszkodzeniu tego urządzenia lub innych urządzeń medycznych.

Nie wolno naruszać izolacji elektrycznej ani uziemienia. Nie należy zanurzać urządzeń elektrochirurgicznych w płynach, chyba że wymaga tego ich konstrukcja i etykieta wskazuje, że powinny być zanurzone.

- Bezpieczna i skuteczna chirurgia ultradźwiękowa i elektrochirurgia zależą nie tylko od konstrukcji sprzętu, ale także w dużej mierze od wielu czynników kontrolowanych przez operatora. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność, należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcji obsługi dotychczasowego urządzenia.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich źródeł energii (elektrochirurgicznych, laserowych lub ultradźwiękowych), należy wziąć pod uwagę ryzyko rakotwórcze i zakaźne, jakie może stanowić wiele produktów ubocznych tkanek, takich jak dym i aerozole. Odpowiednie środki ostrożności, takie jak okulary ochronne, maski filtrujące i skuteczny sprzęt do usuwania dymu, powinny być przestrzegane zarówno podczas zabiegów otwartych, jak i endoskopowych.
- Po usunięciu urządzenia należy sprawdzić tkankę pod kątem hemostazy. W przypadku braku hemostazy należy zastosować odpowiednie metody w celu osiągnięcia hemostazy.
- Produkty wytwarzane lub dystrybuowane przez firmy nieautoryzowane przez Reach Surgical, Inc. mogą nie być kompatybilne z urządzeniem. Użycie takich produktów może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów i spowodować obrażenia użytkownika lub pacjenta.
- Aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń, urządzenie i obudowa powinny być podłączone do niezależnego obwodu zasilania.
- Urządzenie nie nadaje się do użyciu w obecności łatwopalnej mieszanki środka znieczulającego z powietrzem, tlenem lub podtleniem azotu. Możliwość iskrzenia w wyniku kolizji z innymi metalowymi urządzeniami. Iskry mogą spowodować zapłon łatwopalnych gazów, takich jak gazy polowe.
- Urządzenie musi działać w wymaganym zakresie temperatury otoczenia.
- Napięcie gniazda wyjściowego musi spełniać wymagania Generатора (Rozdział "Warunki techniczne systemu"). Nieprawidłowe podłączenie zasilania może spowodować uszkodzenie Generatora, porażenie prądem lub pożar.
- Nie używaj przedłużaczy, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie należy ustawiać sygnału aktywacji ani na niestylizany poziom. Dźwięki aktywacji mogą zostać zauważone przez personel zespołu chirurgicznego podczas dostarczania energii przez Generator.
- Wykazano, że dym generowany podczas elektrochirurgii może być potencjalnie szkodliwy dla pacjentów lub personelu zespołu chirurgicznego. Należy zaktualizować odpowiednią wentylację za pomocą odsysacza dymu chirurgicznego lub innych środków.
- Niektóre elementy ultradźwiękowego zintegrowanego generatora chirurgicznego są dostarczane w stanie niesterylnym (np. Przetwornik). Przed rozpoczęciem instalacji systemu należy wysterylizować produkt zgodnie z wymaganiami. Instrukcje dotyczące czyszczenia i sterylizacji można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
- Aby uniknąć obrażeń użytkowników lub pacjentów, Nożyce ultradźwiękowe muszą omijać inne urządzenia, serwety chirurgiczne, pacjentów lub inne obiekty przed naciśnięciem przycisku testowego i podczas sprawdzania systemu. Środki bezpieczeństwa w przypadku aerozolu (zgodnie z przepisami szpitalnymi) należy wdrożyć w metodzie kontroli i testowania systemu.
- Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na Szczękę, aby uniknąć zahamowania dostarczania energii ultradźwiękowej.
- Aby uniknąć obrażeń użytkownika, ostrze musi unikać kontaktu z tkanką, innymi urządzeniami lub innymi przedmiotami przed aktywacją systemu.
- Jeśli ciecz zostanie rozlana lub wylana na lub do Generatora, lub Generator zostanie rozlany lub wylany do cieczy, może to uszkodzić Generator i spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarem.
- Iskrzenie i ogrzewanie związane z technikami zamykania naczyń mogą służyć jako źródła zapłonu. Gaz i gąbka powinny pozostać wilgotne. Elektrody elektrochirurgiczne należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych i środowisk bogatych w tlen (O₂).
- W przypadku znacznego uszkodzenia Przetwornika lub jeśli jakiekolwiek części wykazują oznaki uszkodzenia po czyszczeniu i dezynfekcji, należy je wyrzucić. Uszkodzone części są wyraźnie oznaczone w celu uniknięcia ich niewłaściwego użycia przed dalszą obsługą.
- Odpady jednorazowego użytku i odpady elektroniczne muszą być utylizowane zgodnie z przepisami szpitalnymi i nie mogą być wyrzucane do śmieci w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.
- Należy unikać używania Generatora w pobliżu lub na innych urządzeniach. Jeśli konieczne jest użycie w pobliżu lub na innym sprzęcie, należy monitorować Generator i inny sprzęt w celu zapewnienia prawidłowego działania.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części wymagających serwisowania przez operatora. W celu wykonania czynności serwisowych należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Reach Surgical lub personelem serwisowym.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie urządzenia podłączone do systemu i połączenia. Należy sprawdzić, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do wydatków tłukowych, iskrzenia, nieprawidłowego działania urządzenia lub niezamierzonych wyników chirurgicznych.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie może być podłączone wyłączenie do źródła zasilania z uziemieniem ochronnym.
- Należy zachować jak największą odległość między Generatorem a innymi urządzeniami elektronicznymi (np. monitorami). Nie krzyżuj ani nie podłączaj przewodów elektrycznych do urządzeń elektronicznych. Generator może powodować zakłócenia pracy innych urządzeń elektronicznych.
- Systemu należy używać ostrożnie w obecności wewnętrznych i zewnętrznych rozruszników serca. Zakłócenia spowodowane użyciem urządzeń elektrochirurgicznych mogą spowodować przejście rozrusznika serca w stan asynchroniczny lub całkowicie uniemożliwić jego działanie. Jeśli urządzenia elektrochirurgiczne lub uszczelniające tanki są przeznaczone do stosowania u pacjentów z rozrusznikami serca, należy skontaktować się z producentem rozrusznika lub szpitalnym oddziałem kardiologicznym w celu uzyskania dodatkowych informacji.
- Należy zachować ostrożność podczas układania instrumentów na generatorze lub umieszczenia generatora na instrumentach elektrycznych. Taka konfiguracja jest niestabilna i nie zapewnia odpowiedniego chłodzenia.
- Awaria Generatora może spowodować przerwanie operacji. Dostępny powinien być system zapasowy.
- Jeśli wymagają tego lokalne przepisy, Generator powinien być podłączony do szpitalnego złącza ekwipotencjalnego za pomocą kabla ekwipotencjalnego.
- Gdy system i sprzęt do monitorowania fizjologicznego są używane jednocześnie u tego samego pacjenta, każda elektroda monitorująca powinna być umieszczona jak najdalej od przyrządu.
- W podstawowym trybie bipolarnym należy wybrać najniższą możliwą moc wyjściową dla uzyskania pożądanego efektu.
- Awaria sprzętu chirurgicznego wysokiej częstotliwości może spowodować nieoczekiwany wzrost mocy wyjściowej.
- Generator i podstawowe dwubiegunowe złacze elektrochirurgiczne mogą zostać zaatakowane przez wodę lub cząstki stałe. Podczas użytkowania i czyszczenia należy unikać wnikania wody lub cząstek stałych.
- Gdy system jest używany w połączeniu z endoskopem, może to zwiększyć prąd upływowy na ciele pacjenta. Należy zachować ostrożność podczas zabiegu.
- Zawiadomienie użytkownika i/lub pacjenta, że wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać firmie Reach Surgical, Inc. za pośrednictwem strony Reachquality@reachsurgical.com. oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Związane z instrumentem

Podczas zabiegów chirurgicznych należy pamiętać, że końcowa część Nożyca ultradźwiękowych, podkładka Nożyca ultradźwiękowych i trzon mogą mieć podwyższoną temperaturę, gdy ultradźwięki lub elektrokoagulacja bipolarna są stosowane do tanki przez dłuższy czas. Aby zapewnić bezpieczeństwo, ważne jest, aby uniknąć przypadkowego kontaktu tych elementów instrumentu z tkanką, serwetami chirurgicznymi, fartuchami chirurgicznymi lub innymi niepowiązanymi obiektami podczas całej procedury.

Ponadto należy zachować ostrożność podczas pozycjonowania instrumentu bipolarnego. W szczególności nie należy umieszczać go w pobliżu lub w kontakcie z materiałami łatwopalnymi, takimi jak gaz lub serwety chirurgiczne. Instrumenty bipolarne używane w tym kontekście mogą generować ciepło podczas użytkowania, co może potencjalnie prowadzić do zagrożenia pożarem. Gdy bipolarny generator elektrochirurgiczny nie jest używany, powinien być prawidłowo przechowywany w rękawie ochronnym lub w bezpiecznej odległości od pacjenta, członków zespołu chirurgicznego i wszelkich materiałów łatwopalnych.

UWAGA: Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności znajdują się w odpowiednich instrukcjach obsługi.

Informacje EMC

Produkt przeszedł test kompatybilności elektromagnetycznej, który spełnia wymagania normy IEC60601-1-2 dla sprzętu medycznego. Ograniczenia te zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w normalnych instalacjach medycznych.

Skład produktu

Numer seryjny	Nazwa części	Model/wersja nr.	Uwagi
1	Urządzenia elektrochirurgiczne	OP9	/
2	Przetwornik ultradźwiękowego sprzętu chirurgicznego	TRA6	Kompatybilne zastosowanie
3	Nożyce ultradźwiękowe do jednorazowego użytku Nożyce ultradźwiękowe	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatybilne zastosowanie
4	Jednorazowe ultradźwiękowe urządzenie chirurgiczne wysokiej częstotliwości Uszczelniacz do tkanek	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultradźwiękowy przełącznik nożny	OP-FSD	/
6	Elektrochirurgiczny przełącznik nożny	OP-FSS	/
7	Złącze bipolarnie do elektrochirurgii	OP-BPC	/

Kabel produktu

Numer seryjny	Nazwa kabla	Długość (m)	Ekranowany
1	Kabel sterowania nożnego	3	Tak
2	Przewód zasilający	5	Nie
3	Bipolarny kabel elektrochirurgiczny	3	Nie
4	Kabel Przetwornika	2.9	Tak

Wydajność EMC

To urządzenie może podlegać zakłóceniom o częstotliwości radiowej powodowanym przez inny sprzęt medyczny i komunikację radiową. Aby zapobiec takim zakłóceniom, niniejszy produkt został przetestowany zgodnie z normą IEC 60601-1-2 i spełnia jej wymagania. Firma Reach Surgical, Inc. nie gwarantuje jednak całkowitego braku zakłóceń w poszczególnych środowiskach instalacji.

Jeśli okaże się, że urządzenie jest zakłócone (co można stwierdzić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia), użytkownik (lub personel serwisowy zatwierdzony przez Reach Surgical, Inc.) powinien spróbować podjąć jeden lub więcej z poniższych środków w celu rozwiązania problemu zakłóceń: Dostosuj kierunek lub pozycję urządzenia, które na nią wpływa.

Zwiększenie odległości między tym urządzeniem a urządzeniem wysyłającym.

Do zasilania tego urządzenia należy używać innych źródeł zasilania (zamiast zasilania używanego do oddziaływania na urządzenie).

Skonsultuj się z dostawcą lub przedstawicielem serwisu w celu uzyskania innych sugestii.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane następującymi sytuacjami: używanie innych kabli połączeniowych niż zalecane; dokonywanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez zezwolenia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę skuteczności urządzenia.

Wszystkie rodzaje sprzętu elektronicznego mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne innych urządzeń poprzez powietrze lub inne podłączone do niego kable. W pobliżu tego urządzenia nie należy używać urządzeń, które mogą emitować sygnały radiowe, takich jak telefony komórkowe, nadajniki radiowe lub produkty do sterowania radiowego, ponieważ może to spowodować, że wydajność tego urządzenia nie będzie zgodna z określonymi specyfikacjami. Jeśli takie urządzenia znajdują się w pobliżu tego urządzenia, należy wydzielić ich zasilanie. Personel medyczny odpowiedzialny za to urządzenie powinien poinformować techników, pacjentów i inny personel, który może znajdować się w pobliżu tego urządzenia, aby w pełni przestrzegali powyższych wymagań.

Aby w pełni osiągnąć określone parametry EMC, użytkownik powinien prawidłowo zainstalować produkt zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną należy skontaktować się z personelem serwisowym zatwierdzonym przez Reach Surgical, Inc.

Przetwornik (z kablem) i Nożyce ultradźwiękowe są zdefiniowane jako zastosowana część całego systemu.

Środki ostrożności dotyczące instalacji produktu

Urządzenie może być używane w środowisku szpitalnym, ale nie obejmuje pomieszczeń ekranowania częstotliwości radiowej wokół aktywnego sprzętu chirurgicznego o częstotliwości radiowej lub tam, gdzie umieszczony jest sprzęt do rezonansu magnetycznego, ponieważ natężenie zakłóceń elektromagnetycznych w tych miejscach jest wysokie.

Odległość separacji i oddziaływanie stacjonarnych urządzeń radiokomunikacyjnych: natężenie pola magnetycznego generowanego przez stacjonarne nadajniki, takie jak stacje bazowe telefonów bezprzewodowych (komórkowych/bezprzewodowych), odbiorniki radiokomunikacji ruchomej lądowej, amatorskie odbiorniki radiowe, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne Generator itp. nie może być dokładnie zmierzone teoretycznie. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne generowane przez stacjonarne nadajniki RF, należy rozważyć pomiar pola elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona wartość natężenia pola magnetycznego w lokalizacji urządzenia przekracza odpowiedni poziom częstotliwości radiowej określony w "Oświadczeniu o przeciwdziałaniu zakłóceniom", urządzenie należy sprawdzić, aby upewnić się, że może działać normalnie. W przypadku stwierdzenia nienormalnych warunków pracy należy rozważyć przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji sprzętu, lub użycie pomieszczenia przeciwwzakłóceniewego.

- 1) Należy używać przewodu zasilającego dostarczonego lub wskazanego przez Reach Surgical, Inc. Produkty wyposażone we wtyczkę zasilania powinny być podłączone do stałego gniazda zasilania z uziemnieniem ochronnym. Do podłączenia wtyczki zasilania nie wolno używać żadnych adapterów ani złączy.
- 2) Urządzenie należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych.
- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie.

Uwagi ogólne

(1) Specyfikacja kabla.

Użycie kabli dostarczonych przez Reach Surgical, Inc. nie spowoduje pogorszenia parametrów EMC tego produktu. W przypadku użycia nieokreślonych kabli, wydajność EMC tego urządzenia może zostać znacznie zmniejszona.

(2) Środki ostrożności dotyczące nieautoryzowanych modyfikacji

Użytkownik nie powinien modyfikować tego produktu, w przeciwnym razie jego wydajność EMC może ulec pogorszeniu.

Modyfikacja produktu obejmuje następujące zmiany:

- a. Kabel (długość, materiał, okablowanie itp.).
- b. Instalacja/układ sprzętu.
- c. Konfiguracja sprzętu/elementy.
- d. Części zabezpieczające sprzęt (otwieranie/zamykanie pokrywy i części mocujące pokrywę).

(3) Podczas korzystania z urządzenia wszystkie osłony powinny być zamknięte.

Oczekuje się, że ten produkt będzie używany w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej, a nabywca i użytkownik tego produktu powinien upewnić się, że jest on używany w tym środowisku elektromagnetycznym.

Niezbędna wydajność

1. W przypadku zaawansowanej mocy radiowej wysokiej częstotliwości system powinien zapewniać, że odchylenie mocy znamionowej nie przekracza 20% wartości standardowej.

2. W przypadku podstawowej mocy wyjściowej energii radiowej wysokiej częstotliwości system powinien zapewniać, że odchylenie mocy znamionowej nie przekracza 20% wartości standardowej.

Wytczne i deklaracja PRODUCENTA - EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA		
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym w następujący sposób. Klient lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.		
Test emisji spalin	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Emisje RF CISPR 11	Grupa1	Urządzenie wykorzystuje energię RF tylko do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym jego emisje RF są bardzo niskie i nie powinny powodować żadnych zakłóceń w pobliskim sprzęcie elektronicznym.
Emisje RF	Klasa A	Charakterystyka EMISJI tego urządzenia sprawia, że nadaje się ono do użytku w obszarach przemysłowych i szpitalach
Prąd harmoniczny IEC 61000-3-2	Klasa A	
Zmiany napięcia/wahania napięcia/migotanie światła IEC 61000-3-3	Zgodność	

Wytczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna			
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym w następujący sposób. Klient lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku			
Test odporności	IEC 60601 poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Elektrostatyka Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV styk ± 2,4,8,15kV powietrze	± 8 kV styk ± 2,4,8,15kV powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, Wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Elektryczny szybki stan przejściowy/wybuch IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii zasilających ± 1 kV dla linii wejściowych/ wyjściowych	± 2 kV dla linii zasilających ± 1 kV dla linii wejściowych/ wyjściowych	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV od linii do linii ± 2 kV linia(-e) do uziemienia	± 1 kV linia (linie) do linii (linie) ± 2 kV linia (s) do ziemi	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Spadki napięcia, zwarcia przerwy na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0 % UT; 1 cykl i 70 % UT; 25/30 cykli Pojedyncza faza: przy 0° 0 % UT; 250/300 cykli	0 % UT; 0,5 cyklu Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° 0 % UT; 1 cykl i 70 % UT; 25/30 cykli Pojedyncza faza: przy 0° 0 % UT; 250/300 cykli	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu. Jeśli użytkownik ultrasonografu chirurgicznego Sprzęt wymaga ciągłej pracy podczas przerw w zasilaniu, zaleca się, aby Ultradźwiękowy sprzęt chirurgiczny Sprzęt musi być zasilany z zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Częstotliwość zasilania (50/60 Hz) Pole magnetyczne IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetyczna częstotliwość zasilania pola powinny mieć charakterystykę poziomu. Typowej lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Wytczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna			
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym w następujący sposób. Klient lub użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku			
ODPORNOŚĆ test	Test IEC 60601 poziom	Zgodność poziom	Środowisko elektromagnetyczne- wytczne
Przewodzone częstotliwości radiowe IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz 6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz a 80 MHz	3V	Przenośna i mobilna łączność radiowa Sprzęt nie powinien być używany bliżej jakiegokolwiek części urządzenia, w tym kabli, niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie równania dla częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$
Promieniowanie RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,7 GHz 80 % AM przy 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ 80MHz do 800MHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz do 2,7 GHz
gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością w metrach (m). Nateżenia pól ze stałych nadajników RF, określone w badaniu elektromagnetycznym w miejscu instalacji,3 powinny być niższe niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem mogą występować zakłócenia: 			
Port ENCLOSURE ME EQUIPMENT I ME SYSTEMS należy przetestować zgodnie z tabelą 9 normy IEC 60601-1-2 przy użyciu metod testowych określonych w normie IEC 61000-4-3.			

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem łączącym radiowej a urządzeniami.			
Ultradźwiękowy sprzęt chirurgiczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym promieniowane zakłócenia RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajnikami) a urządzeniem zgodnie z następującymi zaleceniami, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.			
Znamionowa maksymalna moc wyjściowa nadajnika (w)	Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika /m		
	150 kHz do 80 MHz	80 MHz do 800 MHz	800 MHz do 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{1}} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{\sqrt{1}} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{\sqrt{1}} \right] \sqrt{P}$
	0.01	0.117	0.233
	0.1	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

UWAGA: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich od struktur, obiektów i ludzi.

Warunki techniczne

Komponenty wymagane do działania systemu: Urządzenie elektrochirurgiczne, Przetwornik, Ultradźwiękowy przetwornik nożny, Nożyce ultradźwiękowe lub Rękojcie elektrochirurgiczne Złącze bipolarnie Urządzenie bipolarnie.


Patrz opis produktu dla tego komponentu.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	Ultradźwięki:  Część stosowana typu CF; Elektrochirurgia bipolarna  Część stosowana typu CF odporna na defibrylację
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	Klasa I
Generator szkodliwych infuzji	Normalne wyposażenie
Stopień ochrony przed szkodliwym wnikaniem wody	Przetwornik nożny: IP68
Kategoria Zarządzania	Klasa IIb
Wymagania dotyczące parametrów trybu ultradźwiękowego:	
Moc wyjściowa	Napięcie zasilania: 100-240 V Częstotliwość zasilania: 50Hz/60Hz Moc wyjściowa: 400VA
Wymagania dotyczące parametrów trybu ultradźwiękowego:	
Częstotliwość wzbudzenia	54 kHz - 57 kHz
Skok drgań końcówki głównej	25 μm ~ 110 μm
Nożyce ultradźwiękowe - główna akustyczna powierzchnia wyjściowa Produkt:	1,53-2,75 mm ²
Wtórne usieciowanie akustyczne na końcówce nożyc ultradźwiękowych Obszar wyjściowy:	19,32-35,88 mm ²
Pochodny dźwięk wyjściowy w Nożycach ultradźwiękowych w Końcówce referencyjnej Amplituda pierwotna Moc	< 30W
Typ kontroli częstotliwości systemu	Niezależnie od obciążenia, częstotliwość wzbudzenia jest automatycznie regulowana w sposób ciągły.
Wskaźnik rezerwy mocy	Nie mniej niż 2,5
Wymagania dotyczące parametrów elektrochirurgicznych:	
Częstotliwość pracy	400KHz ± 5%
Maksymalne napięcie wyjściowe	≤ 250V
Zaawansowany tryb bipolarny Maksymalny prąd wyjściowy	≤ 5.5A
Podstawowy tryb dwubiegunowy Maksymalny prąd wyjściowy	≤ 2.2A
Maksymalne napięcie międzyszczytowe na wyjściu	≤ 500Vpk
Współczynnik szczytu	1.6 ± 0.4
Moc znamionowa	Zaawansowana dwubiegunowa częstotliwość radiowa: 270 W Częstotliwość radiowa Podstawowa dwubiegunowa: 95W
Obciążenie znamionowe	Zaawansowana technologia bipolarna o częstotliwości radiowej: 30Ω Częstotliwość radiowa Podstawowa dwubiegunowa: 200Ω
Warunki środowiska pracy	Temperatura: 10 ° C do 30 ° C
	Wilgotność względna: ≤ 70%
	Zakres ciśnienia atmosferycznego: od 800 hPa do 1060 hPa
Warunki transportu i przechowywania	Temperatura: -30 ° C do + 55 ° C (Generator, Przetwornik nożny, adapter) Temperatura: -10 ° C do + 55 ° C (Nożyce ultradźwiękowe)
	Wilgotność: ≤ 80%
Data produkcji	Zakres ciśnienia atmosferycznego: od 800 hPa do 1060 hPa
Przewód zasilający	Datę produkcji można określić na podstawie numeru seryjnego znajdującego się na tylnym panelu Generatora. Zgodność z wymogami certyfikacji CCC Prąd znamionowy: 10A

Współczynnik trwałości	Określany przez rękojeść przetwornika i używane Nożyce ultradźwiękowe. Aby uzyskać informacje na temat współczynnika trwałości, patrz odpowiednie Nożyce ultradźwiękowe oraz Instrukcja obsługi rękojeści przetwornika lub Rozdział 7 - Ostrzeżenia i środki ostrożności.
Bezpiecznik	€5 * 20 T8AH250V
Waga (bez opakowania)	Generator: nominalnie 8 kg
Całkowita objętość	Generator OP9: (długość * szerokość * wysokość): 34 cm-34 cm-16 cm
Dyspozycja	Niektóre wewnętrzne elementy Generatora, przełącznik nożny i kabel przełącznika nożnego zawierają ołów. Zgodnie z lokalnymi przepisami Wymagania i przepisy dotyczące utylizacji. Baterie należy utylizować zgodnie z odpowiednimi praktykami utylizacji odpadów.
Klasyfikacja AP/APG	Nie jest to sprzęt AP/APG.
Żywotność:	Żywotność: 7 lat
Wersja oprogramowania	V01.01

Bipolarny przebieg wyjściowy


Zaawansowana dwubiegunowa krzywa mocy wyjściowej i obciążenia

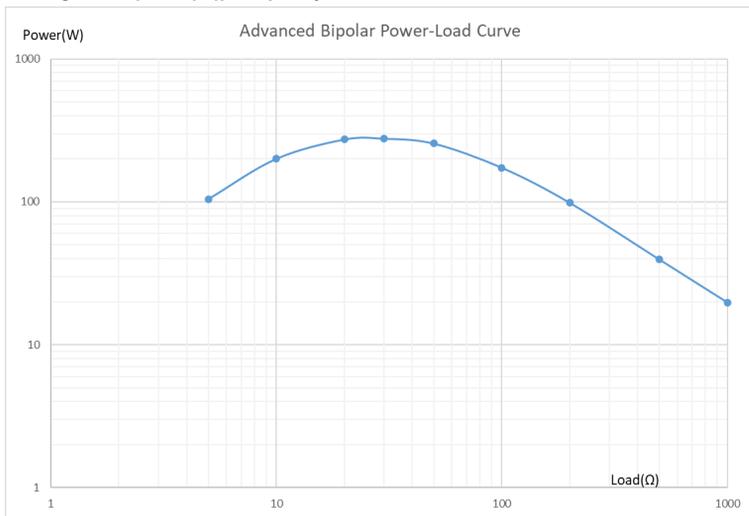

OGRANICZENIE KURSU MOCY Maks. moc wyjściowa: 270[W]			
Obciążenie (Ω)	Dolny limit	Nominalna	Górny limit
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Nominalna krzywa mocy wyjściowej 270 W przy obciążeniu znamionowym zgodnie z limitem prądu/napięcia miernika krzywej mocy. Krzywa mocy reprezentuje obwiednię, która zmienia się w warunkach pracy.


Podstawowa dwubiegunowa krzywa mocy wyjściowej przy pełnym obciążeniu

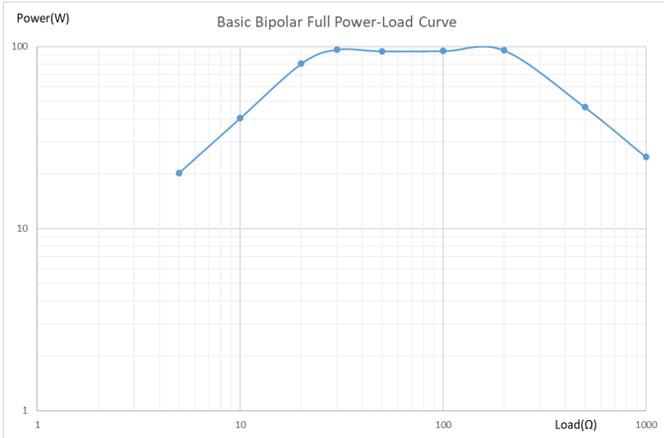

Limit krzywej pełnej mocy [W]: Maksymalna moc 95 W

Obciążenie (Ω)	Dolny limit	Nominalna	Górny limit
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Podstawowa dwubiegunowa krzywa obciążenia połowy mocy wyjściowej

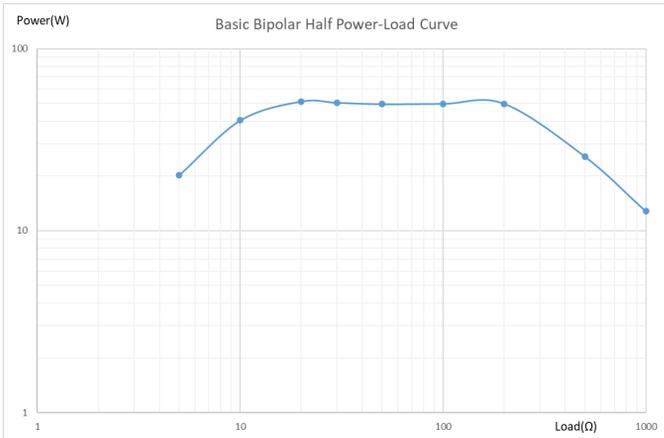

Ograniczenie krzywej połowy mocy [W]: Maksymalna moc 50 W

Obciążenie (Ω)	Dolny limit	Nominalna	Górny limit
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Moc wyjściowa a ustawienia mocy dla mocy w normalnym trybie dwubiegunowym

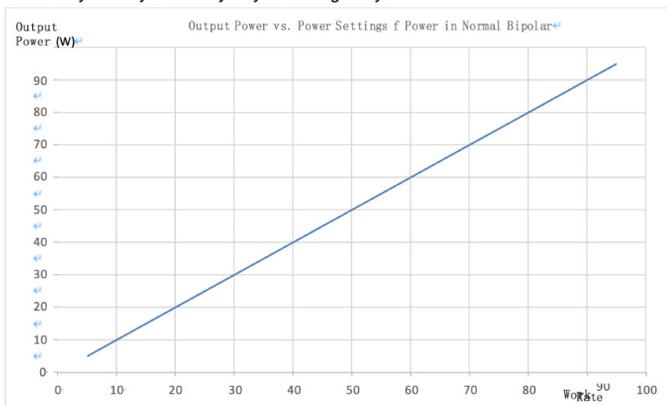

Moc wyjściowa a ustawiona wartość mocy dla normalnego trybu dwubiegunowego [W]; obciążenie: 200Ω

Ustawiona moc (W)	Dolna granica mocy wyjściowej (W)	Moc nominalna (W)	Górny limit mocy wyjściowej (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Serwis i gwarancja

Reach Surgical, Inc. gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji zapobiegawczej przez okres gwarancyjny określony poniżej. Zobowiązanie firmy Reach Surgical wynikające z niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany, według uznania firmy Reach Surgical, Inc. lub jej autoryzowanego Dystrybutora, każdego wadliwego produktu lub części, które zostały zwrócone do firmy Reach Surgical, Inc. lub jej autoryzowanego Dystrybutora w obowiązującym okresie gwarancyjnym i zostały uznane za wadliwe w sposób satysfakcjonujący firmę Reach Surgical. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do produktów lub części, które zostały:

- Niekorzystny wpływ z powodu użycia z nieautoryzowanymi urządzeniami produkowanymi lub dystrybuowanymi przez strony nieautoryzowane przez Reach Surgical, Inc.
- Naprawiane lub modyfikowane poza fabryką Reach Surgical, jeśli ma to wpływ na stabilność lub niezawodność urządzenia określoną przez Reach Surgical.
- Niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie lub wypadek.
- Używany w sposób niezgodny z projektem, parametrami użytkowania, instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi produktu lub z przyjętymi w branży normami funkcjonalnymi, operacyjnymi lub środowiskowymi dla podobnych produktów.

Okresy gwarancji

Podstawowe dwubiegunowe złącze energetyczne (OP-BPC): 1 rok na komponenty i robociznę.

Generator (OP9): 1 rok na części i robociznę.

Przetątnik nożny/przewód zasilający: 1 rok na części i robociznę.

Niniejsza gwarancja stanowi wyłączne zadośćuczynienie dla pierwotnego nabywcy i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Reach Surgical, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody szczególne, przypadkowe lub wtórne, w tym szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, zysków, działalności lub wartości firmy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Reach Surgical, Inc. nie upoważnia żadnej osoby do przyjmowania jakiegokolwiek dodatkowej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem jej produktów. Nie istnieją żadne gwarancje wykraczające poza warunki określone w niniejszym dokumencie.

Reach Surgical, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez obowiązku wstecznego stosowania tych zmian do wcześniej sprzedanych lub zbudowanych produktów.

Visão geral

Leia atentamente as seguintes informações antes de utilizar este dispositivo. Estas informações fornecem instruções importantes sobre o funcionamento correto, os riscos potenciais e os danos potenciais para o produto ou para as pessoas. Na eventualidade de uma situação anómala, siga as instruções especificadas para evitar danos para si ou para o equipamento. O não cumprimento destas instruções pode resultar no comprometimento da segurança, do desempenho, da garantia ou da manutenção, pelos quais o fabricante não pode ser responsabilizado. Antes de utilizar o aparelho, leia também as instruções relativas aos modelos Transdutor e Tesoura Ultrassónicas.

Este documento foi concebido para ajudar na utilização deste dispositivo. Não é uma referência para técnicas cirúrgicas.

Convenções padrão utilizadas: Declarações de Cuidado, ADVERTÊNCIA e Nota

Tenha em atenção as seguintes afirmações, classificadas como CUIDADO, AVISO ou NOTA, que fornecem orientações essenciais para a realização de tarefas de forma segura e completa. Estas declarações podem ser encontradas em toda a documentação e devem ser lidas antes de avançar para o passo seguinte num procedimento.

AVISO: Esta declaração destaca um procedimento, prática ou condição de funcionamento ou manutenção que, se não for rigorosamente seguido, pode provocar ferimentos pessoais ou a perda de vidas.

CUIDADO: Esta declaração alerta o utilizador para uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar ferimentos ligeiros ou moderados no utilizador ou no doente, bem como danos no equipamento ou noutros bens. Pode também servir de aviso contra práticas não seguras. Isto inclui as precauções necessárias para a utilização segura e eficaz do Instrumento e os cuidados necessários para evitar danos resultantes de uma utilização correcta ou incorrecta.

NOTA: Esta declaração indica uma prática ou condição operacional essencial para a execução eficiente de uma tarefa.

Descrição

O instrumento electrocirúrgico ENER REACH (a seguir designado por "o dispositivo") é utilizado em salas de operações médicas para procedimentos cirúrgicos de corte, coagulação de tecido humano e ligação de vasos. Possui duas ranhuras separadas: uma para a energia ultra-sónica e outra para a saída de ondas de radiofrequência.

No modo de radiofrequência, o Gerador fornece esquemas de energia diferentes, dependendo do instrumento/dispositivo de electrocirurgia ligado. Quando um instrumento bipolar avançado está ligado, o Gerador fornece formas de onda de RF para selar vasos arteriais e venosos, linfáticos e feixes de tecido até 7 mm de diâmetro. Quando um instrumento bipolar básico está ligado, é emitida energia de potência constante para corte e coagulação de tecidos moles.

No modo de saída de energia ultra-sónica, utilizando o TRA6 Transdutor em combinação com Tesouras Ultrassónicas Descartáveis CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, o dispositivo corta tecidos moles que requerem controlo de hemorragias e danos térmicos mínimos, e sela vasos até um diâmetro máximo de 5 mm. Quando ligado com Tesoura Ultrassónicas Descartáveis SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 e SRE45, o dispositivo corta tecidos moles que requerem controlo da hemorragia e danos térmicos mínimos, e sela vasos até um diâmetro máximo de 7 mm.

Utilização prevista

O dispositivo fornece energia de radiofrequência para acionar peças de mão electrocirúrgicas que se destinam a ser utilizadas para cortar e selar vasos e para cortar, agarrar e dissecar tecidos.

Além disso, o Gerador fornece energia ultra-sónica para acionar instrumentos cirúrgicos ultra-sónicos que são indicados para incisões em tecidos moles quando se pretende um controlo da hemorragia e uma lesão térmica mínima.

Indicações

O dispositivo fornece energia de radiofrequência para acionar peças de mão electrocirúrgicas que são utilizadas durante cirurgias abertas ou laparoscópicas em cirurgia geral, pediátrica, ginecológica, urológica e torácica para cortar e selar vasos até 7 mm inclusive, e para cortar, agarrar e dissecar tecidos.

Além disso, o Gerador fornece energia para acionar instrumentos cirúrgicos ultra-sónicos que são indicados para incisões em tecidos moles quando se pretende um controlo da hemorragia e uma lesão térmica mínima. Os instrumentos cirúrgicos ultra-sónicos podem ser utilizados como adjuvantes ou substitutos da electrocirurgia, dos lasers e dos bisturis de aço para cortar e/ou coagular tecidos em cirurgias abertas ou laparoscópicas em geral, pediátricas, ginecológicas, urológicas, torácicas e para selar e transeccionar vasos linfáticos.

Utilizador previsto

O dispositivo destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em aplicações cirúrgicas.

Ambiente de utilização prevista

O dispositivo destina-se a ser utilizado num hospital.

População de doentes pretendida

Este dispositivo é adequado para doentes com idade igual ou superior a 3 anos que necessitem de procedimentos cirúrgicos que envolvam incisões em tecidos moles com controlo da hemorragia e lesões térmicas mínimas.


Benefício clínico

O dispositivo pode ser utilizado de forma segura e eficaz na ligadura e divisão de vasos, feixes de tecidos e linfáticos.

Contra-indicações

Este dispositivo está contraindicado para incisões ósseas, oclusão de trompas contraceptivas e procedimentos de coagulação. Também não se destina a ser utilizado em neurocirurgia.

Composição do sistema

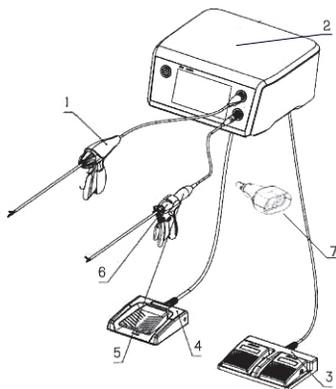

[01] Peças de mão para eletrocirurgia	[02] OP9 Gerador
[03] Pedal Ultrassônico	[04] Pedal Eletrocirúrgico
[05] Transdutor	[06] Tesoura Ultrassônicas
[07] Eletrocirurgia Conversor Bipolar	

[01] Peça de mão electrocirúrgica

A peça de mão electrocirúrgica, ligada a um Gerador, é operada pelo cirurgião durante o procedimento. Aplica energia electrocirúrgica RF ao tecido entre os seus Mandíbulas para coagular ou selar. O instrumento também inclui uma lâmina para divisão do tecido. Modelos: OSA23, OSA37, OSA44. Consulte as instruções para obter informações pormenorizadas.

[02] OP9 Gerador

O Gerador fornece energia electrocirúrgica e energia de terapia ultra-sónica através de portas de ligação de instrumentos separadas. É constituído por um chassis, um invólucro, uma placa eletrónica, um ecrã tátil LCD, um interruptor de alimentação e interfaces para ligação de acessórios.

Modelo: OP9

[03] Pedal Ultrassônico

Utilizado para controlar a saída on/off da energia ultra-sónica com dois interruptores ("MIN" e "MAX"). Modelo: OP-FSD

[04] Pedal Eletrocirúrgico

Utilizado para controlar a saída on/off de energia de alta frequência com um único interruptor.

Modelo: OP-FSS

[05] Transdutor

O Transdutor converte a energia eléctrica de um Gerador compatível em movimento mecânico para as lâminas do instrumento. É um instrumento reutilizável com uma vida útil limitada. O Transdutor não é estéril e deve ser esterilizado de acordo com as instruções antes de ser utilizado. Consulte as instruções do TRA6 Transdutor para obter informações pormenorizadas.

Modelo: TRA6.

[06] Tesoura Ultrassônicas

O Tesoura Ultrassônicas utiliza o movimento mecânico do Transdutor e fornece energia ultra-sónica para corte ou coagulação de tecidos. Deve ter-se cuidado, uma vez que a vibração mecânica não é detetável e pode afetar involuntariamente áreas não visadas. Os Tesoura Ultrassônicas são esterilizados com óxido de etileno. Se o prazo de validade for ultrapassado ou se a embalagem de esterilização estiver danificada, o Tesoura Ultrassônicas não deve ser utilizado e deve ser eliminado. Consultar as instruções do Tesoura Ultrassônicas para obter informações pormenorizadas.

Os seguintes Tesoura Ultrassônicas são compatíveis com o OP9 Gerador:

Série PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Série SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Série SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Conector bipolar para eletrocirurgia

Utilizado para ligar o bipolar básico Instrumentos eletrocirúrgicos ao Gerador para coagulação de tecidos.

Modelo: OP-BPC

Gerador Painel frontal

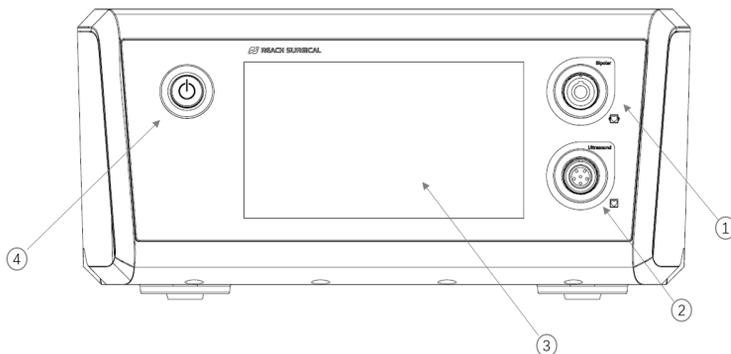

[01] Tomada electrocirúrgica

Utilizado para ligar o conector bipolar avançado Instrumentos electrocirúrgicos ou o conector bipolar de electrocirurgia.

[02] Tomada Transdutor


Liga o Transdutor ao Gerador.

[03] Ecrã tátil LCD

Apresenta informações sobre o sistema e serve de interface para ajustar os controlos e as definições.

[04] Botão do interruptor de alimentação

Prima para ligar o Gerador; prima e mantenha premido para desligar.

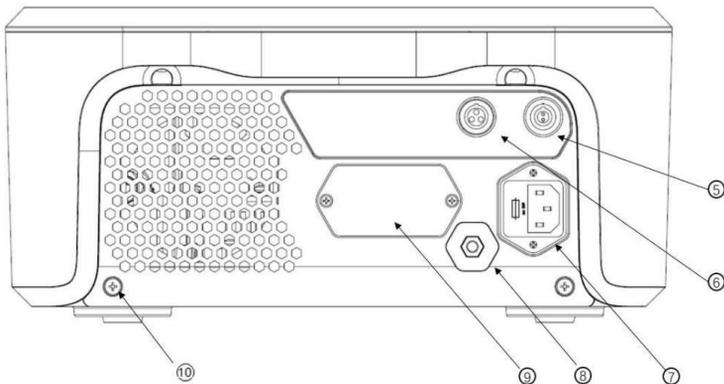Gerador Painel traseiro**[05] Tomada de pedal electrocirúrgico**

Tomada redonda para conectar o pedal electrocirúrgico.

[06] Tomada de interruptor de pé ultrassônico

Tomada redonda para ligação do interruptor de pé ultrassônico.

[07] Tomada de corrente

Liga o cabo de alimentação ao Gerador.

[08] Porta de equalização de potencial

Se a ligação à terra da tomada de corrente for incerta, esta porta permite a ligação à terra protegida.

[09] Interface de expansão

Utilizado para expansão e manutenção de funções.

[10] Orifício de montagem**Instruções de utilização**

Consulte as directrizes fornecidas para o ambiente de funcionamento.

Desembalagem

Por favor, siga as instruções abaixo após a receção dos componentes.

- Verifique se existem danos visíveis no transporte. Se for encontrado algum dano, contacte a Reach Surgical, Inc ou o agente local para obter assistência.

Componentes incluídos no sistema (Para obter especificações técnicas pormenorizadas e códigos de produtos, consulte o capítulo "Condições técnicas do sistema"):

Modelo	Descrição	Componente
OP9	Gerador	Gerador, Cabo de alimentação, Instruções
TRA6	Transdutor	Transdutor com cabo
OP-FSD	Interruptor de pé ultrassónico	/
OP-FSS	Interruptor de pé bipolar	/
OP-BPC	Conector de energia bipolar básico	/

Precauções de segurança

- Durante a inspeção do equipamento, mantenha a extremidade distal do instrumento afastada de outros aparelhos, campos cirúrgicos, do doente ou de quaisquer outros objectos para evitar ferimentos.
- Aplicar as medidas de segurança necessárias na presença de vapores, seguindo os procedimentos e regulamentos do hospital.

Energia ultra-sónica com PD Série Tesoura Ultrassónicas

- Ligar o Transdutor, o interruptor de pé e a série PD Tesoura Ultrassónicas ao Gerador.
- Depois de passar os testes Transdutor e Tesoura Ultrassónicas, ajuste o nível de potência (1-5) utilizando os ícones +/- no ecrã LCD.
- Prima o botão "Min" no Tesoura Ultrassónicas ou o pedal Min no interruptor de pé para ativar a energia ultra-sónica no nível de potência predefinido.
- Prima o botão "Max" no Tesoura Ultrassónicas ou o pedal Min no interruptor de pé para fornecer o nível máximo de energia.
- Solte a tecla ou o pedal interruptor para parar a produção de energia.

Energia ultra-sónica com SRB/SRE Série Tesoura Ultrassónicas

- Depois de passar os testes Transdutor e Tesoura Ultrassónicas, ajuste o nível de potência (1-5) utilizando os ícones +/- no ecrã LCD.
- Prima o botão Botão de Energia no instrumento ou o botão Min no pedal para ativar a energia ultra-sónica no nível de potência predefinido.
- Prima o botão Botão de Energia com Hemostasia Avançada no instrumento para ativar o modo de Hemostase Avançada.
- Solte o botão no Tesoura Ultrassónicas ou o botão no Pedal para parar o fornecimento de energia.

Energia bipolar electrocirúrgica com instrumentos bipolares avançados

- O visor LCD apresenta o ícone bipolar avançado e o ícone de controlo manual ajustável.
- Puxe o Alavanca no instrumento ou prima o pedal para ativar a frequência de rádio.
- O Gerador interromperá a produção de energia quando o fecho estiver concluído, o que é indicado pelo ícone de conclusão no ecrã.
- Se a ligação estiver incompleta, é emitido um sinal sonoro de aviso e é apresentado um ícone de aviso.

Energia bipolar electrocirúrgica com instrumento electrocirúrgico bipolar

- O ecrã LCD apresenta o valor da potência, os ícones ajustáveis e as barras de nível de potência.
- As definições de potência variam entre 1-95 watts, com incrementos ajustáveis.
- Selecione a definição de saída de potência pretendida: Baixa (15 watts), Média (30 watts) ou Alta (60 watts).
- Prima o botão no interruptor manual ou no pedal para ativar a frequência de rádio.
- Solte o botão para desativar a saída de energia.

Recomendações de definição

Definições de efeitos	Gama de definições de potência	Aplicação clínica	Dispositivo otimizado
Baixa	1-15 watts	Por exemplo, nervos/espinha, mãos e cirurgia facial	- Dispositivos com áreas de superfície mais pequenas - Pinça de micropontas (0,4 - 2,2 mm)
Médio	16-40 watts	Como a coagulação durante a cabeça/pescoço, coluna vertebral e anatomia	- Dispositivos com área de superfície média - Pinça de micropontas (1,0 - 2,2 mm) - Pinça laparoscópica pequena de cabeça chata - Tesoura bipolar
Elevado	45-95 watts (incrementos de 5 watts)	Por exemplo, cirurgia da cabeça/pescoço e cirurgia plástica (semelhante ao efeito médio, mas com efeito mais rápido)	- Dispositivos com grandes áreas de superfície - Pinça laparoscópica grande de cabeça chata

NOTA: Este dispositivo não é compatível com o eléctrodo neutro.

NOTA: O Tesoura Ultrassónicas e o bisturi elétrico RF são peças aplicadas em contacto com o paciente


Utilizar o Gerador

Ligar o dispositivo

- O sistema está pronto a funcionar depois de ter sido ligado. Quando o Gerador está ligado à rede eléctrica e a luz do interruptor de standby está acesa, o sistema está pronto a ser utilizado.
- Depois de premir o botão Standby, é apresentada a seguinte imagem:




- Se nenhum Transdutor ou Tesoura Ultrassónicas estiver ligado ao Gerador, ou se estiverem ligados incorretamente, será apresentada a seguinte imagem:



Utilização de um instrumento ultrassónico (Transdutor e Tesoura Ultrassónicas)


Quando são detectados Transdutor e Tesoura Ultrassónicas, é apresentada a seguinte imagem.

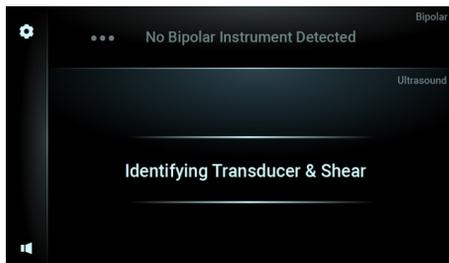

NOTA: se a utilização restante do Transdutor for inferior a 10, será apresentada a seguinte imagem. Preste atenção ao número de utilizações restantes, pois o Transdutor precisa de ser substituído quando o número chegar a zero.




Em seguida, será apresentada a seguinte imagem, sendo-lhe pedido que prima qualquer botão do Tesoura Ultrassônicas para iniciar o teste do Tesoura Ultrassônicas com o Mandíbulas aberto.

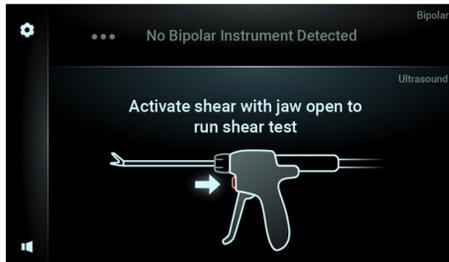


Prima o botão qualquer e será apresentada a seguinte imagem.




Se o teste Transdutor falhar, é apresentada a seguinte imagem:

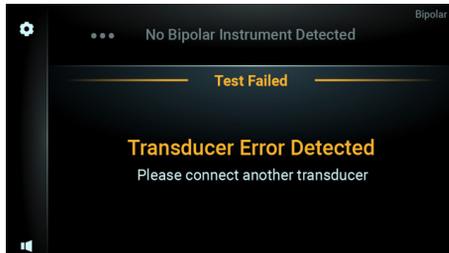


Se o teste Tesoura Ultrassônicas falhar, é apresentada a seguinte imagem

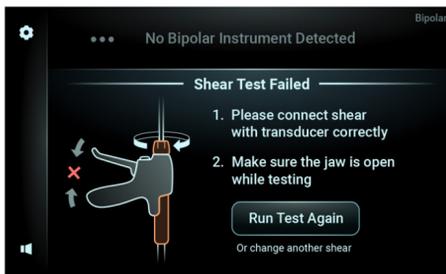

Se os testes Transdutor e Tesoura Ultrassônicas forem aprovados, é apresentada a seguinte imagem:

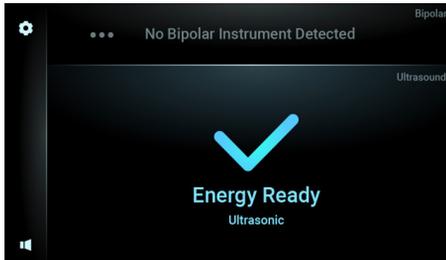

O seguinte ecrã de trabalho é apresentado quando se liga o Tesoura Ultrassônicas sem a função Hemostase Avançada.

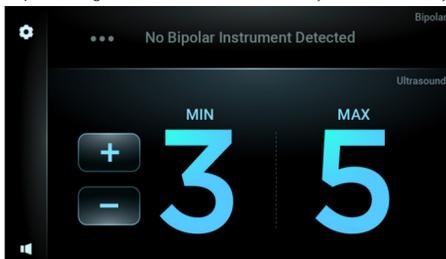


O seguinte ecrã de trabalho é apresentado quando se liga o SRE Tesoura Ultrassônicas ao Advanced Hemostasis.




O modo de saída será realçado se estiver ativado.

Utilização de instrumentos electrocirúrgicos


Quando são detectados Transdutor e Tesoura Ultrassônicas, é apresentada a seguinte imagem.

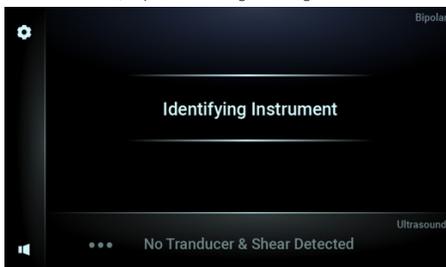


Se o teste do instrumento electrocirúrgico for aprovado, é apresentada a seguinte imagem:

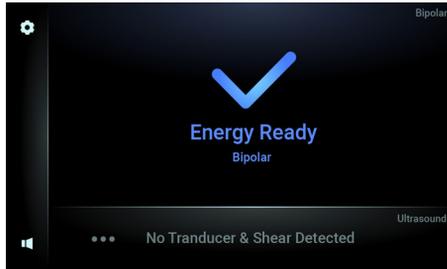

Ao ligar um instrumento bipolar avançado, é apresentado o seguinte ecrã de trabalho.




Ao ligar um instrumento bipolar normal, é apresentado o seguinte ecrã de trabalho.

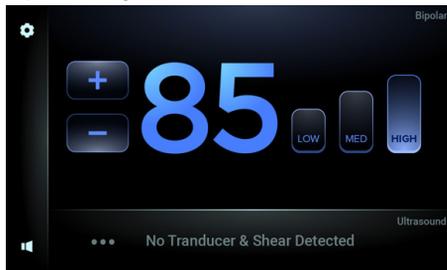


Utilização de instrumentos electrocirúrgicos e Tesoura Ultrassónicas

Tenha em atenção que, quando o Gerador está ligado a um instrumento electrocirúrgico bipolar e a um Tesoura Ultrassónicas, o sistema funciona em modo de ecrã dividido para apresentar o estado atual. O dispositivo que tiver prioridade será o primeiro a ativar a energia. Este estado de ecrã dividido é mostrado abaixo:

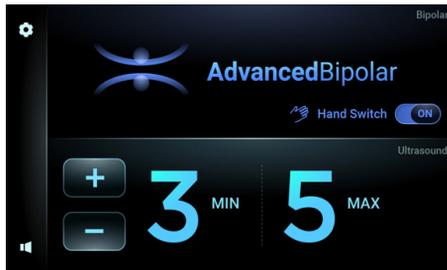

Definições do sistema


Para aceder às definições do sistema, clique no ícone de definições localizado no canto superior esquerdo do ecrã. Estão disponíveis as seguintes opções de definições do sistema:

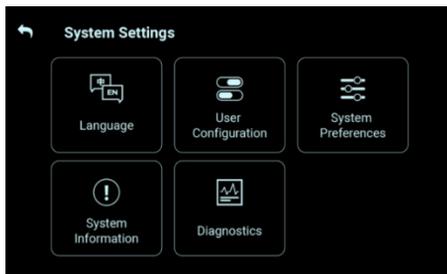


Idioma: Clicando no item Idioma, aparece o ecrã de seleção do idioma:




Configuração do utilizador: Clicando no item Configuração do utilizador, é apresentado o ecrã de configuração do utilizador:

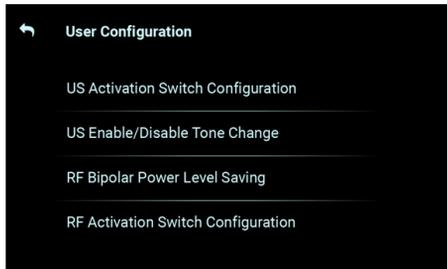

Preferências do sistema: Ao clicar no item Preferências do sistema, é apresentado o ecrã de preferências do sistema:

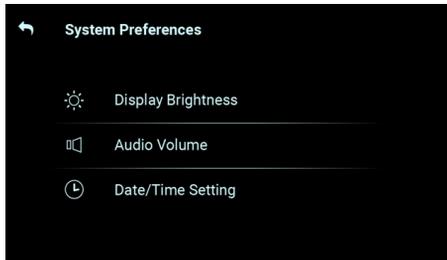

Informações do sistema: Clique suavemente no item Informações do sistema para visualizar o ecrã de informações do sistema:

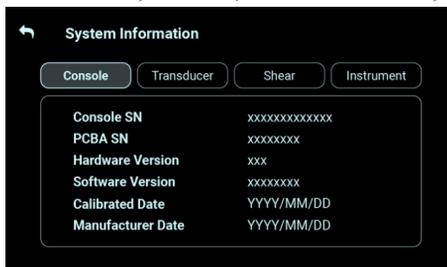

Diagnóstico: Ao clicar no item Diagnóstico, é apresentado o ecrã de diagnóstico:



Para sair das definições do sistema e regressar ao modo de espera do sistema, prima o ícone "Return" (Regresso) localizado no canto superior esquerdo do ecrã.

Desligar o sistema

Siga os passos abaixo para desligar o sistema em segurança:

Pressione o botão Standby: Localize o botão Standby no Gerador e prima-o para iniciar o processo de encerramento.

Desligar o Transdutor e o Tesoura Ultrassónicas: Desconecte cuidadosamente o Transdutor e o Tesoura Ultrassónicas do sistema. Consulte as instruções de funcionamento para o manuseamento correto do Transdutor e do Tesoura Ultrassónicas.

Limpeza: Limpar o Gerador, o Interruptor de Pé e o Transdutor de acordo com os procedimentos especificados no Capítulo 'Manutenção'.

Resolução de problemas

O Gerador incorpora vários sinais de alerta e códigos de erro para ajudar na identificação e diagnóstico de falhas de componentes. É importante notar que estes sinais e códigos foram concebidos para apoiar o julgamento e a observação clínicos, e não para os substituir.

Alerta sonoro

Estado de funcionamento	Tipo de som	Causa e ação possíveis
Estado do autocontrolo	Som normal	/
	Som anormal	Foi detectada uma falha de hardware. Contacte o fabricante para obter assistência na reparação.
Utilização do instrumento ultrassónico	Nível máximo de som	/
	Nível mínimo de som	/
	Som anormal	O Tesoura Ultrassónicas entrou em contacto com tecido em excesso. Reduzir o contacto do tecido com o Tesoura Ultrassónicas. Se persistir um som contínuo, remover cuidadosamente qualquer tecido que possa estar a acumular-se à volta da extremidade do Tesoura Ultrassónicas. Foi detectada uma avaria no Transdutor e/ou Tesoura Ultrassónicas. Consulte o fabricante ou contacte o serviço de apoio para obter mais assistência.
	Som AVANÇADO	/
	Som ITS	/
Ativação do instrumento electrocirúrgico	Tom de aviso bipolar avançado	/
	Som bipolar normal	/
	Som anormal	Corte mal sucedido: Se o tecido em contacto com o instrumento não cumprir os requisitos de corte, reduza a quantidade de tecido em contacto com o instrumento. Se o tom de falha persistir, limpe cuidadosamente qualquer tecido que possa estar a acumular-se na extremidade do instrumento. Falha de hardware: Esse erro indica uma possível falha no circuito ou no conector. No caso de qualquer falha ou erro, recomenda-se que consulte o fabricante ou procure apoio para obter orientação e resolução adequadas.


Códigos de erro

A Energy Platform Gerador está equipada com um sistema de identificação de falhas abrangente que consiste em alertas e erros do sistema. Quando é detectada uma falha, o Gerador emite um tom de aviso, apresenta um sinal de aviso no painel de controlo e mostra um código de falha correspondente no ecrã LCD. Siga os passos descritos abaixo para resolver o problema:

Tabela de códigos de erro

Código de erro	Mensagem de falha correspondente
Aviso	Ligar corretamente o Tesoura Ultrassónicas ao Transdutor
Aviso	Certifique-se de que o Mandíbulas está aberto durante o teste
Aviso	Tesoura Ultrassónicas Erro detectado
Aviso	O tempo restante do Transdutor é zero
Aviso	Ativar apenas um botão de cada vez
Aviso	Por favor, reduza a força aplicada ao Tesoura Ultrassónicas
Aviso	O botão Tesoura Ultrassónicas e o pedal não podem ser fechados simultaneamente
Aviso	Botão preso, verifique e continue
Aviso	Ajustar Mandíbulas ou fixar menos tecido
Aviso	Retirar o dispositivo dos tecidos
Erro de sistema	Erro de sistema
Erro de sistema	Falha na auto-verificação

Se aparecer um erro no ecrã durante o teste, execute as seguintes acções:

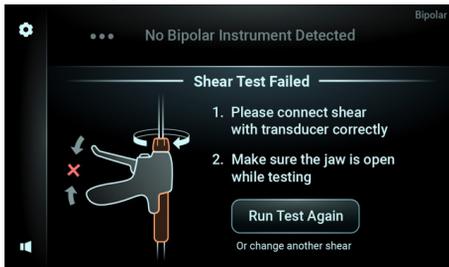

- Certifique-se de que o cabo Transdutor está totalmente inserido na direção correcta.
- Verificar se o Tesoura Ultrassónicas foi apertado corretamente ou se se acumulou tecido à volta da extremidade do Tesoura Ultrassónicas. Ajustar o aperto do Tesoura Ultrassónicas e remover cuidadosamente qualquer acumulação de tecido à volta do invólucro do Tesoura Ultrassónicas. (Se o teste for iniciado antes da operação, certificar-se de que o Tesoura Ultrassónicas está a apontar para o ar. Se estiver a ser utilizado o Tesoura Ultrassónicas, confirmar que a mandíbula de aperto está aberta e não está em contacto com quaisquer objectos).
- Se o problema persistir, considere a substituição do Transdutor ou Tesoura Ultrassónicas.
- Passar ao modo de funcionamento do aparelho.

NOTA: O Transdutor pode não funcionar corretamente se sua temperatura exceder o limite especificado. Nesses casos, use outro Transdutor imediatamente para recuperação ou siga as etapas abaixo para determinar a causa do erro e explorar métodos de recuperação opcionais:

- Deixe o Transdutor arrefecer à temperatura ambiente durante um mínimo de 45 minutos. Este método de arrefecimento também se aplica se o Transdutor ficar quente após um funcionamento prolongado a alta potência.
- Se o sobreaquecimento do Transdutor não for evidente e o problema não for resolvido, contactar os representantes de manutenção do fabricante para obter assistência.
- Para além dos fusíveis, não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no Gerador. Para quaisquer necessidades de substituição ou de assistência, contacte o pessoal de assistência formado e autorizado pela Reach Surgical, Inc. ou o seu representante local.

A manutenção e as atualizações do Gerador devem ser realizadas exclusivamente por pessoal de assistência técnica formado e autorizado pela Reach Surgical.

Devem ser tomadas precauções em matéria de cibersegurança para evitar potenciais ameaças. Os seguintes incidentes representam riscos de cibersegurança:

- Acesso não autorizado a quaisquer produtos não relacionados com o dispositivo.
- Qualquer comunicação de rede não autorizada com o dispositivo.
- Atualizações de firmware ou software que não tenham sido autorizadas pela Reach Surgical.

Na eventualidade de qualquer um dos incidentes acima referidos, contacte o representante de vendas da Reach Surgical, Inc. ou contacte diretamente a Reach Surgical, Inc. através do endereço Reachquality@reachsurgical.com.

Manutenção

Limpeza e desinfeção do Gerador e do conector de energia bipolar básico

Limpeza

Limpar o ecrã LCD do Gerador e o conector bipolar básico de acordo com os procedimentos e regulamentos do hospital. Antes de efetuar a limpeza, certifique-se de que a fonte de alimentação principal do Gerador está desligada e que o cabo de alimentação foi retirado da unidade de saída.

AVISO: Os procedimentos de limpeza devem ser seguidos cuidadosamente para evitar danificar o Gerador, causar choques eléctricos ou criar um risco de incêndio. Não derrame ou salpique líquidos sobre ou dentro do Gerador, nem o mergulhe em líquidos.

Siga estes passos para a limpeza:

- Preparar um detergente de pH neutro ou um detergente enzimático de pH neutro, conforme especificado pelo fabricante do detergente.
- Utilizando um pano limpo e macio embebido numa pequena quantidade de solução de limpeza, limpe manualmente todas as superfícies, incluindo o ecrã Gerador.
- Limpar todas as superfícies com um pano limpo e macio embebido em água morna da torneira.
- Por fim, limpe todas as superfícies com um pano limpo e macio para garantir que estão secas.

Desinfeção

- Se o Gerador ficar contaminado com sangue ou fluidos corporais, tem de ser desinfectado antes de ser reutilizado. Os seguintes desinfetantes químicos foram validados para uso no Gerador: 70% de álcool isopropílico, 6% de hipoclorito de sódio, 10% de peróxido de hidrogénio.
- Siga as recomendações do fabricante quanto à utilização adequada, à concentração e ao tempo de contacto dos desinfetantes.
- Assegurar que os desinfetantes são configurados e utilizados de acordo com as instruções do fabricante.

Limpar o interruptor de pé

Limpe o interruptor de pé e o cabo após cada utilização, utilizando o seguinte procedimento:

- Desligue o interruptor de pé do Gerador.
- Preparar um detergente enzimático de pH neutro de acordo com as instruções do fabricante.
- Ligue firmemente o cabo ao interruptor de pé e mergulhe-o na solução de limpeza durante 2 minutos.

NOTA: Certifique-se de que o cabo do interruptor de pé utilizado para ligar o Gerador está completamente seco para evitar uma ativação accidental.

- Após a imersão, esfregue manualmente o interruptor de pé e o cabo com uma escova de cerdas macias na solução de limpeza.
- Enxaguar bem o interruptor de pé e o cabo com água morna da torneira durante pelo menos 1 minuto.

CUIDADO: Mantenha o cabo e o interruptor de pé firmemente ligados durante a lavagem.

- Limpar todas as superfícies com um pano limpo e macio.

AVISO: Não utilize uma máquina de limpeza ultra-sónica para limpar o interruptor de pé.

AVISO: Não ligue a fonte de alimentação do Gerador antes de ligar o cabo de alimentação CA. Certifique-se de que todas as ligações estão secas antes da montagem.

Limpeza e desinfeção do Transdutor

Os Transdutores são enviados não esterilizados e requerem uma limpeza e esterilização completas antes de cada utilização.

Limpeza:

Limpe completamente os transdutores de acordo com as seguintes etapas:

- Enxagúe o transdutor com o lado do parafuso virado para cima e limpe com uma escova de cerdas macias e água purificada até que não haja manchas na superfície;
- O transdutor pode ser embebido num detergente enzimático de pH neutro (ingredientes principais: protease lipase amilase celulase pectinase e outras enzimas biológicas, surfactante ambientalmente correto, fator de prevenção de ferrugem e estabilizador) por um período de 10 minutos e a uma temperatura apropriada de 15 ° C ~ 65 ° C. A proporção de detergente e água purificada é de 1:400;
- Enxagúe o transdutor com o lado do parafuso voltado para cima em água purificada durante 2 minutos;
- Limpe o parafuso de conexão, a superfície de montagem do bisturi e o conector com um pano embebido em álcool.
- Mergulhe o transdutor em álcool medicinal a 75%, segure e agite-o por 30 vezes;
- Enxagúe o transdutor com o lado do parafuso voltado para cima em água purificada durante 2 minutos.

Nota: o uso de equipamentos de limpeza ultrassônicos não é recomendado para o transdutor.

Secagem:

Temperatura de secagem: 50-70 °C, Tempo de secagem: 30 min.

Esterilização do transdutor:

Seguindo as etapas de limpeza e secagem acima, o transdutor deve ser esterilizado com um dos métodos listados abaixo.

Esterilização a vapor (121 °C)

- Instale as bairnhas antes da esterilização. O transdutor deve estar embrulhado durante a esterilização. Coloque os transdutores numa panela de esterilização a vapor de alta temperatura para esterilização, com uma temperatura de 121 ° C e uma duração de 30 min.
- Temperatura de secagem: 50-70 °C, Tempo de secagem: 30 min.

Esterilização a vapor (134°C)

- Instale as bairnhas antes da esterilização. O transdutor deve estar embrulhado durante a esterilização. Coloque os transdutores numa panela de esterilização a vapor de alta temperatura para esterilização, com uma temperatura de 134 ° C e uma duração de 10 min.
- Temperatura de secagem: 50-70°C, Tempo de secagem: 30 min.

Testes de segurança e funcionais

Assegurar a implementação de testes de segurança e de funcionamento para o Transdutor, Gerador e Interruptor de Pé, de acordo com os procedimentos e regulamentos do hospital. Para efetuar testes de segurança e de funcionamento de outros componentes utilizados por vários doentes, consulte as instruções de funcionamento específicas de cada componente.

Teste de segurança

Gerador: Os técnicos hospitalares certificados devem efetuar um teste de corrente de fuga.

Interruptor de pé: Inspeccionar o pedal, o conector do cabo e o cabo quanto a fissuras ou danos. Substitua quaisquer componentes danificados.

Outros componentes: Verificar todos os outros componentes de acordo com as instruções dos respectivos manuais de instruções.

Teste funcional

Modo de ultrassom

- Preparar o conjunto completo do PD Tesoura Ultrassónicas e ligar o Transdutor seguindo as instruções fornecidas no Capítulo II - Instalação e Funcionamento do Equipamento.
- Verificar se é possível entrar no estado de funcionamento. Os diferentes Tesoura Ultrassónicas podem ter diferentes interfaces de entrada. Consultar a Parte 1, Secção 3 do Capítulo 2 para obter instruções pormenorizadas.
- Confirmar a visualização do nível 3 de potência mínima e do nível 5 de potência máxima.
- Prima os botões de aumento e diminuição da potência para garantir que o nível de potência MIN pode ser ajustado entre os níveis 1 e 5.
- Ligar o Gerador e colocá-lo no modo de funcionamento ultrassónico. Verificar a ligação correcta do Transdutor e do Tesoura Ultrassónicas.
- Com o maxilar aberto, prima o botão "MAX" no interruptor de pé. O ecrã LCD deve apresentar o nível de potência MAX "5" e deve soar um sinal sonoro de ativação.
- Com o maxilar aberto, prima o botão "MIN" no interruptor de pé. O ecrã LCD deve apresentar o nível de potência MIN e deve soar um sinal sonoro de ativação.

AVISO: Antes de ativar o sistema, certifique-se de que o maxilar é mantido afastado de tecidos, outros instrumentos ou quaisquer outros objectos para evitar lesões no utilizador.

Modo electrocirúrgico bipolar

- Ligar o instrumento electrocirúrgico bipolar avançado/instrumento bipolar básico de acordo com as instruções.
- Verificar se o sistema pode entrar na interface de trabalho. O modo bipolar básico deve apresentar o ícone do nível de potência 30, enquanto o modo bipolar avançado deve apresentar o ícone "bipolar avançado".
- Toque ligeiramente nas teclas de aumento e diminuição de potência no modo bipolar básico para confirmar que o nível de potência pode ser ajustado entre 1 e 95. Toque nas barras Baixa, Média e Alta para alternar diretamente entre 15, 30 e 60.
- Desligue o Gerador e aguarde 5 segundos. Em seguida, ligar a fonte de alimentação do Gerador e aguardar 10 segundos. Verificar se o modo bipolar básico apresenta a interface de nível de potência 30 e o modo bipolar avançado apresenta a interface "bipolar avançado". Verificar se o Gerador está ativado de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
- Ligar o bipolar avançado e básico Instrumentos electrocirúrgicos e premir o interruptor de pé único. Verifique se há indicações intermitentes do nível de potência no painel de controlo e ouça um som de ativação.

ADVERTÊNCIA: Antes de ativar o sistema, é estritamente proibido permitir qualquer contacto do Tesoura Ultrassónicas com tecidos, outros instrumentos ou quaisquer outros objectos para evitar lesões no utilizador.

Avisos e precauções

Relacionado com o sistema

- Leia as instruções antes da utilização e siga as directrizes hospitalares para a prática clínica de cirurgia por ultra-sons, electrocirurgia, ginecologia e laparoscopia.
- Os dispositivos minimamente invasivos podem variar de fabricante para fabricante. Se forem utilizados simultaneamente numa cirurgia instrumentos e acessórios minimamente invasivos de diferentes fabricantes, verifique a compatibilidade dos instrumentos e acessórios antes da cirurgia e verifique se os acessórios inseridos no corpo humano têm uma superfície rugosa, uma extremidade afiada ou uma saliência que possa causar riscos de segurança.
- Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por cirurgiões com formação e licenciados. Não utilize dispositivos electrocirúrgicos a menos que tenha recebido formação adequada sobre a sua utilização para o procedimento específico que terá de efetuar. A utilização deste dispositivo sem formação pode causar lesões graves não intencionais no doente, incluindo perfuração intestinal e necrose tecidual inconsciente e irreparável.
- Não abra a caixa do Gerador sem permissão para evitar possíveis riscos de choque. Qualquer reparação e atualização do instrumento deve ser efectuada por um técnico de assistência treinado e autorizado pela Reach Surgical, Inc. Não use este instrumento para qualquer outra finalidade que não seja cirurgia médica.
- É essencial um conhecimento profundo dos princípios e técnicas envolvidos nos procedimentos a laser, electrocirúrgicos e ultra-sónicos para evitar choques e queimaduras no doente e no pessoal médico, bem como danos neste dispositivo ou noutros dispositivos médicos. O isolamento elétrico ou a ligação à terra não devem ser comprometidos. Não mergulhe os dispositivos electrocirúrgicos em fluidos, a menos que a conceção o exija e a etiqueta

indique que devem ser mergulhados.

- A cirurgia ultra-sónica e a electrocirurgia seguras e eficazes dependem não só da conceção do equipamento, mas também, em grande medida, de muitos factores controlados pelo operador. Para aumentar a segurança e a eficácia, leia, compreenda e siga as instruções de utilização fornecidas com o dispositivo.
- Tal como acontece com todas as fontes de energia (electrocirúrgica, laser ou ultra-sons), devem ser tidos em consideração os riscos carcinogénicos e infecciosos que muitos subprodutos dos tecidos, como o fumo e os aerossóis, podem apresentar. Devem ser tomadas precauções adequadas, como óculos de segurança, máscaras de filtragem e equipamento eficaz de evacuação de fumo, tanto em procedimentos abertos como endoscópicos.
- Após a remoção do dispositivo, verificar a hemostase no tecido. Se não houver hemostase, devem ser utilizados métodos adequados para a obter.
- Os produtos fabricados ou distribuídos por empresas não autorizadas pela Reach Surgical, Inc. podem não ser compatíveis com o dispositivo. A utilização de tais produtos pode conduzir a resultados inesperados e pode ferir o utilizador ou o doente.
- Para reduzir o risco de interferências, o dispositivo e o invólucro devem ser ligados a um circuito de alimentação independente.
- O equipamento não é adequado para utilização na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigénio ou óxido nítrico. Potencial de faíscas devido a colisão com outros dispositivos metálicos. As faíscas podem provocar a ignição de gases inflamáveis, como os gases de campo.
- O deve funcionar dentro da gama de temperatura ambiente de funcionamento exigida.
- A tensão da tomada de saída deve satisfazer os requisitos do Gerador (Capítulo "Condições técnicas do sistema"). Se a fonte de alimentação não estiver ligada corretamente, pode danificar o Gerador e causar choques eléctricos ou perigo de incêndio.
- Não utilize cabos de extensão para evitar riscos de incêndio.
- Não coloque o tom de ativação a um nível inaudível. Os tons de ativação podem ser notados pelo pessoal da equipa cirúrgica enquanto o Gerador está a fornecer energia.
- Foi demonstrado que o fumo gerado durante a electrocirurgia é potencialmente prejudicial para os doentes ou para o pessoal da equipa cirúrgica. Sugerir ventilação adequada com um evacuador de fumo cirúrgico ou outros meios.
- Existem alguns componentes no Ultrasonic Surgical Integrated Gerador que são enviados não esterilizados (por exemplo, Transdutor). Esterilize o produto conforme necessário antes de iniciar a instalação do sistema. Para obter instruções de limpeza e utilização, consulte cada instrução relevante.
- Para evitar ferimentos nos utilizadores ou nos doentes, o Tesoura Ultrassónicas deve evitar outros dispositivos, campos cirúrgicos, doentes ou outros objectos antes de premir o botão de teste e durante a verificação do sistema. As medidas de segurança em caso de aerossol (de acordo com os regulamentos do hospital) devem ser implementadas no método de inspeção e teste do sistema.
- Não aplicar demasiada pressão na mandíbula para evitar inibir o fornecimento de energia ultra-sónica.
- Para evitar ferimentos no utilizador, a lâmina deve evitar o contacto com tecidos, outros dispositivos ou outros objectos antes de ativar o sistema.
- Se for derramado líquido sobre ou dentro do Gerador, ou se o Gerador for derramado sobre o líquido, pode danificar o Gerador e causar choques eléctricos ou perigo de incêndio.
- As faíscas e o aquecimento associados às técnicas de fecho dos recipientes podem servir como fontes de ignição. A gaze e a esponja devem permanecer húmidas. Manter os electrodos electrocirúrgicos afastados de materiais combustíveis e de ambientes ricos em oxigénio (O2).
- Se houver danos significativos no Transdutor ou se alguma peça apresentar sinais de danos após a manutenção de limpeza e desinfeção, deite-a fora. As peças danificadas estão claramente marcadas para evitar uma utilização incorrecta antes do manuseamento subsequente.
- Os resíduos descartáveis e os resíduos electrónicos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos do hospital e não devem ser eliminados à vontade para evitar a poluição ambiental.
- Evite usar o Gerador próximo ou empilhado sobre outros equipamentos. Se for necessário o uso adjacente ou empilhado, monitore o Gerador e outros equipamentos para garantir a operação adequada.
- O dispositivo não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo operador. Para obter assistência, contacte o representante de vendas ou o pessoal de assistência da Reach Surgical.
- Verificar todos os dispositivos ligados ao sistema e as ligações antes da utilização. Valide se o dispositivo funciona como pretendido. Uma ligação incorrecta pode provocar arcos voltaicos, faíscas, avarias no dispositivo ou resultados cirúrgicos indesejados.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, este equipamento só deve ser ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra.
- Mantenha a maior distância possível entre o Gerador e outros dispositivos electrónicos (por exemplo, monitores). Não cruzar ou ligar fios eléctricos a dispositivos electrónicos. O Gerador pode causar interferências com outros dispositivos electrónicos.
- O sistema deve ser utilizado com precaução na presença de pacemakers internos e externos. As interferências causadas pela utilização do Instrumentos electrocirúrgicos podem fazer com que o pacemaker entre num estado assíncrono ou impedir completamente o seu funcionamento. Quando os dispositivos de electrocirurgia ou de selagem de tecidos se destinam a ser utilizados em doentes com pacemakers cardíacos, contactar o fabricante do pacemaker ou o departamento de cardiologia do hospital para obter informações adicionais.
- Tenha cuidado ao empilhar instrumentos em cima do Gerador ou ao colocar o Gerador em cima de instrumentos eléctricos. Esta é uma configuração instável e não proporciona um arrefecimento adequado.
- Se o Gerador falhar, pode causar uma interrupção cirúrgica. Deve estar disponível um sistema de reserva.
- Se exigido pelos regulamentos locais, o Gerador deve ser ligado ao conetor equipotencial do hospital utilizando um cabo equipotencial.
- Quando o sistema e o equipamento de monitorização fisiológica são utilizados simultaneamente no mesmo doente, qualquer eléctrodo de monitorização deve ser colocado o mais longe possível do instrumento.
- No modo bipolar básico, selecionar a potência de saída mais baixa possível para o efeito desejado.
- A avaria do equipamento cirúrgico de alta frequência pode provocar um aumento inesperado da potência de saída.
- O Gerador e o conetor electrocirúrgico bipolar básico podem ser invadidos por água ou partículas. No processo de utilização e limpeza, é necessário evitar a invasão de água ou de partículas.
- Quando o sistema é utilizado em combinação com um endoscópio, pode aumentar a corrente de fuga no corpo do doente. Preste atenção durante o procedimento.
- Um aviso ao utilizador e/ou doente de que qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado à Reach Surgical, Inc. através de Reachquality@reachsurgical.com. e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

Relacionado com o instrumento

Durante os procedimentos cirúrgicos, é importante ter em atenção que a parte final do instrumento Tesoura Ultrassónicas, da alfodada Tesoura Ultrassónicas e do Haste pode registar temperaturas elevadas quando os ultra-sons ou o electroacutador bipolar são aplicados nos tecidos durante períodos prolongados. Para garantir a segurança, é fundamental evitar qualquer contacto accidental entre os componentes destes instrumentos e os tecidos, campos cirúrgicos, batas cirúrgicas ou quaisquer outras áreas não relacionadas durante o procedimento.

Além disso, é fundamental ter cuidado ao posicionar o instrumento bipolar. Especificamente, não deve ser colocado perto ou em contacto com materiais combustíveis, como gaze ou campos cirúrgicos. Os instrumentos bipolares utilizados neste contexto podem gerar calor durante a utilização, o que pode potencialmente conduzir a um risco de incêndio. Quando o instrumento electrocirúrgico bipolar Gerador não estiver a ser utilizado, deve ser devidamente guardado na manga de proteção ou mantido a uma distância segura do doente, dos membros da equipa cirúrgica e de quaisquer materiais combustíveis.

NOTA: Consulte as respetivas instruções de utilização para obter avisos e precauções adicionais.

Informação EMC

O produto passou o teste de compatibilidade electromagnética, que cumpre os requisitos de limitação da norma IEC60601-1-2 para equipamento médico. Estas restrições proporcionam uma proteção razoável contra interferências nocivas em instalações médicas normais.

Composição do produto

Número de série	Nome da peça	Modelo/Versão N.º	Observações
1	Instrumento electrocirúrgico	OP9	/
2	Transdutor do Equipamento de Ultrassom	TRA6	Utilização compatível
3	Tesoura Ultrassónicas Sistema para utilização única Tesoura Ultrassónicas	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Utilização compatível
4	Unidade de cirurgia ultra-sónica de alta frequência descartável Selante de tecidos	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Pedal Ultrassónico	OP-FSD	/
6	Pedal Electrocirúrgico	OP-FSS	/
7	Conector bipolar para electrocirurgia	OP-BPC	/

Cabo do produto

Número de série	Nome do cabo	Comprimento (m)	Blindado
1	Cabo de controlo de pé	3	Sim
2	Cabo de alimentação	5	Não
3	Cabo electrocirúrgico bipolar	3	Não
4	O cabo de Transdutor	2.9	Sim

Desempenho EMC

Este equipamento pode estar sujeito a interferências de radiofrequência causadas por outros equipamentos médicos e comunicações por rádio. Para evitar tais interferências, este produto foi testado de acordo com a norma IEC 60601-1-2 e cumpre os seus requisitos. No entanto, a Reach Surgical, Inc. não garante que não haverá absolutamente nenhuma interferência em ambientes de instalação individuais.

Se se verificar que o dispositivo está a sofrer interferências (o que pode ser determinado ligando e desligando o dispositivo), o utilizador (ou o pessoal de manutenção aprovado pela Reach Surgical, Inc.) deve tentar tomar uma ou mais das seguintes medidas para resolver o problema de interferência:

Ajustar a direção ou a posição do dispositivo que o afecta.

Aumentar a distância entre este dispositivo e o dispositivo de envio.

Utilize outras fontes de energia (em vez da energia utilizada para afetar o equipamento) para alimentar este equipamento.

Consultar o fornecedor ou o representante de serviço para outras sugestões.

O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência causada pelas seguintes situações: utilizar outros cabos de interligação que não os recomendados; alterar ou modificar este equipamento sem autorização. Alterações ou modificações não autorizadas podem causar a perda de eficácia do equipamento.

Todos os tipos de equipamento eletrónico podem causar interferências electromagnéticas noutros equipamentos através do ar ou de outros cabos a ele ligados. Não utilize dispositivos que possam emitir sinais de RF, tais como telemóveis, transceptores de rádio ou produtos de controlo de rádio, perto deste dispositivo, uma vez que isso pode fazer com que o desempenho deste dispositivo não cumpra as especificações especificadas. Quando esses dispositivos estiverem próximos deste aparelho, desligue a alimentação dos mesmos. O pessoal médico responsável por este equipamento deve dar instruções aos técnicos, doentes e outro pessoal que possa estar próximo deste equipamento para cumprirem integralmente os requisitos acima referidos.

Para atingir plenamente o desempenho EMC especificado, o utilizador deve instalar o produto corretamente de acordo com os passos descritos no manual.

Se houver algum problema relacionado com a EMC, contacte o pessoal de manutenção aprovado pela Reach Surgical, Inc.

O Transdutor (com cabo) e o Tesoura Ultrassónicas são definidos como a parte aplicada de todo o sistema.

Precauções para a instalação do produto

O equipamento pode ser utilizado em ambiente hospitalar, mas não inclui salas de blindagem de radiofrequência em torno de equipamento cirúrgico de radiofrequência ativo ou onde é colocado equipamento de impacto de ressonância magnética, porque a intensidade da perturbação electromagnética nestes locais é elevada.

Distância de separação e impacto do equipamento fixo de radiocomunicações: a intensidade do campo magnético gerado por emissores fixos, tais como estações de base de telefones sem fios (celulares/sem fios), receptores de rádio móveis terrestres, receptores de rádio amadores, emissões de rádio AM e FM e emissões de TV Geradores, etc., não pode ser medida teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente electromagnético gerado por transmissores RF fixos, deve considerar-se a medição do campo electromagnético. Se o valor medido da intensidade do campo magnético no local do dispositivo exceder o nível de radiofrequência correspondente especificado na "Declaração Anti-Interferência", o dispositivo deve ser inspecionado para garantir que pode funcionar normalmente. Se forem encontradas condições de funcionamento anormais, devem ser consideradas medidas adicionais, tais como a reorientação ou a deslocação do equipamento, ou a utilização de uma sala anti-radiofrequências.

1) Utilize o cabo de alimentação fornecido ou designado pela Reach Surgical, Inc. Os produtos equipados com um plugue de alimentação devem ser conectados a uma tomada elétrica fixa com aterramento de proteção. Não utilize qualquer tipo de adaptador ou conector para ligar a ficha de alimentação.

2) Mantenha este dispositivo afastado de outros dispositivos electrónicos tanto quanto possível.

3) Siga os passos para ligar o dispositivo.

Notas gerais

(1) A especificação do cabo.

A utilização de cabos fornecidos pela Reach Surgical, Inc não prejudicará o desempenho da CEM deste produto. Se forem utilizados cabos não especificados, o desempenho EMC deste equipamento pode ser significativamente reduzido.

(2) Precauções para modificações não autorizadas

O utilizador não deve modificar este produto, caso contrário o desempenho EMC deste produto pode diminuir.

A modificação do produto inclui as seguintes alterações:

a. Cabo (comprimento, material e cablagem, etc.).

b. Instalação/localização do equipamento.

c. Configuração/componentes do equipamento.

d. Peças de proteção do equipamento (abertura/fecho da tampa e peças de fixação da tampa).

(3) Todas as coberturas de proteção devem estar fechadas durante o funcionamento do equipamento.

Prevê-se que este produto seja utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo e o comprador e o utilizador deste produto devem garantir que é utilizado neste ambiente electromagnético.

Desempenho essencial

1. Para a produção avançada de energia radioelétrica de alta frequência, o sistema deve assegurar que o desvio da potência nominal de saída não exceda 20% do valor normalizado

2. Para a potência de saída básica de rádio de alta frequência, o sistema deve assegurar que o desvio da potência nominal de saída não exceda 20% do valor normalizado

Guia e declaração do fabricante - EMISSÕES ELECTROMAGNÉTICAS			
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve garantir que este é utilizado num ambiente deste tipo.			
Ensaio de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação	
Emissões RF CISPR 11	Grupo1	O dispositivo utiliza energia RF apenas para o seu funcionamento interno. Por isso, as suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos electrónicos próximos.	
Emissões RF	Classe A	As características EMISSÕES deste equipamento tornam-no adequado para utilização em zonas industriais e hospitalares	
Corrente harmónica IEC 61000-3-2	Classe A		
Alterações de tensão/Flutuações de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Em conformidade		

Guia e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve certificar-se de que este é utilizado num ambiente deste tipo			
Teste de IMUNIDADE	IEC 60601 nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Eletrostática descarga (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto de ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV ar	Contacto de ± 8 kV $\pm 2,4,8,15$ kV ar	Os pavimentos devem ser de madeira, betão ou ladrilhos de cerâmica. Se os pavimentos forem revestidos com material sintético, A humidade relativa deve ser de, pelo menos, 30 %.
Transitórios eléctricos rápidos/explosão IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação eléctrica ± 1 kV para linhas de entrada/saída	± 2 kV para linhas de alimentação eléctrica ± 1 kV para linhas de entrada/saída	A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Sobrecarga IEC 61000-4-5	± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linha(s) para a terra	± 1 kV linha(s) a linha(s) ± 2 kV linha(s) para a terra	A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Quedas de tensão, curto-circuito interrupções nas linhas de entrada da fonte de alimentação IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0 % UT; ciclo 250/300	0 % UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0 % UT; ciclo 250/300	A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o utilizador do equipamento de ultra-sons cirúrgico O equipamento requer um funcionamento contínuo durante as interrupções da rede eléctrica, recomenda-se que o equipamento de ultra-sons cirúrgico O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.
Frequência de potência (50/60 Hz) Campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frequência de potência magnética devem estar no nível característico. De uma localização típica num ambiente comercial ou hospitalar típico.

Guia e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O dispositivo destina-se a ser aplicado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o utilizador do dispositivo deve certificar-se de que este é utilizado num ambiente deste tipo			
IMUNIDADE teste	Ensaio IEC 60601 nível	Conformidade nível	Ambiente eletromagnético orientação
RF conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz	3V	Comunicações RF portáteis e móveis O equipamento não deve ser utilizado mais perto de qualquer parte do dispositivo, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação para a frequência do transmissor. Distância de separação recomendada
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80 % AM a 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3,5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 80\text{MHz a } 800\text{MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P} \quad 800\text{MHz a } 2,7\text{GHz}$ <p>em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, determinadas por um estudo eletromagnético do local³, devem ser inferiores ao nível de conformidade em cada gama de frequências. Podem ocorrer interferências nas proximidades de equipamentos marcados com o símbolo seguinte:</p>  <p>O ENCLOSURE PORT dos EQUIPAMENTOS e SISTEMAS ME deve ser ensaiado de acordo com o especificado no quadro 9 da norma CEI 60601-1-2, utilizando os métodos de ensaio especificados na norma CEI 61000-4-3.</p>

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis e os dispositivos.			
Sistema de gerarador para tesoura ultrassônica destina-se a ser aplicado num ambiente eletromagnético em que as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente ou o utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.			
Potência de saída máxima nominal do transmissor (w)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor /m		
	150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$

0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

NOTA: Estas directrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

Condições técnicas

Componentes necessários para o funcionamento do sistema: Instrumento electrocirúrgico, Transdutor, Pedal Ultrassônico, Pedal Eletrocirúrgico, Tesoura Ultrassônicas ou Peças de mão para electrocirurgia, Conector bipolar electrocirúrgico Instrumento bipolar.

Consultar a descrição do produto para este componente.


Grau de proteção contra choques eléctricos	Ultrassom:  Peça aplicada do tipo CF; electrocirúrgica bipolar  Peça aplicada do tipo CF à prova de desfilibração
Grau de proteção contra choques eléctricos	Classe I
Gerador a infusões nocivas	Equipamento normal
Grau de proteção contra a entrada nociva de água	Pedal de controlo: IP68
Categoria Gestão	Classe IIb
Requisitos dos parâmetros do modo de ultra-sons:	
Potência de entrada	Tensão de alimentação: 100-240V Frequência de alimentação: 50Hz/60Hz Potência de entrada: 400VA
Requisitos dos parâmetros do modo de ultra-sons:	
Frequência de excitação	54 kHz - 57 kHz
Excursão de vibração da ponta primária	25 µm - 110 µm
Tesoura Ultrassônicas ponta da superfície de saída acústica principal Produto:	1,53-2,75 mm2
Acústica de reticulação secundária na ponta Tesoura Ultrassônicas Área de saída:	19.32-35.88 mm2
Som de saída derivado na ponta Tesoura Ultrassônicas na ponta de referência Amplitude primária Potência	< 30W
Tipo de controlo de frequência do sistema	Independentemente da carga, a frequência de excitação é automaticamente ajustada de forma contínua.
Índice de reserva de energia	Não inferior a 2,5
Requisitos dos parâmetros electrocirúrgicos:	
Frequência de trabalho	400KHz ± 5%
Tensão máxima de saída	≤ 250V
Modo bipolar avançado Corrente máxima de saída	≤ 5,5A
Modo bipolar básico Corrente máxima de saída	≤ 2,2A
Tensão máxima de saída pico a pico	≤ 500Vpk
Fator de pico	1,6 ± 0,4
Potência nominal	Bipolar avançado de radiofrequência: 270 W Radiofrequência Bipolar básico: 95W
Carga nominal	Bipolar avançado por radiofrequência: 30Ω Radiofrequência Bipolar básica: 200Ω

Condições ambientais de funcionamento	Temperatura: 10 ° C a 30 ° C
	Humidade relativa: ≤ 70%
Condições de transporte e armazenamento	Gama de pressões atmosféricas: 800 hPa a 1060 hPa
	Temperatura: -30 ° C a + 55 ° C (Gerador, interruptor de pé, adaptador)
	Temperatura: -10 ° C a + 55 ° C (Tesoura Ultrassônicas)
Data de fabrico	Humidade: ≤ 80%
	Gama de pressões atmosféricas: 800 hPa a 1060 hPa
Data de fabrico	A data de fabrico pode ser determinada pelo número de série no painel traseiro do Gerador.
Cabo de alimentação	Conformidade com os requisitos de certificação CCC
	Corrente nominal: 10A
Taxa de persistência	Determinado pela peça de mão Transdutor e pelo Tesoura Ultrassônicas utilizado. Para obter informações sobre a taxa de persistência, consultar os documentos aplicáveis Tesoura Ultrassônicas e Instruções da peça de mão Transdutor ou Capítulo 7 - Avisos e precauções.
Fusível	€5 * 20 T8AH250V
Peso (sem embalagem)	Gerador: nominal 8 kg
Volume total	OP9 Gerador: (comprimento * largura * altura): 34 cm-34 cm-16 cm
Disposição	Alguns componentes internos do Gerador, o interruptor de pé e o cabo do interruptor de pé contém chumbo. De acordo com as normas locais Requisitos e regulamentação para a eliminação. Eliminar as baterias de acordo com as práticas adequadas de eliminação de resíduos.

Classificação AP/APG	Não se trata de equipamento AP/APG.
Vida útil:	Vida útil: 7 anos
Versão da versão do software	V01.01

Forma de onda de saída bipolar

Curva potência-carga de saída bipolar avançada

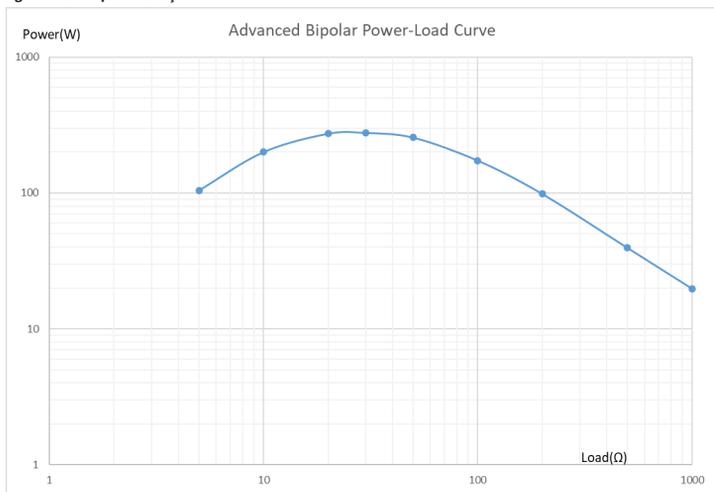


LIMITE DA CURVA DE POTÊNCIA Saída máxima: 270[W]

Carga (Ω)	Limite inferior	Nominal	Limite superior
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76


Curva de potência nominal de 270 watts de saída à carga nominal, de acordo com o limite de corrente/tensão do medidor de curva de potência. A curva de potência representa o envelope que varia em condições de funcionamento.

Curva básica de saída bipolar em carga e potência máxima

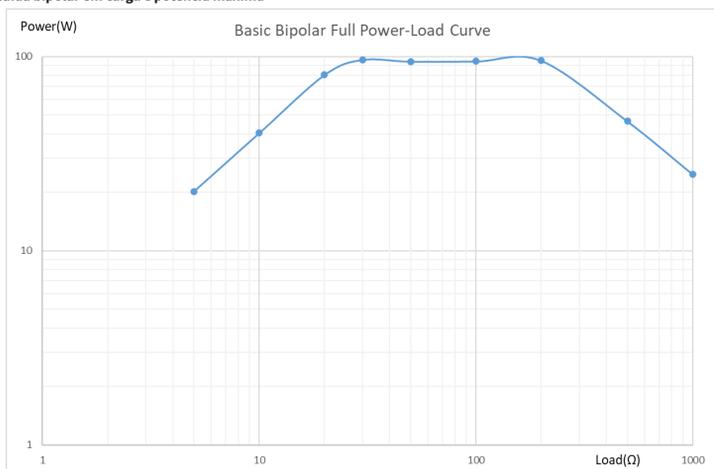


Limite da curva de potência máxima [W]: Potência máxima 95 Watts			
Carga (Ω)	Limite inferior	Nominal	Limite superior
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Curva básica de meia carga de saída bipolar

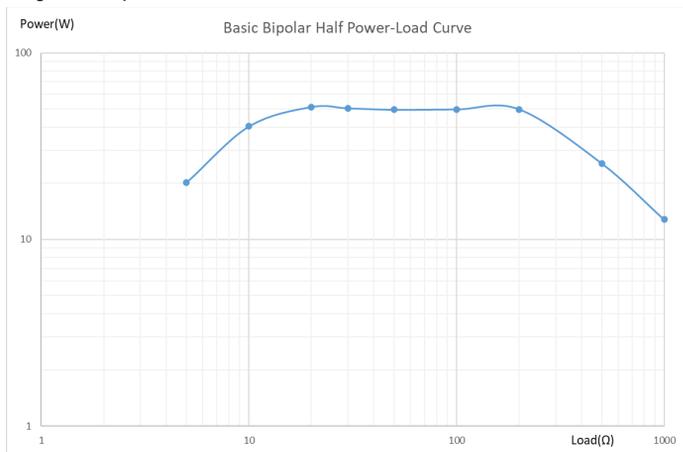

Limite da curva de meia potência [W]: Potência máxima 50 Watts			
Carga (Ω)	Limite inferior	Nominal	Limite superior
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Potência de saída vs. definições de potência para potência em bipolar normal

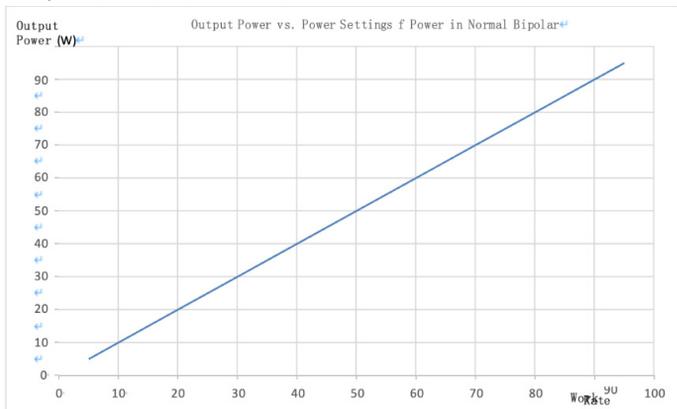

Potência de saída vs. valor de ajuste de potência para bipolar normal [W]; Carga: 200Ω			
Potência definida (W)	Limite inferior da potência de saída (W)	Potência nominal (W)	Limite superior da potência de saída (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Serviço e garantia

A Reach Surgical, Inc. garante que este produto está livre de defeitos de material e de fabrico sob utilização normal e manutenção preventiva durante o período de garantia especificado abaixo. A obrigação da Reach Surgical ao abrigo desta garantia limita-se a reparar ou substituir, a seu critério, qualquer produto ou peça defeituosa que tenha sido devolvida à Reach Surgical, Inc. ou ao seu Distribuidor autorizado dentro do período de garantia aplicável e que seja considerada defeituosa para satisfação da Reach Surgical. Esta garantia não se aplica a produtos ou peças que tenham sido:

- Afetado negativamente devido à utilização com dispositivos não autorizados fabricados ou distribuídos por partes não autorizadas pela Reach Surgical, Inc.
- Reparados ou alterados fora da fábrica da Reach Surgical, se afectarem a estabilidade ou fiabilidade do dispositivo, conforme determinado pela Reach Surgical.
- Sujeito a utilização incorrecta, negligência ou acidente.
- Utilizado de forma incompatível com a conceção, parâmetros de utilização, instruções e directrizes do produto ou com as normas funcionais, operacionais ou ambientais aceites pela indústria para produtos semelhantes.

Períodos de garantia

Conector de energia bipolar básico (OP-BPC): 1 ano para componentes e mão de obra.

Gerador (OP9): 1 ano para componentes e mão de obra.

Interruptor de pé/cabo de alimentação: 1 ano para componentes e mão de obra.

Esta garantia é o recurso exclusivo para o comprador original e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias de comercialização e adequação a um determinado fim. A Reach Surgical, Inc. não será responsável por quaisquer danos especiais, acidentais ou consequenciais, incluindo danos resultantes da perda de utilização, lucros, negócios ou boa vontade, exceto conforme expressamente previsto na lei aplicável.

A Reach Surgical, Inc. não autoriza qualquer pessoa a assumir qualquer responsabilidade adicional em relação à venda ou utilização dos seus produtos.

Não existem garantias que se estendam para além dos termos aqui indicados.

A Reach Surgical, Inc. reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem incorrer em qualquer obrigação de aplicar retroativamente essas alterações a produtos previamente vendidos ou fabricados.

Prezentarea generală

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații înainte de a utiliza acest dispozitiv. Acestea oferă instrucțiuni importante cu privire la funcționarea corectă, riscurile potențiale și posibilele deteriorări ale produsului sau ale persoanelor. În cazul oricărei situații anormale, respectați instrucțiunile specificate pentru a preveni vătămarea dumneavoastră sau deteriorarea echipamentului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate avea ca rezultat compromiterea siguranței, performanței, garanției sau întreținerii, pentru care producătorul nu poate fi tras la răspundere. Vă rugăm să citiți și instrucțiunile pentru Transductor și Foarfece cu ultrasunete înainte de a utiliza dispozitivul.

Acest document este conceput pentru a vă ajuta la utilizarea acestui dispozitiv. Nu este o referință pentru tehnicile chirurgicale.

Convenții standard utilizate: Mențiuni de precauție, AVERTISMENT și note

Vă rugăm să țineți cont de următoarele declarații, clasificate ca ATENȚIE, AVERTISMENT sau NOTĂ, care oferă îndrumări esențiale pentru a finaliza sarcinile în siguranță și în mod riguros. Aceste declarații pot fi găsite în întreaga documentație și trebuie citite înainte de a trece la următorul pas dintr-o procedură.

AVERTISMENT: Această mențiune evidențiază o procedură, o practică sau o condiție de funcționare sau de întreținere care, dacă nu este respectată cu strictețe, ar putea duce la vătămări corporale sau la pierderea vieții.

ATENȚIE: Această mențiune avertizează utilizatorul cu privire la o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la rănirea ușoară sau moderată a utilizatorului sau a pacientului, precum și la deteriorarea echipamentului sau a altor bunuri. Poate servi, de asemenea, drept avertisment împotriva practicilor nesigure. Aceasta include precauțiile necesare pentru utilizarea sigură și eficientă a instrumentului și grija necesară pentru a preveni daunele rezultate din utilizarea corectă sau necorespunzătoare.

NOTĂ: Această afirmație indică o practică de operare sau o condiție care este esențială pentru executarea eficientă a unei sarcini.

Descriere

Instrumentul electrochirurgical ENER REACH (denumit în continuare "dispozitivul") este utilizat în sălile de operații medicale pentru proceduri chirurgicale de tăiere, coagulare a țesuturilor umane și ligaturarea vaselor. Acesta dispune de două sloturi separate: unul pentru energia ultrasonică și celălalt pentru ieșirea formei de undă de frecvență radio.

În modul de radiofrecvență, Generator furnizează diferite scheme de energie în funcție de instrumentul/dispozitivul de electrochirurgie conectat. Atunci când este conectat un instrument bipolar avansat, Generator livrează forme de undă de radiofrecvență pentru sigilarea vaselor arteriale și venoase, a limfatice și a fasciculelor de țesut cu diametrul de până la 7 mm. Atunci când este conectat un instrument bipolar de bază, este emisă energie de putere constantă pentru tăierea și coagularea țesuturilor moi.

În modul de ieșire a energiei ultrasonice, utilizând TRA6 Transductor în combinație cu Bisturiu de unica folosință cu ultrasunete CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD, dispozitivul taie țesuturile moi care necesită controlul sângerării și daune termice minime și sigilează vasele cu un diametru maxim de 5 mm. Atunci când este conectat cu Foarfece cu ultrasunete de unică folosință SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 și SRE45, dispozitivul taie țesuturile moi care necesită controlul sângerării și daune termice minime și sigilează vasele cu un diametru maxim de 7 mm.

Utilizare preconizată

Dispozitivul furnizează energie de radiofrecvență pentru a acționa piesele de mână electrochirurgicale care sunt destinate să fie utilizate pentru a tăia și sigila vasele și pentru a tăia, apuca și diseca țesuturile.

În plus, Generator furnizează putere ultrasonică pentru a acționa instrumentele chirurgicale cu ultrasunete care sunt indicate pentru inciziile țesuturilor moi atunci când se dorește controlul sângerării și o leziune termică minimă.

Indicații

Dispozitivul furnizează energie de radiofrecvență pentru a acționa piesele de mână electrochirurgicale care sunt utilizate în timpul operațiilor deschise sau laparoscopice în chirurgia generală, pediatrică, ginecologică, urologică, toracică pentru a tăia și sigila vase de până la 7 mm inclusiv și pentru a tăia, apuca și diseca țesuturi.

În plus, Generator furnizează energie pentru a acționa instrumentele chirurgicale cu ultrasunete care sunt indicate pentru inciziile țesuturilor moi atunci când se dorește controlul sângerării și o leziune termică minimă. Instrumentele chirurgicale cu ultrasunete pot fi utilizate ca adjuvant sau înlocuitor al electrochirurgiei, al laserelor și al bisturiului de oțel pentru tăierea și/sau coagularea țesuturilor în intervențiile chirurgicale deschise sau laparoscopice în chirurgie generală, pediatrică, ginecologică, urologică, toracică, precum și pentru sigilarea și secționarea vaselor limfatice.

Utilizatorul vizat

Dispozitivul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății pentru aplicații chirurgicale.

Mediul de utilizare preconizat

Dispozitivul este destinat utilizării într-un spital.

Populația de pacienți prevăzută

Acest dispozitiv este potrivit pentru pacienții cu vârsta de 3 ani și peste care necesită proceduri chirurgicale care implică incizii ale țesuturilor moi cu control al sângerării și leziuni termice minime.


Beneficiu clinic

Dispozitivul poate fi utilizat în siguranță și în mod eficient pentru ligatura și divizarea vaselor, a pachetelor de țesuturi și a limfatice.

Contraindicații

Acest dispozitiv este contraindicat pentru inciziile osoase, ocluzia tubară contraceptivă și procedurile de coagulare. De asemenea, nu este destinat utilizării în neurochirurgie.

Compoziția sistemului

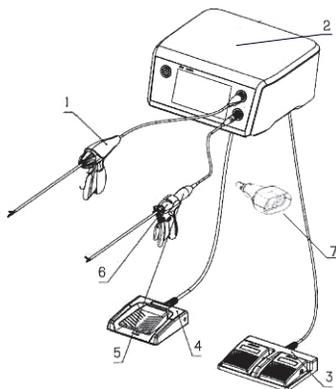

[01] Piese de mână pentru electrochirurgie	[02] OP9 Generator
[03] Pedala ultrasunete	[04] Pedala electrochirurgicală
[05] Transductor	[06] Foarfece cu ultrasunete
[07] Convertor bipolar pentru electrochirurgie	

[01] Piesă de mână electrochirurgicală

Piesa de mână electrochirurgicală, conectată la un Generator, este operată de chirurg în timpul procedurii. Aceasta aplică energie electrochirurgicală RF pe țesutul dintre cele Fălci pentru a coagula sau sigila. Instrumentul include, de asemenea, o lamă pentru divizarea țesutului. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Consultați instrucțiunile pentru informații detaliate.

[02] OP9 Generator

Aparatul Generator furnizează atât energie electrochirurgicală, cât și energie de terapie cu ultrasunete prin porturi de conectare a instrumentelor separate. Acesta este alcătuit dintr-un șasiu, o carcasă, o placă electronică, un ecran tactil LCD, un comutator de alimentare și interfețe pentru conectarea accesoriilor. Model: OP9

[03] Pedala ultrasunete

Utilizat pentru a controla ieșirea pornit/oprit a energiei ultrasonice cu două comutatoare ("MIN" și "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Pedala electrochirurgicală

Utilizat pentru a controla ieșirea de energie de înaltă frecvență cu un singur comutator.

Model: OP-FSS

[05] Transductor

Transductor convertește energia electrică de la un Generator compatibil în mișcare mecanică pentru lamele instrumentului. Este un instrument reutilizabil, cu o durată de viață limitată. Aparatul Transductor este nesteril și trebuie sterilizat conform instrucțiunilor înainte de utilizare. Consultați instrucțiunile TRA6 Transductor pentru informații detaliate.

Model: TRA6.

[06] Foarfece cu ultrasunete

Foarfece cu ultrasunete utilizează mișcarea mecanică de la Transductor și furnizează energie ultrasonice pentru tăierea sau coagularea țesuturilor. Trebuie să se acorde atenție, deoarece vibrația mecanică nu este detectabilă și ar putea afecta în mod neintenționat zone care nu sunt vizate. Aparatele Foarfece cu ultrasunete sunt sterilizate cu oxid de etilenă. Dacă termenul de valabilitate este depășit sau dacă ambalajul de sterilizare este deteriorat, Foarfece cu ultrasunete nu trebuie utilizat și trebuie eliminat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale Foarfece cu ultrasunete pentru informații detaliate.

Următoarele Foarfece cu ultrasunete sunt compatibile cu OP9 Generator:

Seria PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Seria SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Seria SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Conector bipolar pentru electrochirurgie

Utilizat pentru a conecta Instrumente electrochirurgicale bipolar de bază la Generator pentru coagularea țesuturilor.

Model: OP-BPC

Generator Panou frontal

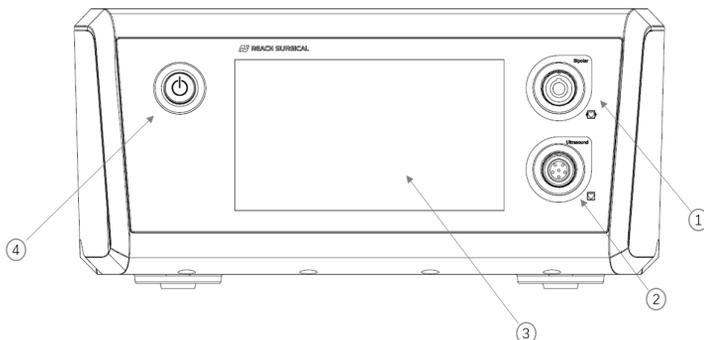

[01] Soclu electrochirurgical

Utilizat pentru a conecta conectorul bipolar avansat Instrumente electrochirurgicale sau conectorul bipolar pentru electrochirurgie.

[02] Transductor priză

Conectează Transductor la Generator.


[03] Ecran tactil LCD

Afișează informații despre sistem și servește drept interfață pentru reglarea comenzilor și a setărilor.

[04] Butonul de pornire

Apăsați pentru a porni Generator; apăsați și mențineți apăsat pentru a-l opri.

Generator Panou spate

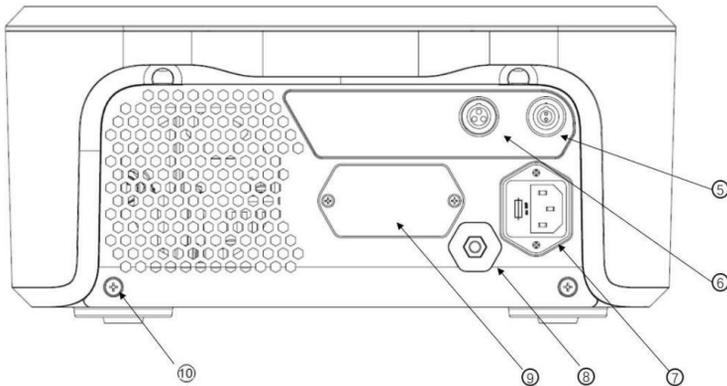

[05] Priză electrochirurgicală pentru întreprător de picior

Priză rotundă pentru conectarea comutatorului de picior electrochirurgical.

[06] Soclu pentru comutatorul de picior cu ultrasunete

Priză rotundă pentru conectarea întreprătorului cu ultrasunete cu picior.

[07] Priză de alimentare

Conectează cablul de alimentare la Generator.

[08] Port de egalizare a potențialului

În cazul în care împământarea prizei de alimentare este incertă, acest port permite conectarea la pământul protejat.

[09] Interfață de expansiune

Se utilizează pentru extinderea funcțiilor și pentru întreținere.

[10] Gaură de montare

Instrucțiuni de utilizare

Consultați instrucțiunile furnizate pentru mediul de operare.

Despachetarea

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos la primirea componentelor.

- Verificați dacă există deteriorări vizibile în timpul transportului. În cazul în care se constată deteriorări, contactați Reach Surgical, Inc. sau agentul local pentru asistență.

Componentele incluse în (Pentru specificații tehnice detaliate și coduri de produs, consultați capitolul "Condiții tehnice ale sistemului"):

Model	Descriere	Componenta
OP9	Generator	Generator, Cablu de alimentare, Instrucțiuni
TRA6	Transductor	Transductor cu cablu
OP-FSD	Comutator cu ultrasunete pentru picior	/
OP-FSS	Comutator bipolar cu piciorul	/
OP-BPC	Conector de bază pentru energie bipolară	/

Precauții de siguranță

- În timpul inspecției echipamentului, țineți capătul distal al instrumentului departe de alte aparate, de câmpurile chirurgicale, de pacient sau de orice alte obiecte pentru a evita rănierea.
- Implementați măsurile de siguranță necesare în prezența vaporilor, respectând procedurile și reglementările spitalului.

Energie cu ultrasunete cu PD Seria Foarfece cu ultrasunete

- Conectați Transductor, comutatorul de picior și seria PD Foarfece cu ultrasunete la Generator.
- După ce ați trecut testul Transductor și Foarfece cu ultrasunete, reglați nivelul de putere (1-5) cu ajutorul pictogramelor +/- de pe ecranul LCD.
- Apăsați butonul "Min" de pe Foarfece cu ultrasunete sau pedala Min de pe pedală pentru a activa energia ultrasonică la nivelul de putere presetat.
- Apăsați butonul "Max" de pe Foarfece cu ultrasunete sau pedala Min de pe pedală pentru a livra nivelul maxim de putere a energiei.
- Eliberați cheia sau întreprătorul de picior pentru a opri producția de energie.

Energie cu ultrasunete cu SRB/SRE Seria Foarfece cu ultrasunete

- După ce ați trecut testul Transductor și Foarfece cu ultrasunete, reglați nivelul de putere (1-5) cu ajutorul pictogramelor +/- de pe ecranul LCD.
- Apăsați butonul Buton Energie de pe instrument sau butonul Min de pe pedală pentru a activa energia ultrasonică la nivelul de putere presetat.
- Apăsați butonul Buton Energie cu Hemostază avansată de pe instrument pentru a activa modul Advanced Hemostasis.
- Eliberați butonul de pe Foarfece cu ultrasunete sau butonul de pe Pedala pentru a opri furnizarea de energie.

Energie bipolară electrochirurgicală cu instrumente bipolare avansate

- Afișajul LCD afișează pictograma bipolară avansată și pictograma de control manual reglabil.
- Trageți de Pârghie de pe instrument sau apăsați pedala de pedală pentru a activa frecvența radio.
- Aparatul Generator va opri ieșirea de energie atunci când închiderea este finalizată, indicată de pictograma completă de pe ecran.
- În cazul în care ligatura este incompletă, se va auzi un semnal sonor de avertizare și se va afișa o pictogramă de avertizare.

Energie electrochirurgicală bipolară cu instrument electrochirurgical bipolar

- Ecranul LCD afișează valoarea puterii, pictogramele reglabile și barele nivelului de putere.
- Setările de putere variază de la 1-95 wați, cu creșteri reglabile.
- Selectați setarea de putere de ieșire dorită: Low (15 wați), Medium (30 wați) sau High (60 wați).
- Apăsați butonul de pe comutatorul manual sau pedala de pedală pentru a activa frecvența radio.
- Eliberați butonul pentru a dezactiva ieșirea de energie.

Recomandări de setare

Setări de efect	Gama de setări de putere	Aplicație clinică	Dispozitiv optimizat
Scăzut	1-15 wați	Cum ar fi nervii / coloana vertebrală, mâinile și chirurgia facială	- Dispozitive cu suprafețe mai mici - Forceps cu micro vârf (0,4 - 2,2 mm)
Mijlocul	16-40 wați	Cum ar fi coagularea în timpul capului / gâtului, coloanei vertebrale și anatomiei.	- Dispozitive cu suprafață medie - Forceps cu micro vârf (1,0 - 2,2 mm) - Forceps laparoscopic mic cu cap plat - Foarfecă bipolară
Mare	45-95 wați (creșteri de 5 wați)	Cum ar fi chirurgia capului/ gâtului și chirurgia plastică (similar cu efectul mediu, dar cu efect mai rapid)	- Dispozitive cu suprafețe mari - Forceps laparoscopic mare cu cap plat

NOTĂ: Acest dispozitiv nu este compatibil cu electrodul neutru.

NOTĂ: Foarfece cu ultrasunete și bisturiul electric RF sunt piese aplicate în contact cu pacientul


Utilizarea Generator

Porniți dispozitivul

- Sistemul este gata de funcționare după ce a fost pornit. Atunci când Generator este conectat la rețeaua de alimentare și când lumina întrerupătorului de așteptare este aprinsă, sistemul este gata de utilizare.
- După apăsarea butonului Standby, se va afișa următoarea imagine:




- Dacă nici un Transductor sau Foarfece cu ultrasunete nu este conectat la Generator sau dacă acestea sunt conectate incorect, se va afișa următoarea imagine:

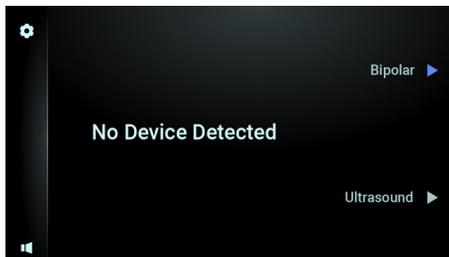


Utilizarea instrumentului cu ultrasunete (Transductor și Foarfece cu ultrasunete)

Atunci când sunt detectate Transductor și Foarfece cu ultrasunete, se va afișa următoarea imagine.

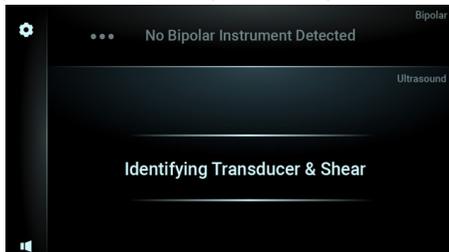


NOTĂ: dacă durata de utilizare rămasă a Transductor este mai mică de 10, se va afișa următoarea imagine. Vă rugăm să acordați atenție numărului de utilizări rămase, deoarece Transductor trebuie înlocuit atunci când numărul a devenit zero.

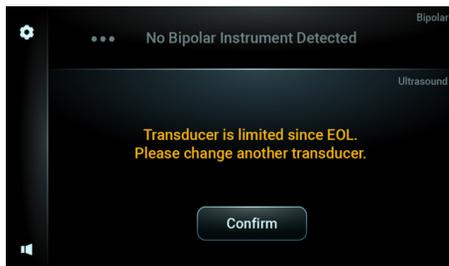


În continuare, va fi afișată următoarea imagine, vi se va cere să apăsați orice buton de pe Foaarce cu ultrasunete pentru a începe testul Foaarce cu ultrasunete cu Fălci deschis.




Apăsați orice buton și se va afișa următoarea imagine.

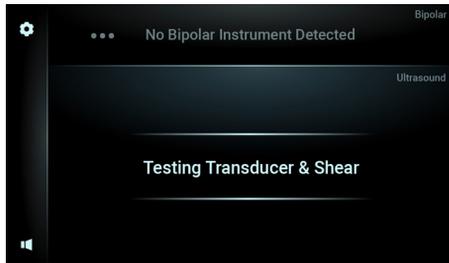


Când testul Transductor eșuează, se afișează următoarea imagine:

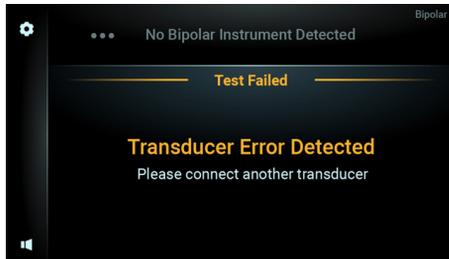


Atunci când testul Foaarce cu ultrasunete eșuează, se afișează următoarea imagine:

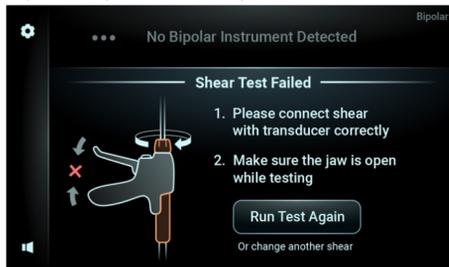

Atunci când testul Transductor și Foaarce cu ultrasunete trece, se va afișa următoarea imagine:

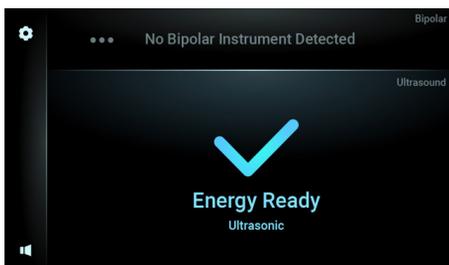

Următorul ecran de lucru va fi afișat la conectarea Foaarfece cu ultrasunete fără funcția Advanced Hemostasis.

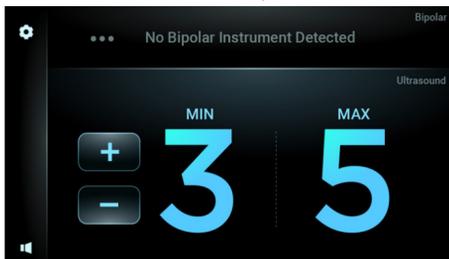


La conectarea SRE Foaarfece cu ultrasunete cu Advanced Hemostasis se va afișa următorul ecran de lucru.




Modul de ieșire va fi evidențiat atunci când este activat.

Utilizarea instrumentului electrochirurgical


Atunci când sunt detectate Transductor și Foaarfece cu ultrasunete, se va afișa următoarea imagine.

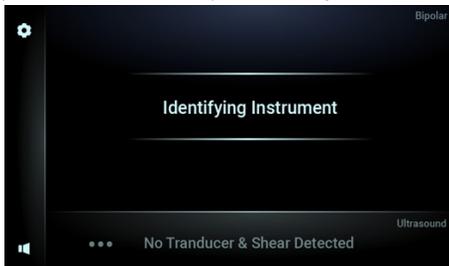

Atunci când testul instrumentului electrochirurgical trece, se va afișa următoarea imagine:

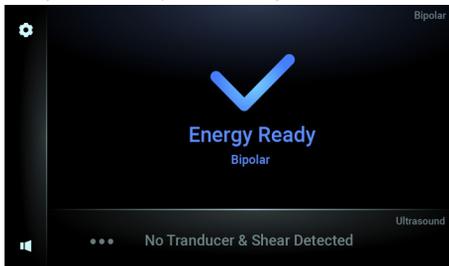

La conectarea la un instrument bipolar avansat se va afișa următorul ecran de lucru.

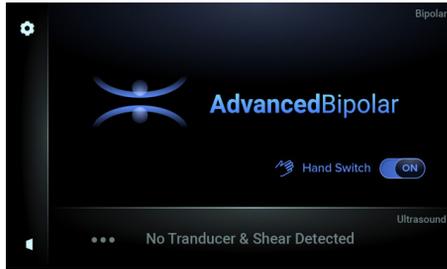

Următorul ecran de lucru va fi afișat la conectarea la un instrument bipolar obișnuit.




Utilizarea instrumentului electrochirurgical și Foaarfece cu ultrasunete

Vă rugăm să rețineți că atunci când Generator este conectat atât la un instrument electrochirurgical bipolar, cât și la un Foaarfece cu ultrasunete, sistemul funcționează într-un mod cu ecran divizat pentru a afișa starea curentă. Dispozitivul care are prioritate va fi primul care va activa energia. Această stare de ecran divizat este prezentată mai jos:



Setări de sistem


Pentru a accesa setările sistemului, faceți clic pe pictograma de setări situată în colțul din stânga sus al ecranului. Sunt disponibile următoarele opțiuni de setare a sistemului:




Limba: Dacă faceți clic pe elementul Language (Limba), se va afișa ecranul de selectare a limbii:




Configurația utilizatorului: Dacă faceți clic pe elementul User Configuration (Configurare utilizator), se va afișa ecranul de configurare a utilizatorului:

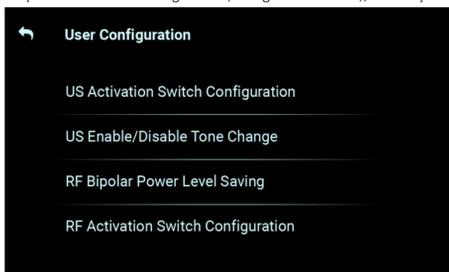

Preferințe de sistem: Dacă faceți clic pe elementul System Preferences (Preferințe sistem), se va afișa ecranul cu preferințele sistemului:

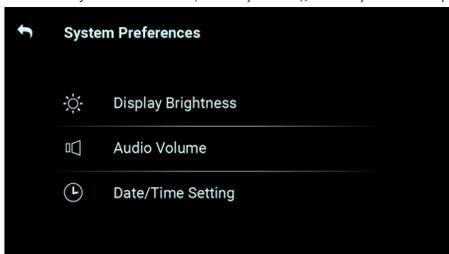

Informații despre sistem: Faceți clic ușor pe elementul System Info pentru a afișa ecranul cu informații despre sistem:

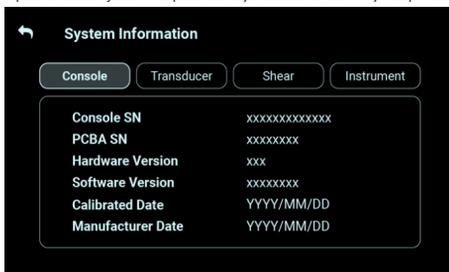

Diagnosticare: Dacă faceți clic pe elementul Diagnostics (Diagnosticare), se va afișa ecranul de diagnosticare:



Pentru a ieși din setările sistemului și a reveni la modul de așteptare al sistemului, apăsați pictograma "Return" (Întoarcere) situată în colțul din stânga sus al ecranului.

Oprirea sistemului

Urmați pașii de mai jos pentru a opri sistemul în siguranță:

Apăsăți butonul de așteptare: Localizați butonul Standby de pe Generator și apăsați-l pentru a iniția procesul de oprire.

Deconectați Transductor și Foarfece cu ultrasunete: Deconectați cu grijă Transductor și Foarfece cu ultrasunete de la sistem. Consultați instrucțiunile de operare pentru manipularea corectă a Transductor și Foarfece cu ultrasunete.

Curățați: Curățați Generator, comutatorul de picior și Transductor în conformitate cu procedurile specificate în capitolul "Întreținere".

Depanare

Aparatul Generator încorporează diverse semnale de alertă și coduri de eroare pentru a ajuta la identificarea și diagnosticarea defecțiunilor componentelor. Este important de reținut că aceste semnale și coduri sunt concepute pentru a sprijini judecata și observația clinică, mai degrabă decât pentru a le înlocui.

Alertă sonoră

Starea de lucru	Tip de sunet	Cauză posibilă și acțiune
Stare de autoverificare	Sunet normal	/
	Sunet anormal	A fost detectată o defecțiune hardware. Vă rugăm să contactați producătorul pentru asistență pentru reparații.
Utilizarea instrumentului cu ultrasunete	Nivel maxim de sunet	/
	Sunet de nivel minim	/
	Sunet anormal	Foarfece cu ultrasunete a intrat în contact cu un țesut excesiv. Reduceți contactul țesutului cu Foarfece cu ultrasunete. Dacă persistă un sunet continuu, îndepărtați cu grijă orice țesut care se poate acumula în jurul capătului Foarfece cu ultrasunete. A fost detectată o defecțiune la Transductor și/sau Foarfece cu ultrasunete. Vă rugăm să vă adresați producătorului sau să contactați serviciul de asistență pentru asistență suplimentară.
	Sunet AVANSAT	/
	Sunetul ITS	/
Activarea instrumentului electrochirurgical	Ton de avertizare bipolară avansată	/
	Sunet bipolar normal	/
	Sunet anormal	Tăiere nereușită: În cazul în care țesutul contactat de instrument nu îndeplinește cerințele de tăiere, reduceți cantitatea de țesut în contact cu instrumentul. Dacă tonul de defecțiune persistă, îndepărtați cu atenție orice țesut care se poate acumula la capătul instrumentului. Defecțiune hardware: Această eroare indică o posibilă defecțiune a circuitului sau a conectorului. În cazul oricărei defecțiuni sau erori, se recomandă să consultați producătorul sau să solicitați asistență pentru o îndrumare și o rezolvare corespunzătoare.

Coduri de eroare

Platforma energetică Generator este echipată cu un sistem cuprinzător de identificare a defecțiunilor care constă în alerte și erori de sistem. Atunci când este detectată o defecțiune, Generator emite un semnal sonor de avertizare, afișează un semnal de avertizare pe panoul de control și afișează un cod de defecțiune corespunzător pe ecranul LCD. Urmați pașii descriși mai jos pentru a rezolva problema:

Tablelul codurilor de eroare

Cod de eroare	Mesaj de eroare corespunzător
Avertisment	Vă rugăm să conectați corect Foarfece cu ultrasunete cu Transductor
Avertisment	Asigurați-vă că Fălci sunt deschise în timpul testării
Avertisment	Foarfece cu ultrasunete Eroare detectată
Avertisment	Timpul rămas din Transductor este zero
Avertisment	Vă rugăm să activați doar un singur buton la un moment dat
Avertisment	Vă rugăm să reduceți forța aplicată la Foarfece cu ultrasunete
Avertisment	Butonul Foarfece cu ultrasunete și pedala de comandă nu pot fi închise simultan
Avertisment	Buton blocat, vă rugăm să verificați și să continuați
Avertisment	Reglați Fălci sau fixați mai puțin țesut
Avertisment	Scoateți dispozitivul din țesuturi
Eroare de sistem	Eroare de sistem
Eroare de sistem	Autoverificare eșuată

Dacă pe ecran apare o eroare în timpul testării, efectuați următoarele acțiuni:



- Asigurați-vă că cablul Transductor este introdus complet în direcția corectă.
- Verificați dacă Foarfece cu ultrasunete a fost strâns corect sau dacă s-a acumulat țesut în jurul capătului Foarfece cu ultrasunete. Reglați etanșeitatea

Foarfece cu ultrasunete și îndepărtați cu atenție orice acumulare de țesut în jurul carcasei Foarfece cu ultrasunete. (În cazul în care testul este inițiat înainte de operațiune, asigurați-vă că Foarfece cu ultrasunete este îndreptat spre aer. Dacă se utilizează Foarfece cu ultrasunete, confirmați că falca de prindere este deschisă și nu este în contact cu niciun obiect).

- Dacă problema persistă, luați în considerare înlocuirea Transductor sau Foarfece cu ultrasunete.
- Treceți la modul de lucru al echipamentului.

NOTĂ: Este posibil ca Transductor să nu funcționeze corect dacă temperatura sa depășește limita specificată. În astfel de cazuri, utilizați imediat un alt Transductor pentru recuperare sau urmați pașii de mai jos pentru a determina cauza erorii și pentru a explora metodele opționale de recuperare:

- Se lasă Transductor să se răcească la temperatura camerei timp de cel puțin 45 de minute. Această metodă de răcire se aplică și în cazul în care Transductor se încinge după o funcționare prelungită la putere mare.
- În cazul în care nu este evidentă supraîncălzirea Transductor și problema rămâne nerezolvată, contactați reprezentanții de întreținere ai producătorului pentru asistență.
- În afară de siguranțe, nu există piese care pot fi reparate de către utilizator în Generator. Pentru orice cerințe de înlocuire sau de service, vă rugăm să luați legătura cu personalul de service care este instruit și autorizat de Reach Surgical, Inc. sau cu reprezentantul dvs. local.

Întreținerea și actualizările aparatului Generator trebuie efectuate exclusiv de către personalul de service instruit și autorizat de Reach Surgical.

Ar trebui să se ia în considerare măsuri de precauție în materie de securitate cibernetică pentru a preveni potențialele amenințări. Următoarele incidente prezintă riscuri de securitate cibernetică:

- Acces neautorizat la orice produs care nu este legat de dispozitiv.
- Orice comunicare neautorizată în rețea cu dispozitivul.
- Actualizări de firmware sau software care nu au fost autorizate de Reach Surgical.

În cazul oricăruia dintre incidentele de mai sus, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări al Reach Surgical, Inc. sau să contactați direct Reach Surgical, Inc. la Reachquality@reachsurgical.com.

Întreținere

Curățarea și dezinfectarea conectorului Generator și a conectorului de bază pentru energie bipolară

Curățare

Curățați ecranul LCD Generator și conectorul bipolar de bază în conformitate cu procedurile și reglementările spitalului. Înainte de curățare, asigurați-vă că alimentarea principală a Generator este deconectată și că cablul de alimentare este scos din unitatea de ieșire.

AVERTISMENT: Procedurile de curățare trebuie urmate cu atenție pentru a evita deteriorarea aparatului Generator, provocarea unui șoc electric sau crearea unui pericol de incendiu. Nu vărsați sau stropiți lichide pe sau în Generator și nu îl scufundați în lichid.

Urmați acești pași pentru curățare:

- Pregătiți un detergent cu pH neutru sau un detergent enzimatic cu pH neutru, așa cum este specificat de producătorul detergentului.
- Folosind o cârpă curată, moale și îmbibată cu o cantitate mică de soluție de curățare, ștergeți manual toate suprafețele, inclusiv ecranul Generator.
- Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă curată, moale, înmuiată în apă caldă de la robinet.
- În cele din urmă, ștergeți toate suprafețele cu o cârpă curată și moale pentru a vă asigura că sunt uscate.

Dezinfecție

- În cazul în care Generator este contaminat cu sânge sau fluide corporale, acesta trebuie dezinfectat înainte de a fi reutilizat. Următorii dezinfectanți chimici au fost validați pentru a fi utilizați pe Generator: alcool izopropilic 70%, hipoclorit de sodiu 6%, peroxid de hidrogen 10%.
- Urmați recomandările producătorului în ceea ce privește utilizarea, concentrația și timpul de contact al dezinfectanților.
- Asigurați-vă că dezinfectoarele sunt configurate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Curățarea comutatorului de picior

Curățați pedala de comandă și cablul după fiecare utilizare folosind următoarea procedură:

- Deconectați comutatorul de picior de la Generator.
- Pregătiți un detergent enzimatic cu pH neutru conform instrucțiunilor producătorului.
- Conectați bine cablul cu întrerupătorul de picior și scufundați-le în soluția de curățare timp de 2 minute.

NOTĂ: Asigurați-vă că cablul de întrerupător de picior utilizat pentru a conecta Generator este complet uscat pentru a preveni activarea accidentală.

- După imersie, frecăți manual pedala de comandă și cablul cu o perie cu peri moi în soluția de curățare.
- Clătiți temeinic pedala de comandă și cablul cu apă caldă de la robinet timp de cel puțin 1 minut.

ATENȚIE: Păstrați cablul și întrerupătorul de picior bine conectate în timpul clătirii.

- Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă curată și moale.

AVERTISMENT: Nu utilizați un aparat de curățare cu ultrasunete pentru a curăța comutatorul de picior.

AVERTISMENT: Nu porniți sursa de alimentare a aparatului Generator înainte de a conecta cablul de alimentare cu curent alternativ. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt uscate înainte de asamblare.

Curățarea și dezinfectarea aparatului Transductor

Transductoare sunt livrate nesterile și necesită o curățare și o sterilizare temeinică înainte de fiecare utilizare.

Curățarea:

Curățați temeinic transductoarele în conformitate cu următoarele etape:

- Clătiți transductorul cu partea cu șurub în sus și curățați-l cu o perie cu peri moi cu apă purificată până când nu mai există pete pe suprafață;
- Transductorul poate fi înmuiat într-un detergent enzimatic cu pH neutru (ingrediente principale: protează, lipază, amilază, celuloză, pectinază și alte enzime biologice, agent tensioactiv ecologic, factor de prevenire a ruginii și stabilizator) pentru o perioadă de până la 10 minute și la o temperatură adecvată de 15 °C-65 °C. Raportul dintre detergent și apa purificată este de 1:400;
- Clătiți transductorul cu partea cu șurubul în sus cu apă purificată, timp de 2 minute;
- Curățați Șurubul de conectare, suprafața de montare a Bisturiului și Conectorul cu un șervețel cu alcool.
- Înmuiați transductorul în alcool medicinal de 75%, țineți-l și agitați-l de 30 de ori;
- Clătiți transductorul cu partea cu șurubul în sus cu apă purificată, timp de 2 minute.

Notă: Nu se recomandă utilizarea aparatelor de curățare cu ultrasunete pentru transductor.

Uscare:

Temperatura de uscare: 50-70 °C, Timp de uscare: 30 min.

Sterilizarea transductoarelor:

În urma etapelor de curățare și de uscare de mai sus, transductorul trebuie sterilizat printr-una dintre metodele enumerate mai jos.

Sterilizare cu abur (121 °C)

- Tecile trebuie instalate înainte de sterilizare. Transductorul trebuie să fie înfășurat în timpul sterilizării. Introduceți Transductoarele într-un vas de sterilizare cu abur la temperaturi înalte pentru sterilizare, cu o temperatură de 121 °C și cu o durată de 30 min.
- Temperatura de uscare: 50-70 °C, Timp de uscare: 30 min.

Sterilizare cu abur (134 °C)

- Tecile trebuie instalate înainte de sterilizare. Transductorul trebuie să fie înfășurat în timpul sterilizării. Introduceți Transductoarele într-un vas de sterilizare cu abur la temperaturi înalte pentru sterilizare, cu o temperatură de 134 °C și cu o durată de 10 min.
- Temperatura de uscare: 50-70 °C, Timp de uscare: 30 min.

Teste de siguranță și funcționale

Asigurați punerea în aplicare a testelor de siguranță și a testelor funcționale pentru Transductor, Generator și comutatorul de picior în conformitate cu procedurile și reglementările spitalului. Pentru testele de siguranță și de funcționare ale altor componente utilizate de mai mulți pacienți, consultați instrucțiunile de utilizare specifice fiecărei componente.

Test de siguranță

Generator: Tehnicienii certificați de spital trebuie să efectueze un test de curent de scurgere.

Comutator de picior: Inspectați pedala, conectorul de cablu și cablul pentru a vedea dacă există fisuri sau deteriorări. Înlocuiți orice componentă deteriorată.

Alte componente: Verificați toate celelalte componente conform instrucțiunilor din instrucțiunile de utilizare respective.

Test funcțional

Modul cu ultrasunete

- Pregătiți setul complet de PD Foarfece cu ultrasunete și conectați Transductor conform instrucțiunilor furnizate în Capitolul II - Instalarea și funcționarea echipamentului.
- Verificați dacă este posibil să intrați în starea de lucru. Diferite Foarfece cu ultrasunete pot avea interfețe de intrare diferite. Consultați partea 1, secțiunea 3 din capitolul 2 pentru instrucțiuni detaliate.
- Confirmați afișarea nivelului de putere MIN 3 și a nivelului de putere MAX 5.
- Apăsăți butoanele de mărire și micșorare a puterii pentru a vă asigura că nivelul de putere MIN poate fi reglat de la nivelul 1 la 5.
- Porniți aparatul Generator și comutați-l în modul de lucru cu ultrasunete. Verificați conectarea corectă a aparatelor Transductor și Foarfece cu ultrasunete.
- Cu falca deschisă, apăsați butonul "MAX" de pe întrerupătorul de picior. Ecranul LCD ar trebui să afișeze nivelul de putere MAX "5" și ar trebui să se audă un ton de activare.
- Cu falca deschisă, apăsați butonul "MIN" de pe întrerupătorul de picior. Ecranul LCD ar trebui să afișeze nivelul de putere MIN și ar trebui să se audă un ton de activare.

AVERTISMENT: Înainte de a activa sistemul, asigurați-vă că maxilarul este ținut departe de țesuturi, alte instrumente sau orice alte obiecte pentru a preveni rănirea utilizatorului.

Modul electrochirurgical bipolar

- Conectați instrumentul electrochirurgical bipolar avansat/instrumentul bipolar de bază în conformitate cu instrucțiunile.
- Verificați dacă sistemul poate intra în interfața de lucru. Modul bipolar de bază ar trebui să afișeze pictograma "30 power level", în timp ce modul bipolar avansat ar trebui să afișeze pictograma "advanced bipolar".
- Atingeți ușor tastele de creștere și descreștere a puterii în modul bipolar de bază pentru a confirma că nivelul de putere poate fi reglat între 1 și 95. Atingeți barele Low, Medium și High pentru a comuta direct între 15, 30 și 60.
- Opriți aparatul Generator și așteptați 5 secunde. Apoi, porniți sursa de alimentare a Generator și așteptați 10 secunde. Verificați dacă modul bipolar de bază afișează interfața "30 power level", iar modul bipolar avansat afișează interfața "advanced bipolar". Verificați dacă Generator este activat în conformitate cu cerințele prestabilite.
- Conectați dispozitivul bipolar avansat și cel de bază Instrumente electrochirurgicale și apăsați întrerupătorul unic de picior. Verificați dacă pe panoul de comandă apar indicații intermitente privind nivelul de putere și ascultați dacă se aude un sunet de activare.

AVERTISMENT: Înainte de a activa sistemul, este strict interzis să se permită orice contact al Foarfece cu ultrasunete cu țesuturile, alte instrumente sau orice alte obiecte pentru a preveni rănirea utilizatorului.

Avertismente și precauții

Legate de sistem

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și respectați ghidurile spitalului privind practica clinică pentru chirurgie cu ultrasunete, electrochirurgie, ginecologie și laparoscopie.
- Dispozitivele minim invazive pot varia de la un producător la altul. În cazul în care instrumente minim invazive și accesorii de la diferiți producători sunt utilizate în același timp într-o intervenție chirurgicală, verificați compatibilitatea instrumentelor și accesorilor înainte de operație și verificați dacă accesoriile introduse în corpul uman au o suprafață aspră, o muchiie ascuțită sau o proeminență care poate cauza riscuri pentru siguranță.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării numai de către chirurghi instruiți și licențiați. Nu utilizați dispozitive electrochirurgicale decât dacă ați fost instruit în mod corespunzător în utilizarea lor pentru procedura specifică pe care va trebui să o finalizați. Utilizarea neinstruită a acestui dispozitiv poate provoca leziuni grave neintenționate pacientului, inclusiv perforarea intestinului și necroza inconștientă și ireparabilă a țesuturilor.
- Nu deschideți carcasa Generator fără permisiune pentru a evita posibilele pericole de șoc. Orice reparație și actualizare a instrumentului trebuie efectuată de către o persoană de service instruită și autorizată de Reach Surgical, Inc. Nu utilizați acest instrument în alte scopuri decât pentru intervenții chirurgicale medicale.
- O înțelegere temeinică a principiilor și tehnicilor implicate în procedurile cu laser, electrochirurgicale și cu ultrasunete este esențială pentru a preveni riscurile de șoc și arsură atât pentru pacient, cât și pentru personalul medical, precum și deteriorarea acestui dispozitiv sau a altor dispozitive medicale. Izolația electrică sau împănțarea nu trebuie să fie compromisă. Nu scufundați dispozitivele electrochirurgicale în lichide decât dacă designul impune acest lucru, iar pe etichetă se menționează că acestea trebuie scufundate.
- Chirurgia cu ultrasunete și electrochirurgia sigură și eficientă depind nu numai de proiectarea echipamentului, ci și în mare măsură de mulți factori controlați de operator. Pentru a îmbunătăți siguranța și eficacitatea, citiți, înțelegeți și respectați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
- La fel ca în cazul tuturor surselor de energie (electrochirurgicală, laser sau ultrasunete), trebuie să se ia în considerare riscurile cancerigene și infectioase pe care le pot prezenta numeroase subproduse tisulare, cum ar fi fumul și aerosolii. Precauțiile adecvate, cum ar fi ochelarii de protecție, măștile de filtrare și echipamentul eficient de evacuare a fumului trebuie respectate atât în procedurile deschise, cât și în cele endoscopice.
- După îndepărtarea dispozitivului, verificați dacă țesutul este hemostatic. Dacă nu există hemostază, trebuie utilizate metode adecvate pentru a obține hemostaza.
- Este posibil ca produsele fabricate sau distribuite de companii neautorizate de Reach Surgical, Inc. să nu fie compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unor astfel de produse poate duce la rezultate neașteptate și poate răni utilizatorul sau pacientul.
- Pentru a reduce riscul de interferențe, dispozitivul și carcasa trebuie conectate la un circuit de alimentare independent.
- Echipamentul nu este adecvat pentru utilizarea în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer sau cu oxigen sau protoxid de azot. Potential de scântei din cauza coliziunii cu alte dispozitive metalice. Scânteile pot aprinde gaze inflamabile, cum ar fi gazele de câmp.
- Trebuie să funcționeze în intervalul de temperatură de funcționare a mediului ambiant necesar.
- Tensiunea de ieșire a prizei trebuie să îndeplinească cerințele din Generator (capitolul "Condiții tehnice ale sistemului"). În cazul în care sursa de alimentare nu este conectată corect, aceasta poate deteriora Generator și poate provoca șocuri electrice sau pericole de incendiu.
- Nu utilizați prelungitoare pentru a evita riscurile de incendiu.
- Nu reduceți tonul de activare la un nivel inaudibil. Tonurile de activare pot fi observate de personalul echipei chirurgicale în timp ce Generator furnizează energie.
- S-a demonstrat că fumul generat în timpul electrochirurgiei este potențial dăunător pentru pacienți sau pentru personalul echipei chirurgicale. Sugați

- o ventilație adecvată cu un evacuator de fum chirurgical sau alte mijloace.
- Există unele componente ale aparatului integrat chirurgical cu ultrasunete Generator care sunt livrate nesterile (de exemplu, Transductor). Sterilizați produsul după cum este necesar înainte de a începe instalarea sistemului. Pentru instrucțiuni de curățare și sterilizare, consultați fiecare instrucțiune relevantă.
- Pentru a evita rănirea utilizatorilor sau a pacienților, Foaarce cu ultrasunete trebuie să evite alte dispozitive, câmpurile chirurgicale, pacienții sau alte obiecte înainte de a apăsa butonul de testare și în timpul verificării sistemului. Măsurile de siguranță în caz de aerosoli (în conformitate cu reglementările spitalului) trebuie implementate în metoda de inspecție și testare a sistemului.
- Nu aplicați o presiune prea mare asupra maxilarului pentru a evita inhibarea furnizării energiei ultrasunetice.
- Pentru a evita rănirea utilizatorului, lama trebuie să evite contactul cu țesutul, alte dispozitive sau alte obiecte înainte de a activa sistemul.
- Dacă lichidul este pulverizat sau turnat pe sau în Generator, sau dacă Generator este vărsat sau vărsat în lichid, acesta poate deteriora Generator și poate provoca șocuri electrice sau pericole de incendiu.
- Scănteia și încălzirea asociate cu tehnicile de închidere a vaselor pot servi ca surse de aprindere. Tifonul și un burete trebuie să rămână umede. Păstrați electrozii electrochirurgici departe de materialele combustibile și de mediile bogate în oxigen (O₂).
- În cazul în care există deteriorări semnificative la Transductor sau dacă unele piese prezintă semne de deteriorare după curățarea și dezinfectia de întreținere, aruncați-le. Piesele deteriorate sunt marcate în mod clar pentru a evita utilizarea greșită înainte de manipularea ulterioară.
- Deșeurile de plastic folosință și deșeurile electronice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările spitalului și nu trebuie aruncate la voia întâmplării pentru a evita poluarea mediului.
- Evitați să folosiți Generator în apropierea sau suprapus pe alte echipamente. Dacă este necesară utilizarea adiacentă sau suprapusă, monitorizați Generator și alte echipamente pentru a asigura funcționarea corectă.
- Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de operator. Pentru service, contactați reprezentantul de vânzări Reach Surgical sau personalul de service.
- Verificați toate dispozitivele conectate la sistem și conexiunile înainte de utilizare. Validați dacă dispozitivul funcționează conform destinației. O conexiune necorespunzătoare poate duce la formarea de arcuri electrice, scănteie, funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau rezultate chirurgicale neintenționate.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie să fie conectat numai la o sursă de alimentare cu pământ de protecție.
- Păstrați o distanță cât mai mare între Generator și alte dispozitive electronice (de exemplu, monitorare). Nu încrucișați sau legați firele electrice de dispozitivele electronice. Aparatul Generator poate provoca interferențe cu alte dispozitive electronice.
- Sistemul trebuie utilizat cu prudență în prezența stimulatoarelor cardiace interne și externe. Interferențele cauzate de utilizarea Instrumente electrochirurgicale pot face ca stimulatorul cardiac să intre într-o stare asincronă sau să împiedice complet funcționarea stimulaturilor cardiac. Atunci când dispozitivele de electrochirurgie sau de sigilare a țesuturilor sunt destinate utilizării la pacienții cu stimuloare cardiace, contactați producătorul stimulaturilor cardiac sau departamentul de cardiologie al spitalului pentru informații suplimentare.
- Aveți grijă dacă stiviți instrumente deasupra Generator sau dacă plasați Generator deasupra instrumentelor electrice. Aceasta este o configurație instabilă și nu asigură o răcire adecvată.
- În cazul în care Generator eșuează, aceasta poate cauza întreruperea operației. Trebuie să fie disponibil un sistem de rezervă.
- În cazul în care reglementările locale o cer, Generator trebuie conectat la conectorul echipotențial al spitalului cu ajutorul unui cablu echipotențial.
- În cazul în care sistemul și echipamentul de monitorizare fiziologică sunt utilizate simultan pe același pacient, orice electrod de monitorizare trebuie să fie plasat cât mai departe posibil de instrument.
- În modul bipolar de bază, alegeți cea mai mică putere de ieșire posibilă pentru efectul dorit.
- Defecțiunea echipamentului chirurgical de înaltă frecvență poate provoca o creștere neașteptată a puterii de ieșire.
- Conectorul electrochirurgical bipolar Generator și de bază poate fi invadat de apă sau de particule. În procesul de utilizare și de curățare, este necesar să se evite invazia apei sau a particulelor.
- Atunci când sistemul este utilizat în combinație cu un endoscop, acesta poate crește curentul de scurgere pe corpul pacientului. Acordați atenție în timpul procedurii.
- O notificare adresată utilizatorului și/sau pacientului că orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat către Reach Surgical, Inc. prin intermediul Reachquality@reachsurgical.com și către autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Legat de instrumente

În timpul procedurilor chirurgicale, este important să se știe că partea de capăt a instrumentului Foaarce cu ultrasunete, Foaarce cu ultrasunete și Tijă poate avea temperaturi ridicate atunci când ultrasunetele sau electrocauterul bipolar sunt aplicate pe țesut pentru perioade lungi de timp. Pentru a asigura siguranța, este esențial să se evite orice contact accidental între aceste componente ale instrumentului și țesuturi, draperii chirurgicale, halate chirurgicale sau orice alte zone fără legătură pe parcursul procedurii.

În plus, este esențial să se dea dovadă de precauție atunci când se poziționează instrumentul bipolar. În mod specific, acesta nu trebuie plasat în apropierea sau în contact cu materialele combustibile, cum ar fi tifonul sau câmpurile chirurgicale. Instrumentele bipolare utilizate în acest context pot genera căldură în timpul utilizării, ceea ce ar putea duce la un potențial pericol de incendiu. Atunci când electrochirurgul bipolar Generator nu este utilizat, acesta trebuie depozitat în mod corespunzător în manșonul de protecție sau păstrat la o distanță sigură față de pacient, de membrii echipei chirurgicale și de orice materiale combustibile.

NOTĂ: Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare respective pentru avertismente și precauții suplimentare.

Informații EMC

Produsul a trecut testul de compatibilitate electromagnetică, care îndeplinește cerințele de limitare ale standardului IEC60601-1-2 pentru echipamente medicale. Aceste restricții asigură o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în instalațiile medicale normale.

Compoziția produsului

Număr de serie	Denumirea părții	Model/Version nr.	Observații
1	Instrument electrochirurgical	OP9	/
2	Transductor pentru echipamente chirurgicale cu ultrasunete	TRA6	Utilizare compatibilă
3	Foaarce cu ultrasunete Sistem pentru utilizare unică Foaarce cu ultrasunete	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Utilizare compatibilă
4	Unitate chirurgicală cu ultrasunete de înaltă frecvență de unică folosință Sigilator de țesut	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Pedala ultrasunete	OP-FSD	/
6	Pedala electrochirurgical	OP-FSS	/
7	Conector bipolar pentru electrochirurgie	OP-BPC	/

Produs cablu

Număr de serie	Denumirea cablului	Lungime (m)	Ecranat
1	Cablu de control al piciorului	3	Da
2	Cablu de alimentare	5	Nu
3	Cablu electrochirurgical bipolar	3	Nu
4	Cablul de Transductor	2,9	Da

Performanța EMC

Acest echipament poate fi supus interferențelor de frecvență radio cauzate de alte echipamente medicale și de comunicațiile radio. Pentru a preveni astfel de interferențe, acest produs a fost testat în conformitate cu IEC 60601-1-2 și îndeplinește cerințele acestora. Cu toate acestea, Reach Surgical, Inc. nu garantează că nu va exista absolut nicio interferență în mediile de instalare individuale.

Dacă se constată că dispozitivul este interferat (ceea ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea dispozitivului), utilizatorul (sau personalul de întreținere aprobat de Reach Surgical, Inc.) trebuie să încerce să ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri pentru a rezolva problema interferențelor:

Reglați direcția sau poziția dispozitivului care îl afectează.

Creșteți distanța dintre acest dispozitiv și dispozitivul de trimitere.

Folosiți alte surse de alimentare (în loc de puterea utilizată pentru a afecta echipamentul) pentru a alimenta acest echipament.

Consultați furnizorul sau reprezentantul de service pentru alte sugestii.

Produsătorul nu este responsabil pentru orice interferență cauzată de următoarele situații: utilizarea altor cabluri de interconectare decât cele recomandate; alterarea sau modificarea acestui echipament fără permisiune. Schimbările sau modificările neautorizate pot face ca echipamentul să-și piardă eficacitatea.

Toate tipurile de echipamente electronice pot cauza interferențe electromagnetice altor echipamente prin aer sau prin alte cabluri conectate la acestea. Nu utilizați dispozitive care pot emite semnale de radiofrecvență, cum ar fi telefoanele celulare, emițătoarele-receptoare radio sau produsele de control radio, în apropierea acestui dispozitiv, deoarece acest lucru ar putea face ca performanța acestor dispozitive să nu îndeplinească specificațiile acestora. Atunci când astfel de dispozitive se află în apropierea acestui dispozitiv, opriți alimentarea acestor dispozitive. Personalul medical responsabil cu acest echipament trebuie să instruiască tehnicienii, pacienții și alte persoane care ar putea fi în apropierea acestui echipament să respecte pe deplin cerințele de mai sus.

Pentru a obține pe deplin performanța CEM specificată, utilizatorul trebuie să instaleze corect produsul în conformitate cu pașii descriși în manual. În cazul în care apar probleme legate de CEM, vă rugăm să contactați personalul de întreținere aprobat de Reach Surgical, Inc.

Transductor (cu cablu) și Foarfece cu ultrasunete sunt definite ca fiind partea aplicată a întregului sistem.

Precauții pentru instalarea produsului

Echipamentul poate fi utilizat într-un mediu spitalicesc, dar nu include camere de ecranare a frecvențelor radio în jurul echipamentelor chirurgicale active de radiofrecvență sau în care sunt amplasate echipamente de rezonanță magnetică, deoarece intensitatea perturbațiilor electromagnetice în aceste locații este ridicată.

Distanța de separare și impactul echipamentelor fixe de radiocomunicații: intensitatea câmpului magnetic generat de emițătorii fixi, cum ar fi stațiile de bază ale telefoanelor fără fir (celulare/ fără fir), receptoarele radio mobile terestre, receptoarele radioamatorilor, emisiunile radio AM și FM și emisiunile TV Generators etc., nu pot fi măsurate cu precizie în mod teoretic. Pentru a evalua mediul electromagnetic generat de emițătoarele de radiofrecvență fixe, trebuie luată în considerare măsurarea câmpului electromagnetic. În cazul în care valoarea măsurată a intensității câmpului magnetic la locul unde se află dispozitivul depășește nivelul corespunzător de frecvență radio specificat în "Declarația de combatere a interferențelor", dispozitivul trebuie inspectat pentru a se asigura că poate funcționa în mod normal. În cazul în care se constată condiții anormale de funcționare, trebuie luate în considerare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea echipamentului sau utilizarea unei camere anti-radiofrecvență.

1) Utilizați cablul de alimentare furnizat sau desemnat de Reach Surgical, Inc. Produsele echipate cu o fișă de alimentare trebuie să fie conectate la o priză fixă cu împământare de protecție. Nu utilizați niciun tip de adaptor sau conector pentru a conecta fișa de alimentare.

2) Păstrați acest dispozitiv departe de alte dispozitive electronice pe cât posibil.

3) Urmăriți pașii pentru a conecta dispozitivul.

Note generale

(1) Specificațiile cablului.

Utilizarea cablurilor furnizate de Reach Surgical, Inc. nu va afecta performanța EMC a acestui produs. În cazul în care se utilizează cabluri nespicate, performanța EMC a acestui echipament poate fi redusă semnificativ.

(2) Măsuri de precauție pentru modificări neautorizate

Utilizatorul nu trebuie să modifice acest produs, în caz contrar performanța CEM a acestui produs poate scădea.

Modificarea produsului include următoarele schimbări:

a. Cablu (lungime, material și cablare etc.).

b. Instalarea/disponerea echipamentelor.

c. Configurația/componentele echipamentului.

d. Piese de protecție a echipamentului (piese de deschidere/inchidere a capacului și piese de fixare a capacului).

(3) Toate capacele de protecție trebuie să fie închise atunci când se utilizează echipamentul.

Se preconizează că acest produs va fi utilizat în mediul electromagnetic specificat mai jos, iar cumpărătorul și utilizatorul acestui produs trebuie să se asigure că acesta este utilizat în acest mediu electromagnetic.

Performanță esențială

1. Pentru producția de energie radio de înaltă frecvență avansată, sistemul trebuie să se asigure că abateră puterii nominale de ieșire nu depășește 20% din valoarea standard.

2. Pentru producția de energie radio de înaltă frecvență de bază, sistemul trebuie să se asigure că abateră puterii nominale de ieșire nu depășește 20% din valoarea standard.

Orientări și declarația FABRICANTULUI - EMISII ELECTROMAGNETICE		
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat după cum urmează.		
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.		
Testul privind emisiile	Conformitate	Mediul electromagnetic - orientări
Emisiile RF CISPR 11	Grupul1	Dispozitivul utilizează energia RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile sale de RF sunt foarte scăzute și nu sunt susceptibile de a provoca interferențe în echipamentele electronice din apropiere.
Emisiile RF	Clasa A	Caracteristicile de EMISII ale acestui echipament îl fac potrivit pentru utilizarea în zonele industriale și în spitale.
Curent armonic IEC 61000-3-2	Clasa A	
Modificări de tensiune/fluctuații de tensiune/flickering IEC 61000-3-3-3	Se conformează	

Ghid și declarația producătorului - imunitate electromagnetică			
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat după cum urmează. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.			
Test de imunitate	IEC 60601 nivel de testare	Nivelul de conformitate	Mediul electromagnetic - orientări
Electrostatic descărcare (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2,4,8 ,15kV aer	± 8 kV contact ± 2,4,8 ,15kV aer	Podurile trebuie să fie din lemn, beton sau plăci ceramice. În cazul în care podurile sunt acoperite cu materiale sintetice, Umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin 30 %.
Tranziție electrică rapidă/incărcare rapidă IEC 61000-4-4-4	± 2 kV pentru liniile de alimentare cu energie electrică ± 1 kV pentru liniile de intrare/ieșire	± 2 kV pentru liniile de alimentare cu energie electrică ± 1 kV pentru liniile de intrare/ieșire	Calitatea energiei electrice ar trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.
Supratensiune IEC 61000-4-5	± 1 kV de la linie(e) la linie(e) de 1 kV ± 2 kV linie (linii) la pământ	± 1 kV de la linie(e) la linie(e) de 1 kV ± 2 kV linie (s) la pământ	Calitatea energiei electrice ar trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.
Scăderi de tensiune, scurtcircuit întreruperi pe liniile de intrare a sursei de alimentare IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cicluri la 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°. 0 % UT; 1 ciclu și 70 % UT; 25/30 cicluri Cu o singură fază: la 0°. 0 % UT; ciclu 250/300	0 % UT; 0,5 ciclu La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°. 0 % UT; 1 ciclu și 70 % UT; 25/30 cicluri Cu o singură fază: la 0°. 0 % UT; ciclu 250/300	Calitatea energiei electrice ar trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc tipic. În cazul în care utilizatorul aparatului chirurgical cu ultrasunete Echipamentul necesită o funcționare continuă în timpul întreruperilor de alimentare, se recomandă ca ultrasunetele chirurgicale. Echipamentul să fie alimentat de la o sursă de alimentare neîntreruptă sau de la o baterie.
Frecvența de putere (50/60 Hz) Câmpul magnetic IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frecvența de putere magnetică câmpurile trebuie să fie la nivelul caracteristic. a unei locații tipice într-un mediu comercial sau spitalicesc tipic.

Ghid și declarația producătorului - imunitate electromagnetică			
Dispozitivul este destinat aplicării în mediul electromagnetic specificat după cum urmează. Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.			
IMUNITATE test	Testul IEC 60601 nivel	Conformitate nivel	Mediul electromagnetic - orientare
RF condusă IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz până la 80 MHz 6 V în benzile ISM între 0,15 MHz și 80 MHz	3V	Comunicații RF portabile și mobile Echipamentul nu trebuie utilizat mai aproape de nicio parte a dispozitivului, inclusiv de cabluri, decât distanța de separare recomandată, calculată din ecuația pentru frecvența emițătorului. Distanța de separare recomandată
Radiație RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz până la 2,7 GHz 80 % AM la 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ <p>unde P este puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului în wați (W), conform producătorului emițătorului, iar d este distanța de separare recomandată în metri (m). Intensitățile de câmp de la emițătoarele de radiofrecvență fixe, determinate de un studiu electromagnetic la fața locului.3 ar trebui să fie mai mici decât nivelul de conformitate în fiecare gamă de frecvențe. Pot apărea interferențe în apropierea echipamentelor marcate cu următorul simbol:  PORTUL DE ÎNCHIDERE al ECHIPAMENTELOR ME și al SISTEMELOR ME trebuie să fie testat conform specificațiilor din tabelul 9 din IEC 60601-1-2, utilizând metodele de testare specificate în IEC 61000-4-3.</p>

Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și dispozitive.			
Echipament chirurgical cu ultrasunete are ca scop aplicarea într-un mediu electromagnetic în care perturbările RF radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului poate contribui la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (emițătoare) și Dispozitivul ca recomandare, după cum urmează. În funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de comunicații.			
Puterea nominală maximă de ieșire a emițătorului (w)	Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului /m		
	150 kHz până la 80 MHz	80 MHz până la 800 MHz	800 MHz până la 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.36999	0.36999	0.73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3.69986	3.69986	7.36811
100	11.7	11.7	23.3

NOTĂ: Este posibil ca aceste orientări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia de la structuri, obiecte și persoane.

Condiții tehnice


Componentele necesare pentru funcționarea sistemului: Instrument electrochirurgical, Transductor, Pedala ultrasunete, Pedala electrochirurgical, Foarfece cu ultrasunete sau Pișea de mână pentru electrochirurgie, Conector bipolar electrochirurgical Instrument bipolar.

Consultați descrierea produsului pentru această componentă.

Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice	Ultrasunete:  Tip CF Partea aplicată; Electrosurgicală bipolară 
Grad de protecție împotriva șocurilor electrice	Clasa I
Generator la perfuzii dăunătoare	Echipment normal
Gradul de protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a apei	Comutator de picior: IP68
Categoria Management	Clasa IIb
Cerințe de parametri pentru modul cu ultrasunete:	
Putere de intrare	Tensiune de alimentare: 100-240V Frecvența de alimentare: 50Hz/60Hz Putere de intrare: 400VA
Cerințe de parametri pentru modul cu ultrasunete:	
Frecvența de excitație	54 kHz - 57 kHz
Excursie de vibrație a vârfului primar	25 μm ~ 110 μm
Foaarce cu ultrasunete vârf suprafață de ieșire acustică principală Produs:	1,53-2,75 mm2
Reticul secundar Acustic la vârful Foaarce cu ultrasunete Zona de ieșire:	19,32-35,88 mm2
Sunet de ieșire derivat la Foaarce cu ultrasunete vârf la vârf de referință Amplitudine primară Putere de ieșire	< 30W
Tipul de control al frecvenței sistemului	Independent de sarcină, frecvența de excitație este reglată automat și continuu.
Indicele rezervei de putere	Nu mai puțin de 2,5
Cerințe privind parametrii electrochirurgici:	
Frecvența de lucru	400KHz ± 5%
Tensiunea maximă de ieșire	≤ 250V
Mod bipolar avansat Curent maxim de ieșire	≤ 5.5A
Mod bipolar de bază Mod bipolar de bază Curent maxim de ieșire	≤ 2.2A
Tensiunea maximă de ieșire de vârf la vârf	≤ 500Vpk
Factor de vârf	1.6 ± 0.4
Putere nominală	Radiofrecvență avansată bipolară: 270 W Frecvență radio Bipolar de bază: 95W
Sarcina nominală	Frecvență radio avansată bipolară: 30Ω Frecvență radio Bipolar de bază: 200Ω
Condiții de mediu de funcționare	Temperatura: 10 ° C până la 30 ° C
	Umiditate relativă: ≤ 70%
	Gama de presiuni atmosferice: 800 hPa până la 1060 hPa
Condiții de transport și depozitare	Temperatura: -30 ° C până la + 55 ° C (Generator, întrerupător de picior, adaptor)
	Temperatura: -10 ° C până la + 55 ° C (Foaarce cu ultrasunete)
	Umiditate: ≤ 80%
Data de fabricație	Gama de presiuni atmosferice: 800 hPa până la 1060 hPa Data de fabricație poate fi determinată de numărul de serie de pe panoul din spate al aparatului Generator.
Cablu de alimentare	Conformitatea cu cerințele de certificare CCC Ratingul actual: 10A
Rata de persistentă	Determinată de piesa de mână Transductor și Foaarce cu ultrasunete utilizată. Pentru informații privind rata de persistentă, consultați Foaarce cu ultrasunete și Transductor Instrucțiuni pentru piesa de mână sau Capitolul 7 - Avertismente și precauții.
Siguranță	45 * 20 T8AH250V
Greutate (fără ambalaj)	Generator: nominal 8 kg
Volum total	OP9 Generator: (lungime * lățime * înălțime): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispoziție	Unele componente interne ale Generator, întrerupător de picior și cablul întrerupătorului de picior conțin plumb. În conformitate cu reglementările locale Cerințe și reglementări privind eliminarea. Eliminați bateriile în conformitate cu practicile adecvate de eliminare a deșeurilor.
Clasificarea AP/APG	Nu sunt echipamente AP/APG.
Durata de viață:	Durata de viață: 7 ani
Versiunea de lansare a software-ului	V01.01

Forma de undă bipolară de ieșire

Curbă bipolară avansată a puterii de ieșire și a sarcinii

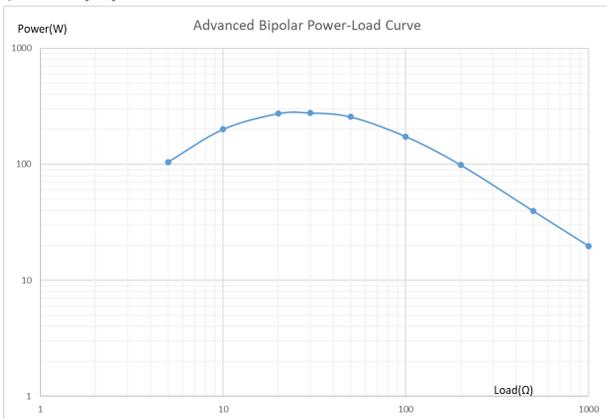


LIMITAȚIE DE CURBĂ DE PUTERE ieșire maximă: 270[W]

Sarcina (Ω)	Limita inferioară	Nominal	Limita superioară
5	83.6	104.5	125.4
10	159.84	199.8	239.76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204.64	255.8	306.96
100	138.72	173.4	208.08
200	78.88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Curbă de putere nominală de 270 de wați de ieșire la sarcină nominală în conformitate cu limita de curent/tensiune a contorului de curbă de putere. Curbă de putere reprezintă anvelopa care variază în condiții de funcționare.


Curba de bază a ieșirii bipolare de ieșire la putere maximă de încărcare

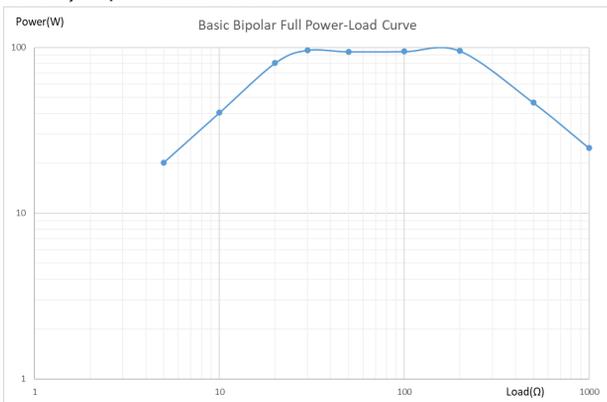

Limita curbei de putere maximă [W]: Putere maximă 95 wați


Sarcina (Ω)	Limita inferioară	Nominal	Limita superioară
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64

Curba de bază a ieșirii bipolare de ieșire la jumătate de putere-încărcare

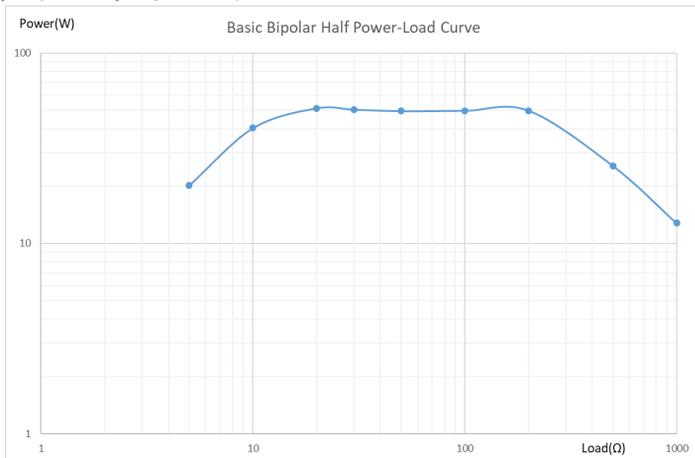

Limita curbei de jumătate de putere [W]: Putere maximă 50 wați			
Sarcina (Ω)	Limita inferioară	Nominal	Limita superioară
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Puterea de ieșire în funcție de setările de putere pentru putere în regim bipolar normal

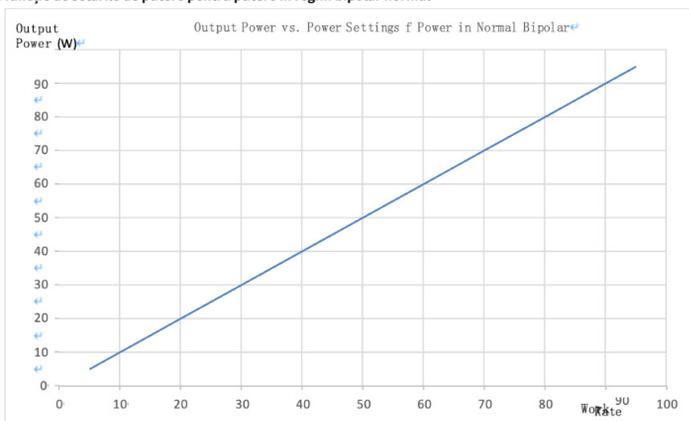

Puterea de ieșire în funcție de valoarea de setare a puterii pentru bipolaritate normală [W]; sarcină: 200Ω			
Putere setată (W)	Limita inferioară a puterii de ieșire (W)	Putere nominală (W)	Limita superioară a puterii de ieșire (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Service și garanție

Reach Surgical, Inc. garantează că acest produs nu prezintă defecte de material și de manoperă în condiții normale de utilizare și întreținere preventivă pentru perioada de garanție specificată mai jos. Obligația Reach Surgical în cadrul acestei garanții se limitează la repararea sau înlocuirea, la alegerea sa, a oricărui produs sau piesă defectă care a fost returnată la Reach Surgical, Inc. sau la distribuitorul autorizat al acesteia în perioada de garanție aplicabilă și care se dovedește a fi defectă în mod satisfăcător pentru Reach Surgical. Această garanție nu se aplică produselor sau pieselor care au fost:

- Afectate în mod negativ din cauza utilizării cu dispozitive neautorizate, fabricate sau distribuite de părți neautorizate de Reach Surgical, Inc.
- Reparate sau modificate în afara fabricii Reach Surgical, dacă afectează stabilitatea sau fiabilitatea dispozitivului, așa cum a fost stabilit de Reach Surgical.
- Supus unei utilizări necorespunzătoare, neglijenței sau unui accident.
- Folosite într-un mod neconform cu designul, parametrii de utilizare, instrucțiunile și orientările pentru produs sau cu standardele funcționale, operaționale sau de mediu acceptate în industrie pentru produse similare.

Perioade de garanție

Conector bipolar de bază pentru energie (OP-BPC): 1 an pentru componente și manoperă.

Generator (OP9): 1 an pentru componente și manoperă.

Întreprător de picior/Cordon de alimentare: 1 an pentru componente și manoperă.

Această garanție reprezintă soluția exclusivă pentru cumpărătorul inițial și înlocuiește toate celelalte garanții, exprese sau implicite, inclusiv garanțiile de vandabilitate și de adecvare la un anumit scop. Reach Surgical, Inc. nu va fi răspunzătoare pentru daune speciale, accidentale sau indirecte, inclusiv daune rezultate din pierderea de utilizare, profituri, afaceri sau bunăvoință, cu excepția celor prevăzute în mod expres de legislația aplicabilă.

Reach Surgical, Inc. nu autorizează nicio persoană să își asume vreo răspundere suplimentară în legătură cu vânzarea sau utilizarea produselor sale. Nu există garanții care să se extindă dincolo de termenii enunțați în prezentul document.

Reach Surgical, Inc. își rezervă dreptul de a face modificări la produsele sale fără a fi obligată să aplice retroactiv aceste modificări la produsele vândute sau construite anterior.

Prehľad

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce informácie. Poskytuje dôležité pokyny týkajúce sa správnej prevádzky, možných rizík a možného poškodenia produktu alebo osôb. V prípade akýchkoľvek abnormálnej situácie postupujte podľa špecifikovaných pokynov, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu zariadenia. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti, výkonu, záruky alebo údržby, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Pred použitím zariadenia si prečítajte pokyny pre modely Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice. Tento dokument je určený na pomoc pri používaní tohto zariadenia. Nie je to odkaz na chirurgické techniky.

Použitie štandardné konvencie: upozornenia, VAROVANIE a poznámky

Všimnite si prosím nasledujúce vyhlásenia, kategorizované ako UPOZORNENIE, VAROVANIE alebo POZNÁMKA, ktoré poskytujú základné pokyny na bezpečné a dôkladné vykonávanie úloh. Tieto vyhlásenia možno nájsť v celej dokumentácii a mali by ste si ich prečítať pred pokračovaním v ďalšom kroku postupu.

UPOZORNENIE : Toto vyhlásenie zdôrazňuje postup prevádzky alebo údržby, prax alebo podmienky, ktoré, ak sa nebudú prísne dodržiavať, môžu viesť k zraneniu osôb alebo strate života.

UPOZORNENIE : Toto vyhlásenie upozorňuje používateľa na potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu používateľa alebo pacienta, ako aj k poškodeniu zariadenia alebo iného majetku. Môže slúžiť aj ako varovanie pred nebezpečnými praktikami. To zahŕňa nevyhnutné opatrenia na bezpečné a efektívne používanie nástroja a starostlivosť potrebnú na zabránenie poškodeniu spôsobenému správnym alebo nesprávnym používaním.

POZNÁMKA : Toto vyhlásenie označuje prevádzkovú prax alebo stav, ktorý je nevyhnutný na efektívne vykonanie úlohy.

Popsis

Elektrochirurgický nástroj ENER REACH (ďalej len „zariadenie“) sa používa v lekárskech operačných sálach na chirurgické zákroky na rezanie, koaguláciu ľudského tkaniva a podviazanie ciev. Obsahuje dva samostatné sloty: jeden pre ultrazvukovú energiu a druhý pre výstup rádiové frekvencie.

V režime rádiové frekvencie poskytuje Generator rôzne energetické schémy v závislosti od pripojeného nástroja/elektrochirurgického zariadenia. Keď je pripojený pokročilý bipolárny nástroj, Generator dodáva RF krivky na utesnenie arteriálnych a venózných ciev, lymfatických uzlín a väzok tkanív až do priemeru 7 mm. Keď je pripojený základný bipolárny nástroj, vydáva sa konštantná energia na rezanie mäkkých tkanív a koaguláciu.

V režime výstupu ultrazvukovej energie pomocou TRA6 Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo v kombinácii s Jednorazové ultrazvukové skalpely CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD zariadenie reže mäkké tkanivá vyžadujúce kontrolu krvácania a minimálne tepelné poškodenie a utesňuje cievy až do maximálneho priemeru 5 mm. Po pripojení k Jednorazové ultrazvukové nožnice SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 a SRE45 zariadenie reže mäkké tkanivá vyžadujúce kontrolu krvácania a minimálne tepelné poškodenie a utesňuje cievy do maximálneho priemeru 7 mm.

Zamýšľané použitie

Zariadenie poskytuje rádiofrekvenčnú energiu na pohon elektrochirurgických násadcov, ktoré sú určené na rezanie a utesňovanie ciev a na rezanie, uchopenie a pitvu tkanív.

Okrem toho, Generator poskytuje ultrazvukovú energiu na pohon ultrazvukových chirurgických nástrojov, ktoré sú indikované na rezy mäkkých tkanív, keď sa požaduje kontrola krvácania a minimálne tepelné poškodenie.

Indikácie

Zariadenie poskytuje rádiofrekvenčnú energiu na pohon elektrochirurgických násadcov, ktoré sa používajú počas otvorených operácií alebo laparoskopických operácií vo všeobecnosti, pediatrickej, gynekologickej, urolologickej, hrudnej chirurgie na rezanie a utesňovanie ciev do 7 mm vrátane a na rezanie, uchopenie a pitvu tkanív.

Okrem toho Generator poskytuje energiu na poháňanie ultrazvukových chirurgických nástrojov, ktoré sú indikované na rezy mäkkých tkanív, keď sa požaduje kontrola krvácania a minimálne tepelné poškodenie. Ultrazvukové chirurgické nástroje možno použiť ako doplnok alebo náhradu elektrochirurgie, laserov a oceleových skalpelov na rezanie a/alebo koaguláciu tkaniva pri otvorených chirurgických zákrokoch alebo laparoskopických operáciách všeobecne, pediatrických, gynekologických, urologických, hrudných a pečatiaciach a transekčných lymfatických ciev.

Zamýšľaný používateľ

Zariadenie je určené na použitie zdravotníckymi pracovníkmi na chirurgické aplikácie.

Prostredie zamýšľaného použitia

Zariadenie je určené na použitie v nemocnici.

Zamýšľaná populácia pacientov

Toto zariadenie je vhodné pre pacientov vo veku 3 rokov a starších, ktorí vyžadujú chirurgické zákroky zahŕňajúce rezy mäkkých tkanív s kontrolou krvácania a minimálnym tepelným poranením.


Klinický prínos

Prístroj je možné bezpečne a efektívne použiť pri podviazaní a delení ciev, tkanivových väzok a lymfatických uzlín.

Kontraindikácie

Toto zariadenie je kontraindikované na kostné rezy, antikoncepcné oklúzie vajíčkovodov a koagulačné postupy. Tiež nie je určený na použitie v neurochirurgii.

Zloženie systému

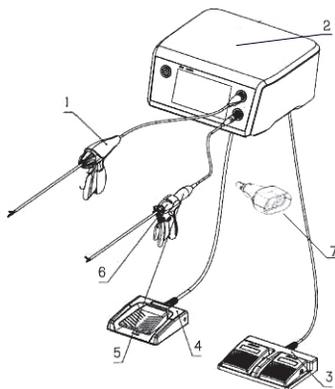

[01] elektrochirurgické koncovky	[02] OP9 Generator
[03] Ultrazvukový nožný spínač	[04] Elektrochirurgický nožný spínač
[05] Transducer za ultrazvočno kirurško opremo	[06] Ultrazvukové nožnice
[07] Elektrochirurgický bipolárny konvertor	

[01] Elektrochirurgický nástavec

Elektrochirurgický nástavec pripojený k Generator obsluhuje chirurg počas zákroku. Aplikuje RF elektrochirurgickú energiu na tkanivo medzi jeho čeluste na koaguláciu alebo utesnenie. Súčasťou nástroja je aj čepeľ na delenie tkaniva. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Podrobné informácie nájdete v pokynoch.

[02] OP9 Generator

Generator poskytuje elektrochirurgickú energiu aj energiu ultrazvukovej terapie prostredníctvom samostatných prípojovacích portov prístroja. Pozostáva zo šasi, krytu, elektronickej dosky, dotykovej LCD obrazovky, vypínača a rozhraní na pripojenie príslušenstva.

Model: OP9

[03] Ultrazvukový nožný spínač

Používa sa na ovládanie zapnutia/vypnutia výstupu ultrazvukovej energie pomocou dvoch spínačov ("MIN" a "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrochirurgický nožný spínač

Používa sa na ovládanie zapnutia/vypnutia výstupu vysokofrekvenčnej energie pomocou jediného spínača.

Model: OP-FSS

[05] Transducer za ultrazvočno kirurško opremo

Transducer za ultrazvočno kirurško opremo premieňa elektrickú energiu z kompatibilného Generator na mechanický pohyb čepeľ nástroja. Je to opakovane použiteľný nástroj s obmedzenou životnosťou. Transducer za ultrazvočno kirurško opremo je nesterilný a pred použitím sa musí sterilizovať podľa pokynov. Podrobné informácie nájdete v pokynoch TRA6 Transducer za ultrazvočno kirurško opremo.

Model: TRA6.

[06] Ultrazvukové nožnice

Ultrazvukové nožnice využívajú mechanický pohyb z Transducer za ultrazvočno kirurško opremo a dodáva ultrazvukovú energiu na rezanie tkaniva alebo koaguláciu. Je potrebné postupovať opatrne, pretože mechanické vibrácie nie je možné zistiť a mohli by neúmyselne ovplyvniť necielené oblasti. Ultrazvukové nožnice sú sterilizované etylénoxidom. Ak je prekročená doba použiteľnosti alebo je poškodený sterilizačný obal, Ultrazvukové nožnice by sa nemali používať a mal by sa zlikvidovať. Podrobné informácie nájdete v pokynoch pre Ultrazvukové nožnice.

Nasledujúce Ultrazvukové nožnice sú kompatibilné s OP9 Generator:

Séria PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Séria SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Séria SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Elektrochirurgický bipolárny konektor

Používa sa na pripojenie základnej bipolárnej Elektrochirurgické nástroje k Generator na koaguláciu tkaniva.

Model: OP-BPC

Generator Predný panel

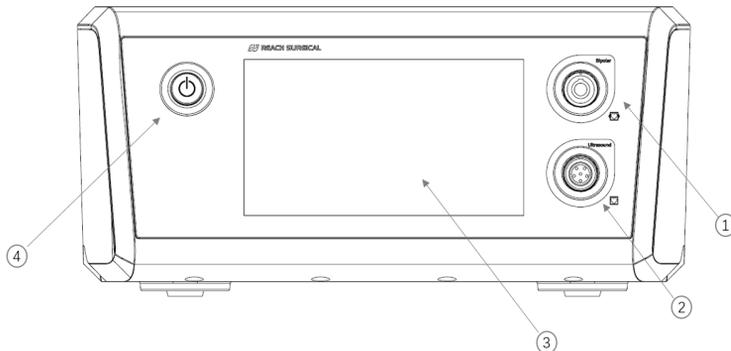

[01] Elektrochirurgická zásuvka

Používa sa na pripojenie pokročilého bipolárneho Elektrochirurgického nástroje alebo elektrochirurgického bipolárneho konektora.

[02] Zásuvka Transducer za ultrazvočno kiruško opremo

Pripája Transducer za ultrazvočno kiruško opremo k Generator.


[03] Dotykový LCD displej

Zobrazuje systémové informácie a slúži ako rozhranie na úpravu ovládacích prvkov a nastavení.

[04] Napájanie Tlačidlo prepínača

Stlačením zapnete Generator; stlačením a podržaním vypnete.

Generator Zadný panel

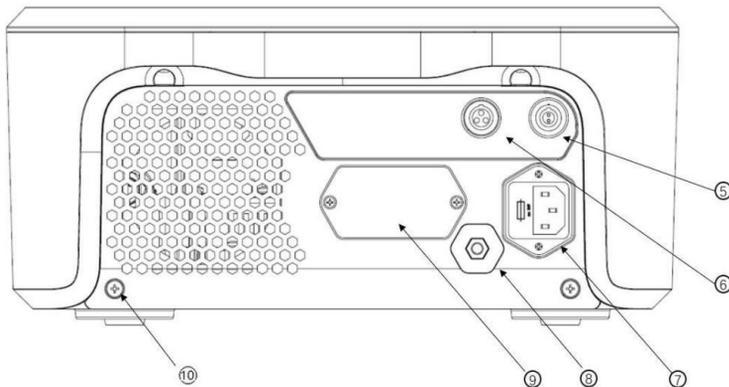

[05] Elektrochirurgická zásuvka nožného spínača

Okružla zásuvka na pripojenie elektrochirurgického pedálového spínača.

[06] Zásuvka ultrazvukového nožného spínača

Okružla zásuvka na pripojenie ultrazvukového nožného spínača.

[07] Napájacia zásuvka

Pripája napájací kábel k Generator.

[08] Port na vyrovnanie potenciálu

Ak je uzemnenie zásuvky neisté, tento port umožňuje pripojenie k chránenej zemi.

[09] Rozhranie rozšírenia

Používa sa na rozšírenie funkcií a údržbu.

[10] Montážny otvor

Inštrukcie na používanie

Pozrite si poskytnuté pokyny pre prevádzkové prostredie.

Rozbaľovanie

Po obdržaní nižšie uvedených komponentov postupujte podľa pokynov.

- Skontrolujte akékoľvek viditeľné poškodenia pri preprave. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte spoločnosť Reach Surgical, Inc alebo miestneho zástupcu so žiadosťou o pomoc.

Komponenty zahrnuté v (Podrobné technické špecifikácie a kódy produktov nájdete v kapitole „Technické podmienky systému“):

Model	Popis	C komponent
OP9	Generator	Generator , Napájací kábel , Návod
TRA6	Transducer za ultrazvočno kiruško opremo	Transducer za ultrazvočno kiruško opremo s káblom
OP-FSD	Ultrazvukový nožný spínač	/
OP-FSS	Bipolárny nožný spínač	/
OP-BPC	Základný bipolárny energetický konektor	/

Bezpečnostné opatrenia

- Počas kontroly zariadenia držte distálny koniec nástroja mimo iných prístrojov, chirurgických zakrytí, pacienta alebo akýchkoľvek iných predmetov, aby ste predišli zraneniu.
- Vykonaajte potrebné bezpečnostné opatrenia v prítomnosti výparov v súlade s nemocničnými postupmi a predpismi.

Ultrazvuková energia s PD Series Ultrazvukové nožnice

- Pripojte Transducer za ultrazvočno kiruško opremo, nožný spínač a PD sériu Ultrazvukové nožnice k Generator.
- Po absolvovaní testu Transducer za ultrazvočno kiruško opremo a Ultrazvukové nožnice upravte úroveň výkonu (1-5) pomocou ikon +/- na obrazovke LCD.
- Stlačením tlačidla „Min“ na pedáli Ultrazvukové nožnice alebo Min na nožnom spínači aktivujete ultrazvukovú energiu na prednastavenej úrovni výkonu.
- Stlačením tlačidla „Max“ na pedáli Ultrazvukové nožnice alebo Min na nožnom spínači získate maximálnu úroveň energie.
- Uvoľnite kľúč alebo nožný spínač, aby ste zastavili výstup energie.

Ultrazvuková energia s SRB/SRE Series Ultrazvukové nožnice

- Po absolvovaní testu Transducer za ultrazvočno kiruško opremo a Ultrazvukové nožnice upravte úroveň výkonu (1-5) pomocou ikon +/- na obrazovke LCD.
- Stlačením tlačidla Tlačidlo energie na nástroji alebo tlačidla Min na nožnom pedáli aktivujete ultrazvukovú energiu na prednastavenej úrovni výkonu.

- Stlačte Tlačidlo energie s funkciou pokročilej hemostázy na prístroji, aby ste aktivovali režim pokročilej hemostázy.
- Uvoľníte tlačidlo na Ultrazukové nožnice alebo tlačidlo na Pedalka , aby ste zastavili dodávku energie.

Elektrochirurgická bipolárna energia s pokročilými bipolárnymi nástrojmi

- Na LCD displeji sa zobrazuje ikona pokročilého bipolárneho ovládania a ikona nastaviteľného ručného ovládania.
- Potiahnutím Páka na prístroji alebo stlačením pedálu nožného spínača aktivujete rádiovú frekvenciu.
- Generator zastaví výstup energie, keď je uzavretie dokončené, čo je indikované ikonou dokončenia na obrazovke.
- Ak je ligácia neúplná, zaznie varovný tón a zobrazí sa ikona varovania.

Elektrochirurgická bipolárna energia s bipolárnym elektrochirurgickým nástrojom

- Na obrazovke LCD sa zobrazuje hodnota výkonu, nastaviteľné ikony a pruhy úrovne výkonu.
- Rozsah nastavenia výkonu od 1 do 95 wattov s nastaviteľnými prírastkami.
- Vyberte požadované nastavenie výkonu: Nizky (15 wattov), Stredný (30 wattov) alebo Vysoký (60 wattov).
- Stlačením tlačidla na ručnom spínači alebo pedáli nožného spínača aktivujete rádiovú frekvenciu.
- Uvoľnením tlačidla deaktivujete výstup energie.

Nastavenie odporúčaní

Nastavenia efektov	Rozsah nastavení napájania	Klinická aplikácia	Optimalizované zariadenie
Nízka	1-15 wattov	Ako sú nervy / chrbtica, ruky a operácia tváre	· Zariadenia s menším povrchom · Mikroštipkové kliešte (0,4 – 2,2 mm)
Stred	16-40 W att	Ako je koagulácia počas hlavy/krku, chrbtice a anatómie	· Zariadenia so stredným povrchom · Mikroštipkové kliešte (1,0 – 2,2 mm) · Malé laparoskopické kliešte s plochou hlavou · Bipolárne nožnice
Vysoká	45-95 wattov (5 wattové prírastky)	Ako napríklad chirurgia hlavy/krku a plastická chirurgia (podobná strednému účinku, ale s rýchlejším účinkom)	· Zariadenia s veľkým povrchom · Veľké laparoskopické kliešte s plochou hlavou

POZNÁMKA : Toto zariadenie nie je kompatibilné s neutrálnou elektródou.

POZNÁMKA : Elektrický skalpel Ultrazukové nožnice a RF sú časti aplikované na pacienta


Zaspievaj Generator

Zapnite zariadenie

- Po zapnutí je systém pripravený na prevádzku. Keď je Generator pripojený k elektrickej sieti a kontrolka pohotovostného spínača svieti, systém je pripravený na použitie.
- Po stlačení tlačidla pohotovostného režimu sa zobrazí nasledujúci obrázok:




- Ak k Generator nie je pripojený žiadny Transducer za ultrazvočno kirurško opremo alebo Ultrazukové nožnice, alebo ak sú pripojené nesprávne, zobrazí sa nasledujúci obrázok:



Použitie ultrazukového prístroja (Transducer za ultrazvočno kirurško opremo a Ultrazukové nožnice)


Keď sa zistia Transducer za ultrazvočno kirurško opremo a Ultrazukové nožnice, zobrazí sa nasledujúci obrázok.

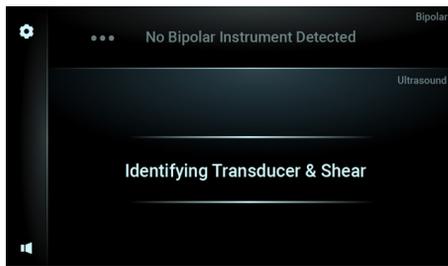


POZNÁMKA : ak je zostávajúce využitie Transducer za ultrazvočno kirurško opremo menej ako 10, zobrazí sa nasledujúci obrázok. Venujte pozornosť počtu zostávajúcich použití, pretože Transducer za ultrazvočno kirurško opremo je potrebné vymeniť, keď sa číslo stane nulou.




Ďalej sa zobrazí nasledujúci obrázok, budete vyzvaní, aby ste stlačili ľubovoľné tlačidlo na Ultrazvukové nožnice, aby ste spustili test Ultrazvukové nožnice s otvoreným Čeluste.

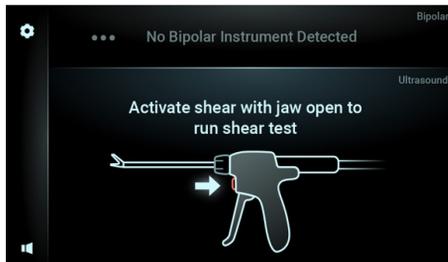


Stlačte ľubovoľné tlačidlo a zobrazí sa nasledujúci obrázok.

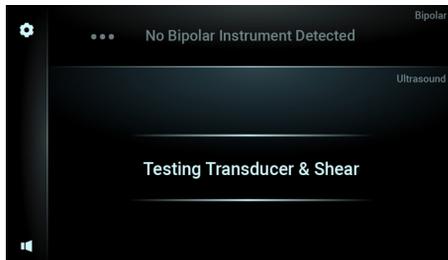


Keď test Transducer za ultrazvočno kirurško opremo zlyhá, zobrazí sa nasledujúci obrázok:

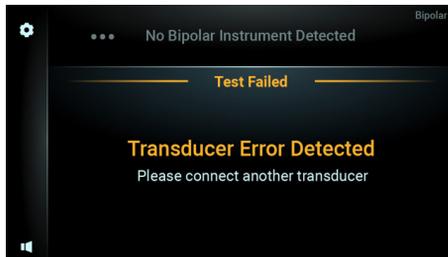

Keď test Ultrazvukové nožnice zlyhá, zobrazí sa nasledujúci obrázok

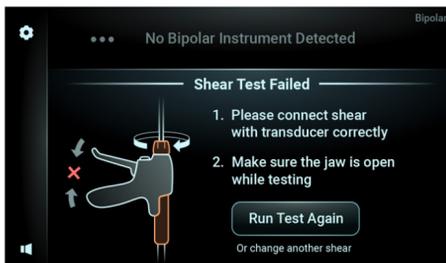

Keď test Transducer za ultrazvokočno kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice prejde, zobrazí sa nasledujúci obrázok:

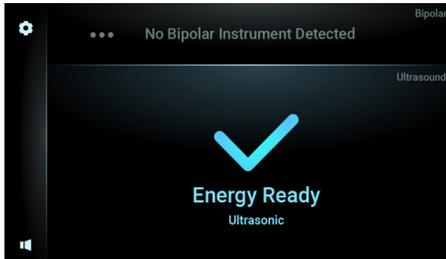

Pri pripájaní Ultrazvukové nožnice bez funkcie pokročilej hemostázy sa zobrazí nasledujúca pracovná obrazovka.




Po pripojení SRE Ultrazvukové nožnice s pokročilou hemostázou sa zobrazí nasledujúca pracovná obrazovka.




Výstupný režim bude zvýraznený, je aktivovaný.

Použitie elektrochirurgie nástroj


Keď sa zistia Transducer za ultrazvokočno kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice, zobrazí sa nasledujúci obrázok.

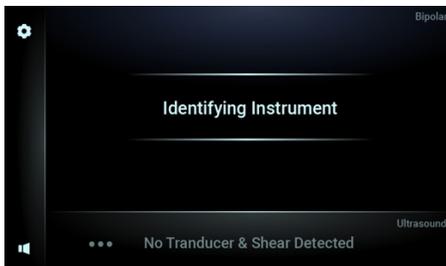

Keď test elektrochirurgického prístroja prebehne úspešne, zobrazí sa nasledujúci obrázok:

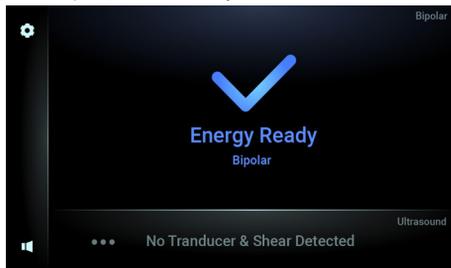

Po pripojení k pokročilému bipolárnemu prístroju sa zobrazí nasledujúca pracovná obrazovka.

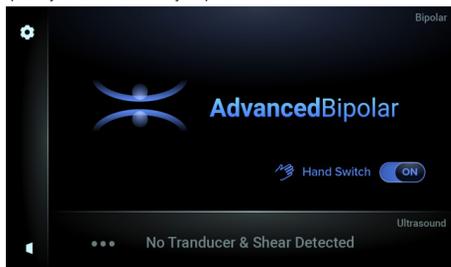


Pri pripojení k bežnému bipolárnemu prístroju sa zobrazí nasledujúca pracovná obrazovka.




Použitie elektrochirurgie nástroj a Ultrazvukové nožnice

Upozorňujeme, že keď je Generator pripojený k bipolárnemu elektrochirurgickému prístroju aj k Ultrazvukové nožnice, systém pracuje v režime rozdelenej obrazovky, aby zobrazil aktuálny stav. Zariadenie, ktoré má prioritu, aktivuje energiu ako prvé. Tento stav rozdelenej obrazovky je zobrazený nižšie:

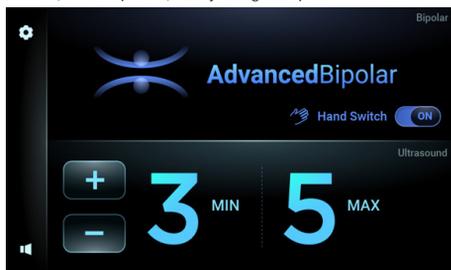

Systémové nastavenia


Ak chcete získať prístup k nastaveniam systému, kliknite na ikonu nastavení umiestnenú v ľavom hornom rohu obrazovky. K dispozícii sú nasledujúce možnosti nastavenia systému:

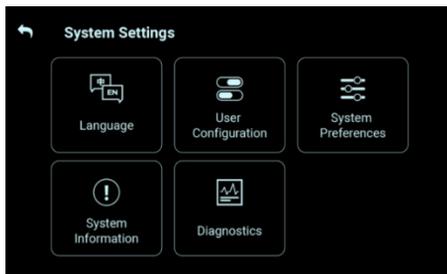


Jazyk : Kliknutím na položku Jazyk sa zobrazí obrazovka výberu jazyka:




Konfigurácia používateľa : Kliknutím na položku Konfigurácia používateľa sa zobrazí obrazovka konfigurácie používateľa:

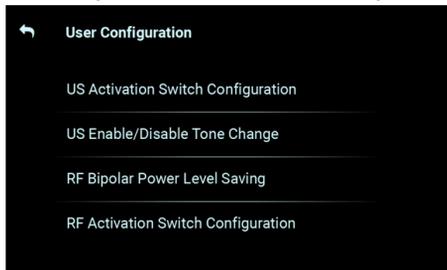


Systémové predvolby : Kliknutím na položku Systémové predvolby sa zobrazí obrazovka systémových predvolieb:

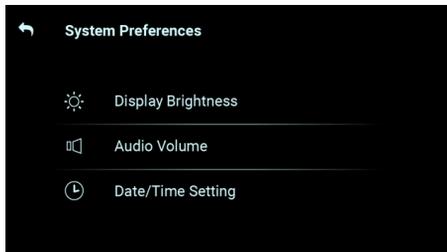

Systémové informácie : Jemným kliknutím na položku Systémové informácie zobrazíte obrazovku systémových informácií:



Diagnostika : Kliknutím na položku Diagnostika sa zobrazí obrazovka diagnostiky:

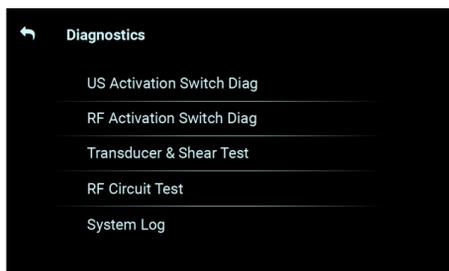

Ak chcete ukončiť systémové nastavenia a vrátiť sa do pohotovostného režimu systému, stlačte ikonu „Návrat“ v ľavom hornom rohu obrazovky.

S vypnutie systému

Ak chcete bezpečne vypnúť systém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Stlačte tlačidlo pohotovostného režimu : Nájdite tlačidlo pohotovostného režimu na Generator a jeho stlačením spustíte proces vypnutia.

Odpojte Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice : Opatrne odpojte Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice od systému. Pre správnu manipuláciu s Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo a Ultrazvukové nožnice si pozrite návod na obsluhu.

Čistenie : Vyčistite Generator, nožný spínač a Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo v súlade so špecifikovanými postupmi uvedenými v kapitole „Údržba“.

Riešenie problémov

Generator obsahuje rôzne výstražné signály a chybové kódy, ktoré pomáhajú pri identifikácii a diagnostike porúch komponentov. Je dôležité poznamenať, že tieto signály a kódy sú navrhnuté tak, aby podporovali klinický úsudok a pozorovanie, a nie ich nahradzovali.

Zvukové upozornenie

Pracovný stav	Typ zvuku	Možná príčina a postup
Stav samokontroly	Normálny zvuk	/
	Abnormálny zvuk	Bola zistená porucha hardvéru. Ak potrebujete pomoc s opravou, kontaktujte výrobcu.
Použitie ultrazvukového prístroja	Maximálna úroveň zvuku	/
	Minimálna úroveň zvuku	/
	Abnormálny zvuk	Ultrazvukové nožnice sa dostal do kontaktu s nadmerným tkanivom. Znížte kontakt tkaniva s Ultrazvukové nožnice. Ak neprerušený zvuk pretrváva, opatrne odstráňte tkanivo, ktoré sa môže nahromadiť okolo konca Ultrazvukové nožnice. Na Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo a/alebo Ultrazvukové nožnice bola zistená chyba. Pre ďalšiu pomoc sa obráťte na výrobcu alebo kontaktujte podporu.
	POKROČILÝ zvuk	/
	JEHO zvuk	/
Aktivačný elektrochirurgický nástroj	Pokročilý bipolárny výstražný tón	/
	Normálny bipolárny zvuk	/
	Abnormálny zvuk	Neúspešné rezanie: Ak tkanivo, ktoré je v kontakte s nástrojom , nesplňa požiadavky na rezanie, znížte množstvo tkaniva, ktoré je v kontakte s nástrojom. Ak chybový tón pretrváva, opatrne odstráňte tkanivo, ktoré sa môže nahromadiť na konci nástroja. Zlyhanie hardvéru: Táto chyba indikuje potenciálnu poruchu v obvode alebo konektore. V prípade akejkoľvek chyby alebo chyby sa odporúča konzultovať s výrobcom alebo vyhľadať podporu, ktorá vám poskytne vhodné pokyny a riešenie.

Chybové kódy

Energy Platform Generator je vybavená komplexným systémom identifikácie porúch, ktorý pozostáva z výstrah a systémových chýb. Keď je zistená chyba, Generator vydá varovný tón, zobrazí varovný signál na ovládacom paneli a zobrazí zodpovedajúci chybový kód na LCD obrazovke. Pri riešení problému postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

Tabuľka chybových kódov

Kód chyby	Zodpovedajúce chybové hlásenie
POZOR	Prepojte Ultrazvukové nožnice s Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo správne
POZOR	Počas testovania sa uistite, že sú Čeluste otvorené
POZOR	Zistila sa chyba Ultrazvukové nožnice
POZOR	Zostávajúci čas Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo je nula
POZOR	Aktivujte vždy iba jedno tlačidlo
POZOR	Znížte silu použitú na Ultrazvukové nožnice
POZOR	Tlačidlo Ultrazvukové nožnice a nožný spínač nie je možné zatvoriť súčasne
POZOR	Tlačidlo sa zaseklo, skontrolujte ho a pokračujte
POZOR	Upravte Čeluste alebo upnite menej tkaniva
POZOR	Odstráňte zariadenie z tkaniva s
Systémová chyba	Systémová chyba
Systémová chyba	Samokontrola zlyhala

Ak sa počas testovania na obrazovke objaví chyba, vykonajte nasledujúce akcie:



- Uistite sa, že kábel Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo je úplne zasunutý v správnom smere.
- Skontrolujte, či bol Ultrazvukové nožnice správne utiahnutý alebo či sa okolo konca Ultrazvukové nožnice nenahromadilo nejaké tkanivo. Upravte tesnosť Ultrazvukové nožnice a opatrne odstráňte nahromadené tkanivo okolo puzdra Ultrazvukové nožnice. (Ak sa test spustí pred operáciou, uistite sa, že Ultrazvukové nožnice smeruje do vzduchu. Ak používate Ultrazvukové nožnice, skontrolujte, či je (apniacia čelust otvorená a nie je v kontakte so žiadnymi predmetmi.)
- Ak problém pretrváva, zvážte výmenu Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo alebo Ultrazvukové nožnice.
- Prejdite do pracovného režimu zariadenia.

POZNÁMKA: Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo nemusí fungovať správne, ak jeho teplota prekročí špecifikovaný limit. V takýchto prípadoch okamžite použite na obnovu iný Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo alebo postupujte podľa krokov nižšie, aby ste určili príčinu chyby a preskúmali voľiteľné metódy obnovy:

- Nechajte Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo vychladnúť pri izbovej teplote minimálne 45 minút. Tento spôsob chladenia platí aj vtedy, ak sa Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo po dlhšej prevádzke pri vysokom výkone zahreje.
- Ak prehrievanie Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo nie je evidentné a problém zostáva nevyriešený, požiadajte o pomoc zástupcov údržby výrobcu.
- Okrem poistiek nie sú v Generator žiadne diely opraviteľné používateľom. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na výmenu alebo servis sa obráťte na servisný personál, ktorý je vyškolený a autorizovaný spoločnosťou Reach Surgical, Inc. alebo vaším miestnym zástupcom.

Údržba a modernizáciu Generator by mal vykonávať výlučne servisný personál vyškolený a autorizovaný spoločnosťou Reach Surgical.

Mali by sa zvážiť preventívne opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa predišlo potenciálnym hrozbám. Nasledujúce incidenty predstavujú riziko pre kybernetickú bezpečnosť:

- Neoprávnený prístup k akýmkoľvek nesúvisiacim produktom pre zariadenie.
- Akákoľvek neoprávnená sieťová komunikácia so zariadením.
- Aktualizácie firmvéru alebo softvéru, ktoré neboli autorizované spoločnosťou Reach Surgical.

V prípade ktoréhokoľvek z vyššie uvedených incidentov sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti Reach Surgical, Inc. alebo priamo na spoločnosť Reach Surgical, Inc. na adrese Reachquality@reachsurgical.com.

Údržba

Čistenie a dezinfekcia Generator a základného bipolárneho energetického konektora

Upratovanie

Vyčistite obrazovku LCD Generator a základný bipolárny konektor v súlade s nemocničnými postupmi a predpismi. Pred čistením sa uistite, že hlavný zdroj napájania Generator je odpojený a napájací kábel je odpojený od výstupnej jednotky.

VAROVANIE: Postupy čistenia sa musia starostlivo dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu Generator, úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku nebezpečenstva požiaru. Na Generator ani do neho nestriekajte tekutiny, ani ho neponárajte do tekutiny.

Pri čistení postupujte podľa týchto krokov:

- Pripravte čistiaci prostriedok s neutrálnym pH alebo enzýmový detergent s neutrálnym pH podľa špecifikácie výrobcu čistiacieho prostriedku.
- Pomocou čistej, mäkkéj handričky namočenej v malom množstve čistiaceho roztoku ručne utrite všetky povrchy vrátane obrazovky Generator.
- Všetky povrchy utrite čistou, mäkkou handričkou namočenou v teplej vode z vodovodu.
- Nakoniec utrite všetky povrchy čistou mäkkou handričkou, aby boli suché.

Dezinfekcia

- Ak sa Generator kontaminuje krvou alebo telesnými tekutinami, musí sa pred opätovným použitím dezinfikovať. Nasledujúce chemické dezinfekčné prostriedky boli overené na použitie na Generator: 70 % izopropylalkohol, 6 % chlórnan sodný, 10 % peroxid vodíka.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu pre správne použitie, koncentráciu a dobu pôsobenia dezinfekčných prostriedkov.
- Uistite sa, že dezinfekčné prostriedky sú nakonfigurované a používané podľa pokynov výrobcu.

Čistenie nožného spínača

Po každom použití vyčistite nožný spínač a kábel podľa nasledujúceho postupu:

- Odpojte nožný spínač od Generator.
- Pripravte si enzýmový detergent s neutrálnym pH podľa pokynov výrobcu.
- Pevne pripojte kábel k nožnému spínaču a ponorte ho na 2 minúty do čistiaceho roztoku.
- **POZNÁMKA:** Uistite sa, že kábel nožného spínača použitý na pripojenie Generator je úplne suchý, aby ste predišli náhodnej aktivácii.
- Po ponorení ručne vydrhnite nožný spínač a kábel kefkou s mäkkými štetinami v čistiacom roztoku.
- Nožný spínač a kábel dôkladne opláchnite teplou vodou z vodovodu aspoň 1 minútu.

UPOZORNENIE: Počas oplachovania nechajte kábel a nožný spínač bezpečne pripojené.

- Všetky povrchy utrite čistou mäkkou handričkou.

VAROVANIE: Na čistenie nožného spínača nepoužívajte ultrazvukový čistiaci stroj.

VAROVANIE: Nezapínajte napájanie Generator pred pripojením napájacieho kábla striedavého prúdu. Pred montážou sa uistite, že sú všetky spoje suché.

Čistenie a dezinfekcia Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo

Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo sa dodávajú nesterilné a pred každým použitím vyžadujú dôkladné čistenie a sterilizáciu.

Čistenie:

Dôkladne vyčistite prevodník podľa nasledujúcich krokov:

- Opláchnite prevodník skrútkovou stranou nahor a čistite ho mäkkou štetinovou kefou s čistou vodou, kým na povrchu nezostanú šmudy;
- Prevodník sa namočí do pH neutrálného enzymatického detergentu (hlavné zložky: proteáza, lipáza, amyláza, celulóza, pektináza a iné biologické enzýmy, povrchovo aktívna látka šetrná k životnému prostrediu, faktor proti hrdzi a stabilizátor) na dobu do 10 minút pri vhodnej teplote 15 °C ~ 65 °C.

Pomer čistiaceho prostriedku a čistenej vody je 1:400.

- Prevodník oplachujte 2 minúty čistenou vodou skrutkovou stranou nahor;
- Očistite spojovaciu skrutku, povrch pre montáž skalpela a konektor alkoholovou utierkou.
- Namačte prevodník do 75 % lekárskeho liehu a 30-krát ho podržte a pretrepte;
- Prevodník oplachujte 2 minúty čistenou vodou skrutkovou stranou nahor.

Poznámka: Používanie ultrazvukových čistiacich prostriedkov sa pre prevodník neodporúča.

Sušenie:

Teplota sušenia: 50 ~ 70 °C, Čas sušenia: 30 min.

Sterilizácia prevodníka:

Po vyššie uvedených krokoch čistenia a sušenia sa musí prevodník sterilizovať jednou z nižšie uvedených metód.

Sterilizácia parou (121 °C)

- Plášť by sa mal nainštalovať pred sterilizáciou. Prevodník by mal byť počas sterilizácie zabalený. Prevodník vložte na sterilizáciu do vysokoteplotného sterilizačného parného hrnca s teplotou 121 °C a trvaním 30 minút.
- Teplota sušenia: Čas sušenia: 50 ~ 70 °C: 30 min.

Sterilizácia parou (134 °C)

- Plášť by sa mal nainštalovať pred sterilizáciou. Prevodník by mal byť počas sterilizácie zabalený. Prevodník vložte na sterilizáciu do vysokoteplotného sterilizačného parného hrnca s teplotou 134 °C a trvaním 10 minút.
- Teplota sušenia: Teplota sušenia: 50 ~ 70 °C, čas sušenia: 30 min.

Bezpečnostné a funkčné testy

Zabezpečte vykonávanie bezpečnostných a funkčných testov pre Transducer za ultrazvuko- chirúsko opremo, Generator a nožný spínač v súlade s nemocničnými postupmi a predpismi. Bezpečnostné a funkčné testy iných komponentov používaných viacerými pacientmi nájdete v návode na použitie špecifického pre každý komponent.

Test bezpečnosti

Generator: Certifikovaní nemocniční technici by mali vykonať test vzodového prúdu.

Nožný spínač: Skontrolujte pedál, konektor kábla a kábel, či nie sú prasknuté alebo poškodené. Vymeňte všetky poškodené komponenty.

Ďalšie komponenty: Skontrolujte všetky ostatné komponenty podľa pokynov v príslušných prevádzkových pokynoch.

Funkčný test

Ultrazvukový režim

- Pripravte si kompletnú sadu PD Ultrazvukové nožnice a pripojte Transducer za ultrazvuko- chirúsko opremo podľa pokynov uvedených v kapitole II – Inštalácia a prevádzka zariadenia.
- Overt, či je možné vstúpiť do pracovného stavu. Rôzne Ultrazvukové nožnice môžu mať rôzne vstupné rozhrania. Podrobné pokyny nájdete v časti 1, oddiele 3 kapitoly 2.
- Potvrďte zobrazenie úrovne MIN výkonu 3 a maximálneho výkonu 5.
- Stlačte tlačidlo zvýšenia a zníženia výkonu, aby ste sa uistili, že úroveň MIN výkonu je možné nastaviť od úrovne 1 do 5.
- Zapnite Generator a prepnite ho do ultrazvukového pracovného režimu. Overt správne pripojenie Transducer za ultrazvuko- chirúsko opremo a Ultrazvukové nožnice.
- Pri otvorenej čelusti stlačte tlačidlo „MAX“ na nožnom spínači. Na LCD obrazovke by sa mala zobrazíť MAX. úroveň výkonu „5“ a mal by zaznieť aktivačný tón.
- Pri otvorenej čelusti stlačte tlačidlo „MIN“ na nožnom spínači. Na LCD obrazovke by sa mala zobrazíť minimálna úroveň výkonu a mal by zaznieť aktivačný tón.

VAROVANIE: Pred aktiváciou systému sa uistite, že čelusť je v dostatočnej vzdialenosti od tkanív, iných nástrojov alebo iných predmetov, aby ste predišli zraneniu používateľa.

Bipolárny elektrochirurgický režim

- Pripojte pokročilý bipolárny elektrochirurgický nástroj/základný bipolárny nástroj podľa pokynov.
- Skontrolujte, či systém môže vstúpiť do pracovného rozhrania. Základný bipolárny režim by mal zobrazovať ikonu úrovne výkonu 30, zatiaľ čo pokročilý bipolárny režim by mal zobrazovať ikonu „pokročilý bipolárny“.
- Zľahka sa dotknite tlačidiel zvýšenia a zníženia výkonu v Základnom bipolárnem režime, aby ste potvrdili, že úroveň výkonu je možné nastaviť medzi 1 a 95. Dotknite sa pruhov Nízka, Stredná a Vysoká, aby ste priamo prepínali medzi 15, 30 a 60.
- Vypnite Generator a počkajte 5 sekúnd. Potom zapnite napájanie Generator a počkajte 10 sekúnd. Skontrolujte, či základný bipolárny režim zobrazuje rozhranie 30 úrovni výkonu a rozšírený bipolárny režim zobrazuje rozhranie „pokročilý bipolárny“. Overt, či je Generator aktivovaný podľa vopred stanovených požiadaviek.
- Pripojte pokročilý a základný bipolárny Elektrochirurgické nástroje a stlačte jeden nožný spínač. Skontrolujte, či na ovládacom paneli neblikajú indikatory úrovne výkonu a počúvajte aktivačný zvuk.

VAROVANIE: Pred aktiváciou systému je prísne zakázané povoliť akýkoľvek kontakt Ultrazvukové nožnice s tkanivami, inými nástrojmi alebo akýmikoľvek inými predmetmi, aby sa predišlo zraneniu používateľa.

Upozornenia a opatrenia

Súvisiace so systémom

- Pred použitím si prečítajte pokyny a postupujte podľa nemocničných smerníc pre klinický prax pre ultrazvukovú chirurgiu, elektrochirurgiu, gynekológiu a laparoskopiu.
- Minimálne invazívne zariadenia sa môžu líšiť od výrobcu k výrobcovi. Ak sa v ordinácii súčasne používajú minimálne invazívne nástroje a príslušenstvo od rôznych výrobcov, pred operáciou skontrolujte kompatibilitu nástrojov a príslušenstva a skontrolujte, či príslušenstvo vložené do ľudského tela nemá drsný povrch, ostrú hranu alebo výstupok, ktorý môže spôsobiť bezpečnostné riziká.
- Toto zariadenie je určené len na použitie vyškolenými a licencovanými chirúrgmi. Nepoužívajte elektrochirurgické zariadenia, pokiaľ nie ste riadne zaškolení v ich používaní pre konkrétny postup, ktorý budete musieť absolvovať. Neškolené používanie tohto zariadenia môže spôsobiť neúmyselné vážne zranenie pacienta, vrátane perforácie čreva a bezvedomej a neopraviteľnej nekrózy tkaniva.
- Neotvárajte kryt Generator bez povolenia, aby ste predišli možnému riziku úrazu elektrickým prúdom. Akákoľvek oprava a modernizácia nástroja musí byť vykonaná servisným pracovníkom vyškoleným a autorizovaným spoločnosťou Reach Surgical, Inc. Nepoužívajte tento nástroj na iné účely ako na lekársku chirurgiu.
- Dôkladné pochopenie princípov a techník spojených s laserovými, elektrochirurgickými a ultrazvukovými postupmi je nevyhnutné, aby sa predišlo nebezpečenstvu šoku a popálenia pre pacienta aj zdravotnícky personál a poškodeniu tohto zariadenia alebo iných zdravotníckych zariadení. Elektrická izolácia alebo uzemnenie nesmú byť narušené. Neponárajte elektrochirurgické zariadenia do tekutín, pokiaľ to nevyžaduje konštrukcia a označenie uvádzajú, že by mali byť ponorené.
- Bezpečná a efektívna ultrazvuková chirurgia a elektrochirurgia závisia nielen od konštrukcie zariadenia, ale aj od mnohých faktorov kontrolovaných

operátorom. Pre zvýšenie bezpečnosti a účinnosti si prečítajte, pochopte a dodržiavajte pokyny na používanie dodané so zariadením.

- Ako pri všetkých zdrojoch energie (elektrochirurgické, laserové alebo ultrazvukové), treba brať do úvahy karcinogénne a infekčné riziká, ktoré môžu predstavovať mnohé vďaljšie produkty tkaniva, ako sú dym a aerosóly. Pri otvorených aj endoskopických postupoch by sa mali dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, ako sú ochranné okuliare, filtračné masky a účinné zariadenie na odvod dymu.
- Po vybratí zariadenia skontrolujte, či tkanivo nemá hemostázu. Ak hemostáza chýba, je potrebné použiť vhodné metódy na dosiahnutie hemostázy.
- Produkty vyrobené alebo distribuované spoločnosťami, ktoré nie sú autorizovaným spoločnosťou Reach Surgical, Inc., nemusia byť kompatibilné so zariadením. Používanie takýchto produktov môže viesť k neočakávaným výsledkom a môže zraniť používateľa alebo pacienta.
- Aby sa znížilo riziko rušenia, zariadenie a kryt musia byť pripojené k nezávislému napájaciemu obvodu.
- Zariadenie nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavéj anestetikkej zmesi so vzduchom alebo oxidom dusným. Možnosť iskrenia v dôsledku kôlzie s inými kovovými zariadeniami. Iskry môžu zapáliť horľavé plyny, ako sú polné plyny.
- Musí pracovať v rámci požadovaného rozsahu prevádzkovej teploty okolia.
- Napätie výstupnej zásuvky musí spĺňať požiadavky Generator (kapitola „Technické podmienky systému“). Ak nie je napájanie správne pripojené, môže to poškodiť Generator a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru.
- Neprepínajte aktívny tón na nepočuteľnú úroveň. Pracovníci chirurgického tímu môžu zaznamenať aktívne tóny, zatiaľ čo Generator dodáva energiu.
- Ukázalo sa, že dym vznikajúci počas elektrochirurgie môže byť potenciálne škodlivý pre pacientov alebo personál chirurgického tímu. Navrhnite primerané vetranie pomocou chirurgického odsávača dymu alebo iných prostriedkov.
- V zariadení Ultrasonic Surgical Integrated Generator sú niektoré komponenty, ktoré sa čistia nesterilne (napr. Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo). Pred začatím inštalácie systému produkt podľa potreby sterilizujte. Pokyny na čistenie a sterilizáciu nájdete v každom príslušnom návode.
- Aby sa predišlo zraneniu používateľov alebo pacientov, Ultrazvukové nožnice sa musia vyhnúť iným zariadeniam, chirurgickým rúškam, pacientom alebo iným predmetom pred stlačením testovacieho tlačidla a počas kontroly systému. Bezpečnostné opatrenia v prípade aerosólu (podľa nemocničných predpisov) sa zavedú do metódy kontroly a testovania systému.
- Nevyvíjajte príliš veľký tlak na čelust', aby ste zabránili inhibícií dodávky ultrazvukovej energie.
- Aby nedošlo k zraneniu používateľa, tepel sa musí pred aktiváciou systému vyhnúť kontaktu s tkanivom, inými zariadeniami alebo inými predmetmi.
- Ak sa kvapalina rozpráši alebo naleje na alebo do Generator, alebo ak sa Generator rozleje alebo naleje do kvapaliny, môže poškodiť Generator a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru.
- Iskrenie a zahrievanie spojené s technikami uzatvárania nádob môžu slúžiť ako zdroje vznietenia. Gáza a špongia by mali zostať vlhké. Udržujte elektrochirurgické elektródy mimo dosahu horľavých materiálov a prostredia bohatého na kyslík (O2).
- Ak dôjde k značnému poškodeniu Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo alebo ak niektoré časti po čistení a dezinfekcii vykazujú známky poškodenia, zlikvidujte ich. Poškodené diely sú zreteľne označené, aby sa predišlo nesprávnemu použitiu pred ďalšou manipuláciou.
- Jednorazový odpad a elektrický odpad sa musia likvidovať v súlade s nemocničnými predpismi a nesmú sa likvidovať podľa vlastného uváženia, aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia.
- Vyhnite sa používaniu Generator v blízkosti iného zariadenia alebo na ňom položeného. Ak je potrebné použitie vedľa seba alebo na sebe, monitorujte Generator a ďalšie vybavenie, aby ste zaistili správnu činnosť.
- Zariadenie neobsahuje žiadne diely opraviteľné operátorom. Ohľadom servisu kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Reach Surgical alebo servisného personálu.
- Pred použitím skontrolujte všetky zariadenia pripojené k systému a pripojenia. Overté, či zariadenie funguje podľa plánu. Nesprávne pripojenie môže viesť k iskreniu, iskreniu, poruche zariadenia alebo neúmyselným chirurgickým výsledkom.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie musí byť pripojené iba k zdroju s ochranným uzemnením.
- Udržujte čo najďalej medzi Generator a inými elektronickými zariadeniami (napr. monitormi). Nekrúžte ani neviažte elektrické vodiče na elektronické zariadenia. Generator môže spôsobovať rušenie iných elektronických zariadení.
- Systém by sa mal používať opatrne v prítomnosti interných a externých kardiostimulátorov. Rušenie spôsobené použitím Elektrochirurgické nástroje môže spôsobiť, že kardiostimulátor vstúpi do asynchronného stavu alebo úplne znemožní fungovanie kardiostimulátora. Ak sú elektrochirurgické zariadenia alebo zariadenia na utesnenie tkaniva určené na použitie u pacientov s kardiostimulátorom, ďalšie informácie vám poskytne výrobca kardiostimulátora alebo kardiologické oddelenie nemocnice.
- Pri ukladaní nástrojov na vrch Generator alebo pri umiestňovaní Generator na elektrické nástroje buďte opatrní. Toto je nestabilná konfigurácia a neposkytuje dostatočné chladenie.
- Ak Generator zlyhá, môže to spôsobiť chirurgické prerušenie. Musí byť k dispozícii záložný systém.
- Ak to vyžadujú miestne predpisy, Generator by mal byť pripojený k ekvipotenciálnemu konektoru pomocou ekvipotenciálneho kábla.
- Keď sa systém a fyziologické monitorovacie zariadenie používajú súčasne u toho istého pacienta, každá monitorovacia elektróda musí byť umiestnená čo najďalej od prístroja.
- V základnom bipolárnom režime zvolte najnižší možný výstupný výkon pre požadovaný efekt.
- Porucha vysokofrekvenčného chirurgického zariadenia môže spôsobiť neočakávané zvýšenie výstupného výkonu.
- Generator a základný bipolárny elektrochirurgický konektor môžu byť napadnuté vodou alebo časticami. V procese používania a čistenia je potrebné zabrániť vniknutiu vody alebo pevných častíc.
- Keď sa systém používa v kombinácii s endoskopom, môže zvýšiť zodvodý prúd na tele pacienta. Počas postupu dávajte pozor.
- Upozornenie pre používateľa a/alebo pacienta, že akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, by mal byť nahlásený spoločnosti Reach Surgical, Inc. prostredníctvom Reachquality@reachsurgical.com. a príslušný orgán členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

Súvisiace s nástrojom

Počas chirurgických zákrokov je dôležité si uvedomiť, že koncová časť nástroja Ultrazvukové nožnice, podložka Ultrazvukové nožnice a Driek môže mať zvýšenú teplotu, keď sa ultrazvuk alebo bipolárny elektrokoagulator aplikuje na tkanivo na dlhší čas. Na zaistenie bezpečnosti je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek náhodnému kontaktu medzi týmito komponentmi nástroja a tkanivom, chirurgickými rúškami, chirurgickými pláštami alebo akýmikoľvek nesúvisiacimi oblasťami počas celého postupu.

Okrem toho je dôležité dbať na opatrnosť pri umiestňovaní bipolárneho nástroja. Konkrétne by nemal byť umiestnený v blízkosti alebo v kontakte s horľavými materiálmi, ako je gáza alebo chirurgické rúška. Bipolárne nástroje používané v tejto súvislosti môžu počas používania vytvárať teplo, čo môže potenciálne viesť k nebezpečenstvu požiaru. Keď sa bipolárny elektrochirurgický prístroj Generator nepoužíva, mal by byť správne uložený v ochrannom puzdre alebo v bezpečnej vzdialenosti od pacienta, členov chirurgického tímu a akýchkoľvek horľavých materiálov.

POZNÁMKA : Ďalšie upozornenia a opatrenia nájdete v príslušnom návode na použitie.

Informácie o EMC

Produkt prešiel testom elektromagnetickej kompatibility, ktorý spĺňa limitné požiadavky normy IEC60601-1-2 pre zdravotnícke zariadenia. Tieto obmedzenia poskytujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v bežných lekárskech inštaláciách.

Zloženie produktu

Sériové číslo	Názov časti	Model/číslo verzie	Poznámky
1	Elektrochirurgický nástroj	OP9	/
2	Transducer za ultrazvukovo kirurško opremo	TRA6	Kompatibilné použitie

3	Ultrazvukové nožnice Systém na jedno použitie Ultrazvuková nožnice	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Kompatibilné použitie
4	Jednorazová ultrazvuková vysokofrekvenčná chirurgická jednotka Utesňovač tkanív	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrazvukový nožný spínač	OP-FSD	/
6	Elektrochirurgický nožný spínač	OP-FSS	/
7	Elektrochirurgický bipolárny konektor	OP-BPC	/

Produktový kábel

Sériové číslo	Názov kábla	Dĺžka (m)	Tienené
1	Kábel nožného ovládania	3	Áno
2	Napájací kábel	5	Nie
3	Bipolárny elektrochirurgický kábel	3	Nie
4	Kábel Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo	2.9	Áno

EMC výkon

Toto zariadenie môže byť vystavené vysokofrekvenčnému rušeniu spôsobenému iným lekárskej vybavením a rádiovou komunikáciou. Aby sa predišlo takémuto rušeniu, tento produkt bol testovaný podľa normy IEC 60601-1-2 a spĺňa jej požiadavky. Spoločnosť Reach Surgical, Inc. však nezaručuje, že v jednotlivých prostrediach inštalácie nedôjde k žiadnemu rušeniu.

Ak sa zistí, že zariadenie je rušené (čo možno určiť zapnutím a vypnutím zariadenia), používateľ (alebo personál údržby schválený spoločnosťou Reach Surgical, Inc.) by sa mal pokúsiť vykonať jedno alebo viaceré z nasledujúcich opatrení na vyriešenie problému problém s rušením:

Upravte smer alebo polohu zariadenia, ktoré ho ovplyvňuje.

Zväčšite vzdialenosť medzi týmito zariadením a odosielajúcim zariadením.

Na napájanie tohto zariadenia použite iné zdroje energie (namiesto energie používanej na ovplyvnenie zariadenia).

Ďalšie návrhy vám poskytne dodávateľ alebo servisný zástupca.

Výrobca nezodpovedá za žiadne rušenie spôsobené nasledujúcimi situáciami: použite iné prepojovacie káble iné ako odporúčané káble; mení alebo upravovať toto zariadenie bez povolenia. Neoprávnené zmeny alebo opravy môžu spôsobiť stratu účinnosti zariadenia.

Všetky typy elektronických zariadení môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie iných zariadení prostredníctvom vzduchu alebo iných káblov, ktoré sú k nim pripojené. V blízkosti tohto zariadenia nepoužívajte zariadenia, ktoré môžu vysielať RF signály, ako sú mobilné telefóny, rádiové vysielacie alebo rádiové ovládacie produkty, pretože to môže spôsobiť, že výkon tohto zariadenia nebude spĺňať špecifikované špecifikácie. Keď sú takéto zariadenia blízko tohto zariadenia, vypnite napájanie týchto zariadení. Zdravotnícky personál zodpovedný za toto zariadenie by mal inštruovať technikov, pacientov a ďalší personál, ktorý sa môže nachádzať v blízkosti tohto zariadenia, aby plne splnili vyššie uvedené požiadavky.

Ak chcete plne dosiahnuť špecifikovaný výkon EMC, používateľ by mal produkt správne nainštalovať podľa krokov opísaných v príručke. Ak sa vyskytnú nejaké problémy súvisiace s EMC, obráťte sa na personál údržby schválený spoločnosťou Reach Surgical, Inc.

Transducer za ultrazvukovo kiruško opremo (s káblom) a Ultrazvukové nožnice sú definované ako aplikovaná časť celého systému.

Bezpečnostné opatrenia pre inštaláciu produktu

Zariadenie sa môže používať v nemocničnom prostredí, ale nezahŕňa miestnosti s rádiovým frekvenčným tieniením okolo aktívnych rádiových frekvenčných chirurgických zariadení alebo tam, kde sú umiestnené zariadenia s dopadom magnetickej rezonancie, pretože intenzita elektromagnetického rušenia je v týchto miestach vysoká.

Oddelovacia vzdialenosť a vplyv pevných rádiokomunikačných zariadení: sila magnetického poľa generovaná pevnými vysielacími, ako sú základňové stanice bezdrôtových (mobilných/bezdrôtových) telefónov, pozemné mobilné rádiové prijímače, amatérske rádiové prijímače, AM a FM rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie Generators atď., nemožno presne teoreticky zmerať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia generovaného pevnými RF vysielacími by sa malo zväziť meranie elektromagnetického poľa. Ak nameraná hodnota intenzity magnetického poľa v mieste zariadenia prekročí zodpovedajúcu úroveň rádiových frekvencií špecifikovanú v „Vyhlásení o ochrane pred rušením“, zariadenie by sa malo skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že môže normálne fungovať. Ak sa zistia abnormálne prevádzkové podmienky, mali by sa zväziť dodatočné merania, ako je zmena orientácie alebo premiestnenie zariadenia alebo použitie miestnosti proti rádiovým frekvenciám.

1) Použité napájací kábel poskytnutý alebo určený spoločnosťou Reach Surgical, Inc. Produkty vybavené napájacou zástrčkou by mali byť zapojené do pevnej elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením. Na pripojenie sieťovej zástrčky nepoužívajte žiadny typ adaptéra alebo konektora .

2) Uchovávajte toto zariadenie čo najďalej od iných elektronických zariadení.

3) Pri pripájaní zariadenia postupujte podľa krokov.

Všeobecné poznámky

(1) Špecifikácia kábla.

Použitie káblov poskytnutých spoločnosťou Reach Surgical, Inc nepoškodí EMC výkon tohto produktu. Ak sa použijú nešpecifikované káble, EMC výkon tohto zariadenia sa môže výrazne znížiť.

(2) Preventívne opatrenia pre neoprávnené opravy

Používateľ nesmie tento produkt upravovať, inak sa môže znížiť EMC výkon tohto produktu.

Úprava produktu zahŕňa nasledujúce zmeny:

a. Kábel (dĺžka, materiál a zapojenie atď.)

b . Inštalácia/rozmiestnenie zariadenia.

c . Konfigurácia/komponenty zariadenia.

d . Ochranné diely zariadenia (otváranie/zatváranie krytu a upevňovacie diely krytu).

(3) Všetky ochranné kryty by mali byť pri prevádzke zariadenia zatvorené.

Očakáva sa, že tento produkt sa bude používať v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie a kupujúci a používateľ tohto produktu by sa mali uistiť, že sa používa v tomto elektromagnetickom prostredí.

Základný výkon

1. V prípade pokročilého vysokofrekvenčného rádiového energetického výstupu systém zabezpečí, aby odchýlka menovitého výkonu nepresiahla 20 % štandardnej hodnoty.

2. Pre základný vysokofrekvenčný rádiový energetický výstup systém zabezpečí, aby odchýlka menovitého výkonu nepresiahla 20 % štandardnej hodnoty

Usmernenie a VYHLÁSENIE VÝROBCU – ELEKTROMAGNETICKÉ EMISIE		
Zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nasledovne. Zákazník alebo používateľ zariadenia by sa mal uistiť, že sa používa v takomto prostredí.		
Emisný test	Súlad	Elektromagnetické prostredie – vedenie
RF emisie CISPR 11	Skupina1	Zariadenie využíva RF energiu len pre svoju internú funkciu. Preto sú jeho vysokofrekvenčné emisie veľmi nízke a nie je pravdepodobné, že spôsobia rušenie blízkych elektronických zariadení.
RF emisie	Trieda A	Charakteristiky EMISÍÍ tohto zariadenia ho predurčujú na použitie v priemyselných oblastiach a nemocniciach
Harmonický prúd IEC 61000-3-2	Trieda A	
Zmeny napätia/kolísanie napätia/blikanie IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická odolnosť			
Zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nasledovne. Zákazník alebo používateľ zariadenia by sa mal uistiť, že sa používa v takomto prostredí			
test IMUNITY	IEC 60601 testovacia úroveň	Úroveň súladu	Elektromagnetické prostredie – vedenie
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV vzduchu	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV vzduchu	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo keramické. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, Relatívna vlhkosť by mala byť aspoň 30 %.
Rýchly elektrický prechod/výbuch IEC 61000-4-4	± 2 kV pre napájacie vedenia ± 1 kV pre vstupné/výstupné vedenia	± 2 kV pre napájacie vedenia ± 1 kV pre vstupné/výstupné vedenia	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo nemocničnemu prostrediu.
Prepätie IEC 61000-4-5	± 1 kV linka(y) na linku(y) ± 2 kV vedenia k zemi	± 1 kV linka(y) na linku(y) ± 2 kV vedenia k zemi	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať kvalite typického komerčného alebo nemocničného prostredia.
Pokles napätia, krátke prerušenia na prívodných vedeniach napájania IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklov Jedna fáza; pri 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	0 % UT; 0,5 cyklu Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklov Jedna fáza; pri 0° 0 % UT; 250/300 cyklus	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať kvalite typického komerčného alebo nemocničného prostredia. Ak používateľ ultrazvukového chirurgického zariadenia vyžaduje nepretržitú prevádzku počas prerušenia napájania, odporúča sa vykonať ultrazvukové vyšetrenie zariadenia je napájané z neprerušiteľného zdroja napájania alebo 0 batérie.
Frekvencia napájania (50/60 Hz) Magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetická silová frekvencia polia by mali byť na úrovni charakteristickej. Na typickom mieste v typickom komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetická odolnosť			
Zariadenie je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nasledovne. Zákazník alebo používateľ zariadenia by sa mal uistiť, že sa používa v takomto prostredí			
IMUNITA test	Test IEC 60601 úrovni	Súlad úrovni	Elektromagnetické prostredie - vedenie
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmach ISM medzi 0,15 MHz a 80 MHz	3V	Prenosné a mobilné RF komunikácie Zariadenie by sa nemalo používať bližšie k žiadnej časti zariadenia , vrátane káblov, ako je odporúčaná separačná vzdialenosť vypočítaná z rovnice pre frekvenciu vysielača. Odporúčaná separačná vzdialenosť
Vyžarované RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM pri 1 kHz	3 V/m	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz až 2,7 GHz kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m). Intenzita poľa z pevných RF vysielačov, ako je určená elektromagnetickým prieskumom miesta.3 by mala byť nižšia ako úroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahu. V blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom sa môže vyskytnúť rušenie: 
ZARIADENIE ZARIADENIA PRE ZARIADENIE A SYSTÉMY ME SA SKÚŠAJÚ PODĽA TABUĽKY 9 NORMY IEC 60601-1-2 POMOCOU SKÚŠOBNÝCH METÓD ŠPECIFIKOVANÝCH V NORME IEC 61000-4-3.			

Odporúčané vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami a zariadeniami.

Ultrazvukový chirurgický prístroj sa zameriava na aplikáciu v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované RF rušenia kontrolované. Zákazník alebo používateľ zariadenia môže pomôcť predchádzať elektromagnetickému rušeniu udržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným RF komunikačným zariadením (vysielačom) a zariadením podľa nasledujúceho odporúčania, podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača (w)	Oddeľovacia vzdialenosť podľa frekvencie vysielača /m		
	150 kHz až 80 MHz	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,36999	0,36999	0,73681
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69986	3,69986	7,36811
100	11,7	11,7	23,3

POZNÁMKA : Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí.

Technické podmienky


Komponenty potrebné na prevádzku systému: Elektrochirurgický prístroj , Transducer za ultrazvučno kirurško opremo, Ultrazvukový nožný spínač, Elektrochirurgický nožný spínač, Ultrazvukové nožnice alebo elektrochirurgické koncovy , Elektrochirurgický bipolárny konektor Bipolárny nástroj.

Pozrite si popis produktu pre tento komponent.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	Ultrazvuk:  aplikovaná časť typu CF; Aplikovaná časť typu CF odolná voči bipolárnej elektrochirurgickej defibrilácii 
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým prúdom	trieda I
Generator na škodlivé infúzie	Normálna výbava
Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutiu vody	Nožný spínač: IP68
Kategória riadenia	Trieda IIb
Požiadavky na parametre režimu ultrazvuku:	
Vstupný výkon	Napájacie napätie: 100-240V Napájacia frekvencia: 50Hz/60Hz Vstupný výkon: 400VA
Požiadavky na parametre režimu ultrazvuku:	
Frekvencia budenia	54 kHz - 57 kHz
Primárna vibračná výchylka hrotu	25 μ m ~ 110 μ m
Hlavná akustická výstupná plocha hrotu Ultrazvukové nožnice Produkt:	1,53 až 2,75 mm ²
Sekundárny crosslink akustický na Ultrazvukové nožnice hrot Výstupná oblasť:	19,32 až 35,88 mm ²
Ovodený výstupný zvuk na špičke Ultrazvukové nožnice pri výkone primárnej amplitúdy referenčnej špičky	< 30 W
Typ riadenia frekvencie systému	Nezávisle od zafarženia sa frekvencia budenia automaticky plynule nastavuje.
Index rezervy energie	Nie menej ako 2,5
Požiadavky na elektrochirurgické parametre:	
Pracovná frekvencia	400 kHz \pm 5 %
Maximálne výstupné napätie	\leq 250 V
Pokročilý bipolárny režim Maximálny výstupný prúd	\leq 5,5 A
Základný bipolárny režim Maximálny výstupný prúd	\leq 2,2 A
Maximálne výstupné špičkové napätie	\leq 500 Vpk
Peak Factor	1,6 \pm 0,4
Menovitý výkon	Pokročilá rádiofrekvenčná bipolárna: 270 W Rádiová frekvencia Základná bipolárna: 95W
Menovité zafarženie	Pokročilá rádiofrekvenčná bipolárna: 300 Rádiová frekvencia Základná bipolárna: 200 Ω
Podmienky prevádzkového prostredia	
	Teplota: 10°C až 30°C
	Relatívna vlhkosť: \leq 70 %
	Rozsah atmosférického tlaku: 800 hPa až 1060 hPa
Podmienky prepravy a skladovania	
	Teplota: -30 ° C až + 55 ° C (Generator, nožný spínač, adaptér)
	Teplota: -10 ° C až + 55 ° C (Ultrazvukové nožnice)
	Vlhkosť: \leq 80 %
	Rozsah atmosférického tlaku: 800 hPa až 1060 hPa
Dátum výroby	Dátum výroby je možné určiť podľa sériového čísla na zadnom paneli Generator.
Napájací kábel	
	Súlada s certifikačnými požiadavkami CCC
	Prúd: 10A
Miera perzistencie	Určené podľa Transducer za ultrazvučno kirurško opremo násadca a Ultrazvukové nožnice použiteľých. Informácie o miere perzistencie nájdete v príslušných Ultrazvukové nožnice a Transducer za ultrazvučno kirurško opremo Pokyny pre násadu alebo Kapitola 7 – Varovania a bezpečnostné opatrenia.
Poisťka	\leq 5 * 20 T8AH250V
Hmotnosť (bez obalu)	Generator: nominálna 8 kg
Celkový objem	OP9 Generator: (dĺžka * šírka * výška): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispozícia	Niektoré vnútorné komponenty Generator, nožný spínač a kábel nožného spínača obsahujú olovo. Podľa miestnych Požiadavky a predpisy na likvidáciu. Batérie zlikvidujte v súlade s príslušnými postupmi likvidácie odpadu.
Klasifikácia AP/APG	Nie zariadenie AP/APG.
Životnosť:	Životnosť: 7 rokov
Verzia vydania softvéru	V01.01

Bipolárny výstupný priebeh

Pokročilá bipolárna krivka výstupného výkonu a zaťaženia

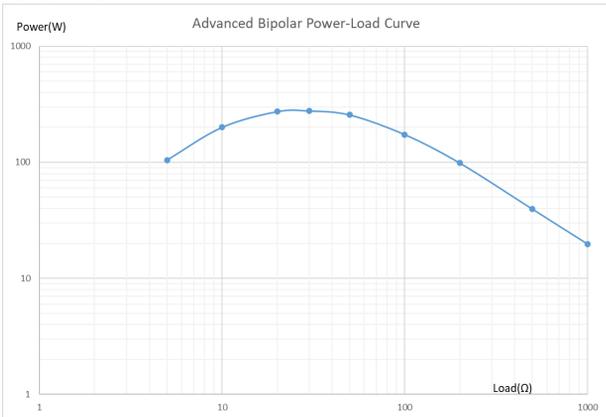


LIMIT KRIVKY VÝKONU Max Výkon : 270[W]

Zaťaž (Ω)	Nižší limit	Nominálny	Horná hranica
5	83,6	104,5	125,4
10	159,84	199,8	239,76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204,64	255,8	306,96
100	138,72	173,4	208,08
200	78,88	98,6	118,32
500	31,6	39,5	47,4
1000	15,84	19,8	23,76

Nominálna výkonová krivka výkonu 270 wattov pri menovitom zaťažení v súlade s limitom prúdu/napätia merača výkonovej krivky. Výkonová krivka predstavuje obálku, ktorá sa mení podľa prevádzkových podmienok.


Základný bipolárny výstup plný výkon- zaťažovacia krivka

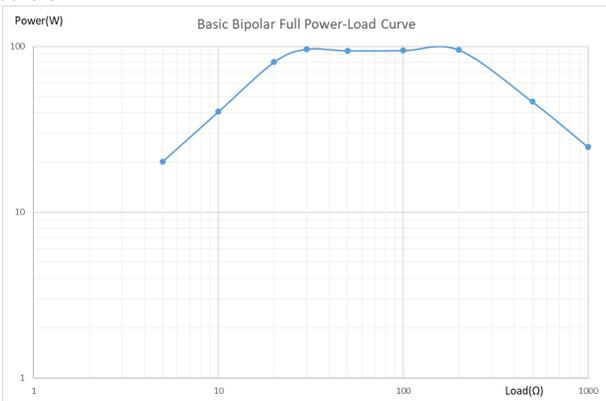

Limit krivky plného výkonu [W]: Maximálny výkon 95 wattov

Zaťaž (Ω)	Nižší limit	Nominálny	Horná hranica
5	16,16	20,2	24,24
10	32,32	40,4	48,48
20	64,48	80,6	96,72
30	76	95	114
50	75,52	94,4	113,28
100	75,68	94,6	113,52
200	76	95	114
500	37,12	46,4	55,68
1000	19,76	24,7	29,64


Základná bipolárna krivka výkonu a zataženia

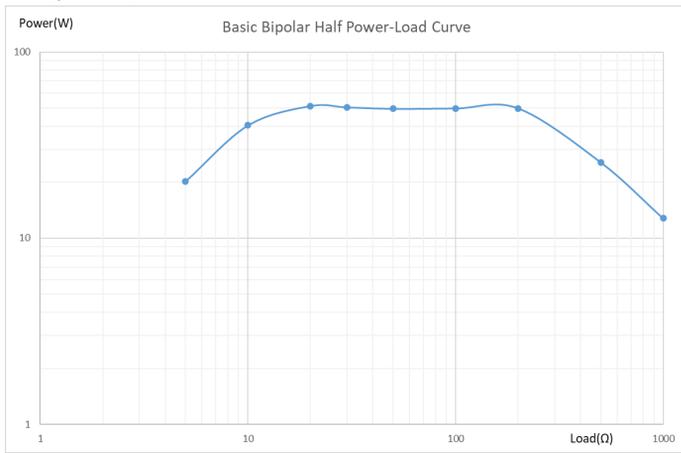

Límit krivky polovičného výkonu [W]: Maximálny výkon 50 wattov

Záťaž (Ω)	Nižší limit	Nominálny	Horná hranica
5	16.16	20.2	24.24
10	32,32	40.4	48,48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39,68	49.6	59,52
100	39,84	49.8	59,76
200	39,92	49.9	59,88
500	20.48	25.6	30,72
1000	10.24	12.8	15.36

Výstupný výkon vs. Nastavenia výkonu pre výkon v normálnom bipolárnom režime

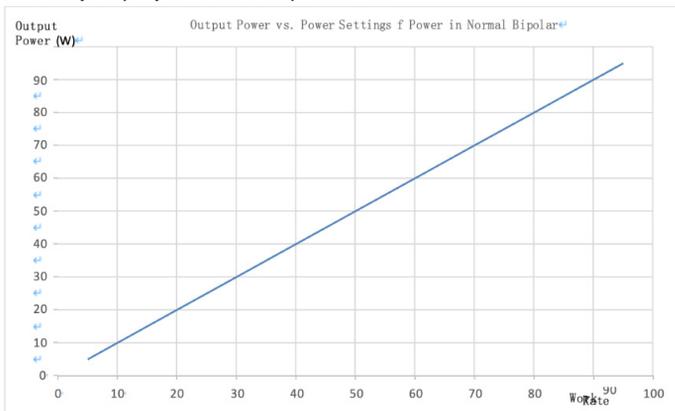

Výstupný výkon vs. nastavená hodnota výkonu pre normálnu bipolárnu [W]; Zataženie: 200Ω

Nastaviť výkon (W)	Dolný limit výstupného výkonu (W)	Nominálny výkon (W)	Horný limit výstupného výkonu (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Servis a záruka

Spoločnosť Reach Surgical, Inc. zaručuje, že tento produkt bude bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní a preventívnej údržbe počas záručnej doby uvedenej nižšie. Povinnosť spoločnosti Reach Surgical v rámci tejto záruky je obmedzená na opravu alebo výmenu podľa vlastného uváženia akéhokoľvek chybného produktu alebo časti, ktorá bola vrátená spoločnosti Reach Surgical, Inc. spokojnosť. Táto záruka sa nevzťahuje na produkty alebo diely, ktoré boli:

- Nepriaznivo ovplyvnené používaním s neautorizovanými zariadeniami vyrobenými alebo distribuovanými stranami, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou Reach Surgical, Inc.
- Opravené alebo zmenené mimo Reach Surgical's továrne, ak to ovplyvňuje stabilitu alebo spoľahlivosť zariadenia, ako to určila spoločnosť Reach Surgical.
- Vystavené nesprávnemu použitiu, nedbalosti alebo nehode.
- Používa sa spôsobom, ktorý nie je v súlade s dizajnom, parametrami používania, pokynmi a pokynmi pre produkt alebo s priemyselne akceptovanými funkčnými, prevádzkovými alebo environmentálnymi normami pre podobné produkty.

Záručné doby

Základný bipolárny energetický konektor (OP-BPC): 1 rok na komponenty a prácu.

Generator (OP9): 1 rok na komponenty a prácu.

Nožný spínač/napájací kábel: 1 rok na komponenty a prácu.

Táto záruka je výhradným opravným prostriedkom pre pôvodného kupujúceho a nahrádza všetky ostatné záruky, výslovné alebo predpokladané, vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť Reach Surgical, Inc. nie je zodpovedná za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody, vrátane škôd vyplývajúcich zo straty používania, zisku, podnikania alebo dobrého mena, pokiaľ to nie je výslovné uvedené v príslušnom zákone.

Spoločnosť Reach Surgical, Inc. neoprávňuje žiadnu osobu, aby prevzala akúkoľvek dodatočnú zodpovednosť v súvislosti s predajom alebo používaním jej produktov. Neexistujú žiadne záruky, ktoré presahujú tu uvedené podmienky.

Spoločnosť Reach Surgical, Inc. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny vo svojich produktoch bez toho, aby jej vznikla povinnosť spätne aplikovať tieto zmeny na predtým predané alebo vyrobené produkty.

Pregled

Pred uporabo te naprave natančno preberite naslednje informacije. Vsebuje pomembna navodila glede pravilnega delovanja, možnih tveganj in morebitne škode za izdelek ali posameznike. V primeru kakršnih koli neobičajnih razmer sledite navedenim navodilom, da preprečite poškodbe sebe ali poškodbe opreme. Neupoštevane teh navodil lahko povzročijo ogroženo varnost, učinkovitost, garancijo ali vzdrževanje, za kar proizvajalec ne more biti odgovoren. Pred uporabo naprave preberite tudi navodila za Transducer in Ultrazvočni Škarje. Ta dokument je namenjen pomoči pri uporabi te naprave. Ni referenca za kirurške tehnike.

Uporabljene standardne konvencije: Pozor, OPOZORILO in Opombe

Upoštevajte naslednje izjave, kategorizirane kot **PREVIDNO**, **OPOZORILO** ali **OPOMBA**, ki zagotavljajo bistvena navodila za varno in temeljito dokončanje nalog. Te izjave je mogoče najti v celotni dokumentaciji in jih je treba prebrati, preden nadaljujete z naslednjim korakom v postopku.

OPOZORILO: Ta izjava poudarja postopek delovanja ali vzdrževanja, prakso ali pogoje, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali izgubo življenja, če jih ne upoštevate dosledno.

POZOR: Ta izjava opozarja uporabnika na potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjšo ali zmerno poškodbo uporabnika ali pacienta ter škodo na opremi ali drugi lastnini. Lahko služi tudi kot opozorilo pred nevarnimi praksami. To vključuje potrebne previdnostne ukrepe za varno in učinkovito uporabo instrumenta ter previdnost, potrebno za preprečitev škode, ki je posledica pravilne ali nepravilne uporabe.

OPOMBA: Ta izjava označuje delovno prakso ali stanje, ki je bistveno za učinkovito izvajanje naloge.

Opis

Elektrokirurški instrument ENER REACH (v nadaljevanju "naprava") se uporablja v medicinskih operacijskih sobah za kirurške posege za rezanje, koagulacijo človeškega tkiva in povezovanje žil. Ima dve ločeni reži: eno za ultrazvočno energijo in drugo za radiofrekvenčni izhod.

V radiofrekvenčnem načinu Generator zagotavlja različne energetske sheme, odvisno od priključenega instrumenta/elektrokirurške naprave. Ko je priključen napredni bipolarni instrument, Generator oddaja RF valovne oblike za tesnjenje arterijskih in venskih žil, limfnih žil in tkivnih snopov do premera 7 mm. Ko je priključen osnovni bipolarni instrument, se oddaja stalna močna energija za rezanje mehkega tkiva in koagulacijo.

V načinu ultrazvočnega izhoda energije z uporabo TRA6 Transducer v kombinaciji s Ultrazvočni skalpel za enkratno uporabo CH45PD, CH36PD, CH23PD, CH14PD naprava reže mehka tkiva, ki zahtevajo nadzor krvavitve in minimalne toplotne poškodbe, ter zatesni žile do največjega premera 5 mm. Pri povezavi s Ultrazvočni Škarje za enkratno uporabo SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36 in SRE45 naprava reže mehka tkiva, ki zahtevajo nadzor krvavitve in minimalne toplotne poškodbe, ter zapre žile do največjega premera 7 mm.

Predvidena uporaba

Naprava zagotavlja radiofrekvenčno moč za pogon elektrokirurških ročnikov, ki so namenjeni uporabi za rezanje in tesnjenje žil ter rezanje, prijemanje in disekcijo tkiv.

Poleg tega Generator zagotavlja ultrazvočno moč za pogon ultrazvočnih kirurških instrumentov, ki so indicirani za zarez v mehkih tkivih, ko sta zaželen nadzor krvavitve in minimalna toplotna poškodba.

Indikacije

Naprava zagotavlja radiofrekvenčno moč za pogon elektrokirurških ročnikov, ki se uporabljajo med odprtimi operacijami ali laparoskopskimi operacijami v splošni, pediatrični, ginekološki, urološki in torakalni kirurgiji za rezanje in zapiranje žil do vključno 7 mm ter za rezanje, prijemanje in disekcijo tkiv.

Poleg tega Generator zagotavlja moč za pogon ultrazvočnih kirurških instrumentov, ki so indicirani za zarez v mehkih tkivih, ko sta zaželen nadzor krvavitve in minimalna toplotna poškodba. Ultrazvočni kirurški instrumenti se lahko uporabljajo kot dodatek ali nadomestek za elektrokirurgijo, laserje in jeklene skalpele za rezanje in/ali koagulacijo tkiva pri odprtih operacijah ali laparoskopskih operacijah na splošno, pediatričnih, ginekoloških, uroloških, torakalnih ter pri plombiranju in prerezu limfne žile.

Predvideni uporabnik

Naprava je namenjena zdravstvenim delavcem za kirurške aplikacije.

Okolje za predvideno uporabo

Naprava je namenjena za uporabo v bolnišnici.

Predvidena populacija bolnikov

Ta naprava je primerna za bolnike, stare 3 leta in več, ki potrebujejo kirurške posege, ki vključujejo zarez mehkih tkiv z nadzorom krvavitve in minimalno toplotno poškodbo.


Klinična korist

Napravo je mogoče varno in učinkovito uporabljati pri povezovanju in delitvi žil, tkivnih snopov in limfnih žil.

Kontraindikacije

Ta naprava je kontraindicirana za kostne reze, kontracepcijsko okluzijo jajcevodov in postopke koagulacije. Prav tako ni namenjen za uporabo v nevrokirurgiji.

Sestava sistema

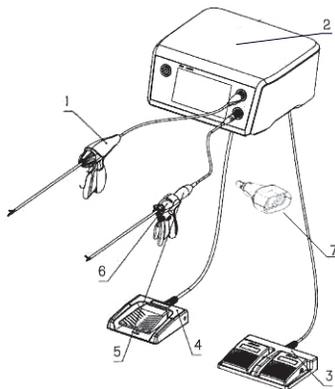

[01] Elektrokirurški ročniki	[02] OP9 Generator
[03] Ultrazvočno nožno stikalo	[04] Elektrokirurško nožno stikalo
[05] Transducer	[06] Ultrazvočni Škarje
[07] Elektrokirurški bipolarni pretvornik	

[01] Elektrokirurški ročnik

Kirurg med postopkom upravlja z elektrokirurškim ročnikom, povezanim z Generator. Uporablja RF elektrokirurško energijo za tkivo med Čelisti za koagulacijo ali tesnjenje. Instrument vsebuje tudi rezilo za delitev tkiva. Model: OSA23, OSA37, OSA44. Za podrobne informacije glejte navodila.

[02] OP9 Generator

Generator zagotavlja tako elektrokirurško energijo kot energijo ultrazvočne terapije prek ločenih priključkov za instrumente. Sestavljen je iz ohišja, lupine, elektronske plošče, LCD zaslona na dotik, stikala za vklop in vmesnikov za povezavo dodatne opreme.

Model: OP9

[03] Ultrazvočno nožno stikalo

Uporablja se za nadzor vklopa/izklopa ultrazvočne energije z dvema stikaloma ("MIN" in "MAX"). Model: OP-FSD

[04] Elektrokirurško nožno stikalo

Uporablja se za nadzor vklopa/izklopa visokofrekvenčne energije z enim samim stikalom.

Model: OP-FSS

[05] Transducer

Transducer pretvarja električno energijo iz združljivega Generator v mehansko gibanje za rezila instrumenta. Je instrument za večkratno uporabo z omejeno življenjsko dobo. Transducer ni sterilen in ga je treba pred uporabo sterilizirati v skladu z navodili. Za podrobne informacije glejte navodila TRA6 Transducer. Model: TRA6.

[06] Ultrazvočni Škarje

Ultrazvočni Škarje uporablja mehansko gibanje Transducer in zagotavlja ultrazvočno energijo za rezanje ali koagulacijo tkiva. Bodite previdni, ker mehanskih vibracij ni mogoče zaznati in bi lahko nenamerno vplivale na neclijana območja. Ultrazvočni Škarje so sterilizirani z etilen oksidom. Če je rok uporabnosti prekoračen ali je sterilizacijski paket poškodovan, Ultrazvočni Škarje ne smete uporabiti in ga morate zavreči. Za podrobne informacije glejte navodila za Ultrazvočni Škarje.

Naslednji Ultrazvočni Škarje so združljivi z OP9 Generator:

Serije PD: CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD

Serije SRB: SRB14, SRB23, SRB36, SRB45


Serije SRE: SRE14, SRE23, SRE36, SRE45

[07] Bipolarni konektor za elektrokirurgijo

Uporablja se za povezavo osnovnega bipolarnega Elektrokirurški instrumenti z Generator za koagulacijo tkiva.

Model: OP-BPC

Generator Sprednja plošča

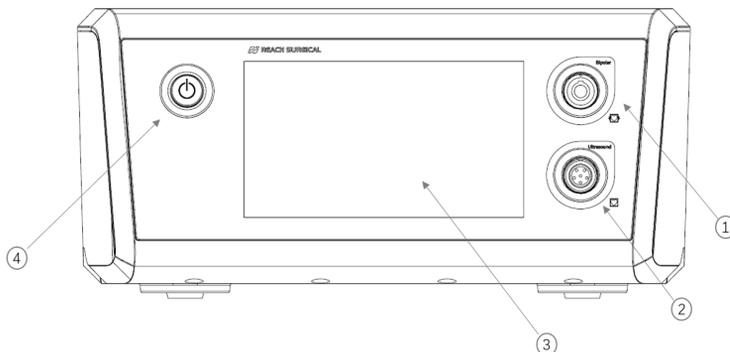

[01] Elektrokirurška vtičnica

Uporablja se za priključitev naprednega bipolarnega Elektrokirurški instrumenti ali elektrokirurškega bipolarnega priključka.

[02] Transducer vtičnica


Povezuje Transducer z Generator.

[03] LCD zaslon na dotik

Prikaže informacije o sistemu in služi kot vmesnik za prilagajanje kontrolnikov in nastavitev.

[04] Moč preklopni gumb

Pritisnite za vklop Generator; pritisnite in držite za izklop.

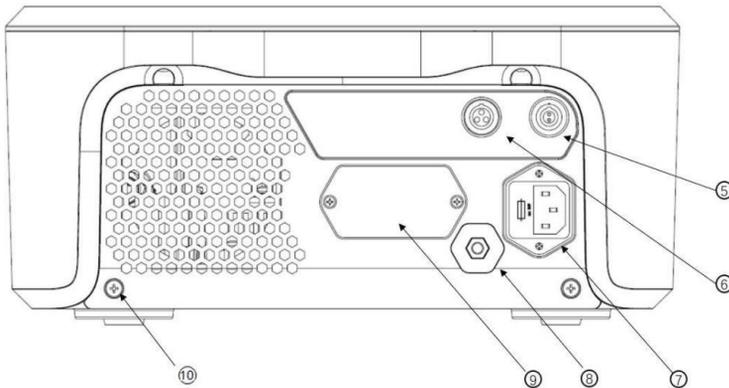Generator Zadnja plošča**[05] Elektrokirurška vtičnica za stikala za noge**

Okrogla vtičnica za priključitev elektrokirurškega stikala za noge.

[06] Vtičnica za ultrazvočno nožno stikalo

Okrogla vtičnica za priključitev ultrazvočnega nožnega stikala.

[07] Napajalna vtičnica

Priključni napajalni kabel na Generator.

[08] Potencialna izenačevalna vrata

Če ozemljitev električne vtičnice ni zanesljiva, ta vrata omogočajo povezavo z zaščiteno ozemljitvijo.

[09] Razširitevni vmesnik

Uporablja se za razširitev funkcij in vzdrževanje.

[10] Montažna luknja**Navodila za uporabo**

Glejte priložene smernice za delovno okolje.

Razpakiranje

Prosimo, sledite navodilom, ko prejmete spodnje komponente.

- Preverite morebitne vidne poškodbe med transportom. Če najdete kakršno koli škodo, se za pomoč obrnite na Reach Surgical, Inc. ali lokalnega zastopnika.

Komponente, vključene v (Za podrobne tehnične specifikacije in kode izdelkov glejte poglavje 'Sistemske tehnične pogoji'):

M odel	Opis	C komponenta
OP9	Generator	Generator , Napajalni kabel , Navodila
TRA6	Transducer	Transducer s kablom
OP-FSD	Ultrazvočno nožno stikalo	/
OP-FSS	Bipolarno nožno stikalo	/
OP-BPC	Osnovni bipolarni energetski konektor	/

Varnostni ukrepi

- Med pregledovanjem opreme držite distalni konec instrumenta stran od drugih naprav, kirurških zaves, pacienta ali drugih predmetov, da preprečite poškodbe.
- V prisotnosti hlapih izvajajte potrebne varnostne ukrepe v skladu z bolnišničnimi postopki in predpisi.

Ultrazvočna energija s serijo PD Ultrazvočni Škarje

Povežite Transducer, nožno stikalo in PD serije Ultrazvočni Škarje na Generator.

- Po opravljenem preizkusu Transducer in Ultrazvočni Škarje prilagodite raven moči (1-5) z uporabo ikon +/- na LCD zaslonu.
- Pritisnite gumb 'Min' na stopalki Ultrazvočni Škarje ali Min pedal na nožnem stikalu, da aktivirate ultrazvočno energijo na prednastavljeni ravni moči.
- Pritisnite gumb 'Max' na stopalki Ultrazvočni Škarje ali Min pedal na nožnem stikalu, da zagotovite največjo moč energije.
- Spustite tipko ali nožno stikalo, da zaustavite oddajanje energije.

Ultrazvočna energija s serijo SRB/SRE Ultrazvočni Škarje

Po opravljenem preizkusu Transducer in Ultrazvočni Škarje prilagodite raven moči (1-5) z uporabo ikon +/- na LCD zaslonu.

- Pritisnite Gumb za energijo na instrumentu ali gumb Min na stopalki, da aktivirate ultrazvočno energijo na prednastavljeni ravni moči.
- Pritisnite Gumb za energijo z izboljšano hemostazo na instrumentu, da aktivirate način napredne hemostaze.
- Spustite gumb na Ultrazvočni Škarje ali gumb na Pedalka , da ustavite dovajanje energije.

Elektrokirurška bipolarna energija z naprednimi bipolarnimi instrumenti

- LCD zaslon prikazuje napredno bipolarno ikono in nastavljuje ikono ročnega upravljanja.
- Povlecite Ročica na instrument ali pritisnite pedal nožnega stikala, da aktivirate radijsko frekvenco.
- Generator bo ustavil oddajanje energije, ko bo zaprtje končano, kar je označeno z ikono za dokončanje na zaslonu.
- Če ligacija ni dokončana, se bo predvajal opozorilni ton in prikazala se bo opozorilna ikona.

Elektrokirurška bipolarna energija z bipolarnim elektrokirurškim instrumentom

- LCD zaslon prikazuje vrednost moči, nastavljuje ikone in vrstice ravni moči.
- Nastavitve moči segajo od 1-95 vatov, z nastavljivimi koraki.
- Izberite Zeleno nastavitve izhodne moči: nizka (15 vatov), srednja (30 vatov) ali visoka (60 vatov).
- Pritisnite gumb na stopalki ročnega ali nožnega stikala, da aktivirate radijsko frekvenco.
- Spustite gumb, da deaktivirate izhod energije.

Nastavitev Priporočila

Nastavitve učinkov	Razpon nastavitve moči	Klinična uporaba	Optimizirana naprava
Nizka	1-15 vatov	Kot so operacije živec/hrbtenice, rok in obraza	<ul style="list-style-type: none"> · Naprave z manjšimi površinami · Klešče z mikrokonico (0,4 – 2,2 mm)
Sredi	16-40 vatov _	Kot je koagulacija med glavo/vratom, hrbtenico in anatomijo	<ul style="list-style-type: none"> · Naprave s srednjo površino · Klešče z mikrokonico (1,0 – 2,2 mm) · Majhne laparoskopske klešče z ravno glavo · Bipolarne škarje
visoko	45-95 vatov (v korakih po 5 vatov)	Kot na primer kirurgija glave/vratu in plastična kirurgija (podobna srednjim učinkom, vendar s hitrejšim učinkom)	<ul style="list-style-type: none"> · Naprave z velikimi površinami · Velike laparoskopske klešče z ravno glavo

OPOMBA : Ta naprava ni združljiva z nevtralno elektrodo.

OPOMBA : Ultrazvočni škarje in RF električni skalpel sta dela, ki se uporabljata v stiku z bolnikom


Poješ Generator

Vklopite napravo

- Sistem je pripravljen za delovanje, ko je vklopljen. Ko je Generator priključen na električno omrežje in lučka stikala za stanje pripravljenosti sveti, je sistem pripravljen za uporabo.
- Ko pritisnete gumb za stanje pripravljenosti, se prikaže naslednja slika:




- Če na Generator ni priključen noben Transducer ali Ultrazvočni Škarje ali če sta nepravilno povezana, bo prikazana naslednja slika:

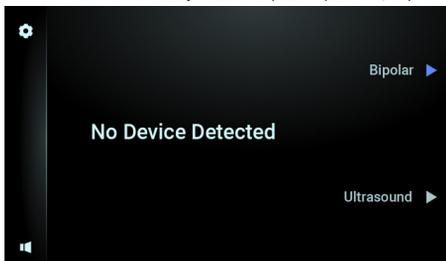

Uporaba ultrazvočnega instrumenta (Transducer in Ultrazvočni Škarje)

Ko sta zaznana Transducer in Ultrazvočni Škarje, se prikaže naslednja slika.

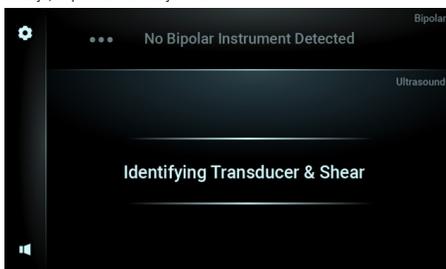


OPOMBA : če je preostala uporaba Transducer manjša od 10, bo prikazana naslednja slika. Prosimo, bodite pozorni na število preostalih uporab, saj je treba Transducer zamenjati, ko je številka postala nič.




Nato se bo prikazala naslednja slika, pozvani boste, da pritisnete kateri koli gumb na Ultrazvočni Škarje, da začnete preizkus Ultrazvočni Škarje z odprtim Čelisti.




Pritisnite poljuben gumb in prikazala se bo naslednja slika.

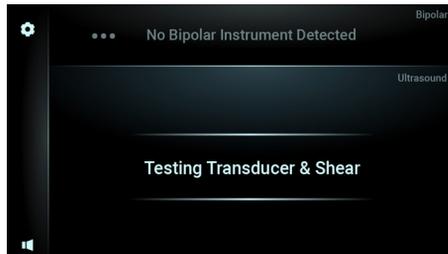


Ko test Transducer ne uspe, se prikaže naslednja slika:

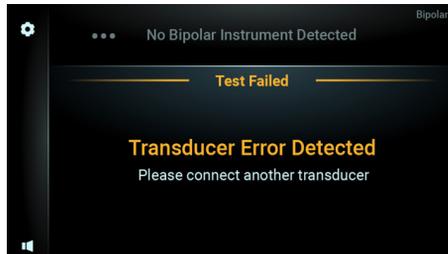

prikaže naslednja slika

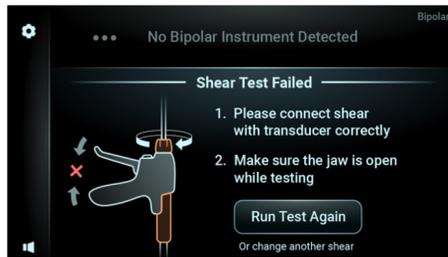

Ko bosta testa Transducer in Ultrazvočni Škarje uspešna, bo prikazana naslednja slika:

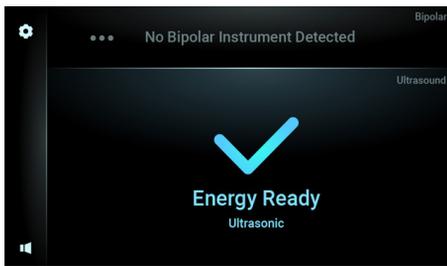

Pri povezovanju Ultrazvočni Škarje brez funkcije Advanced Hemostasis bo prikazan naslednji delovni zaslon.




povezovanju SRE Ultrazvočni Škarje z napredno hemostazo se bo prikazal naslednji delovni zaslon .




Izhodni način bo označen, če je aktiviran.

Uporaba elektrokirurškega instrumenta


Ko sta zaznana Transducer in Ultrazvočni Škarje, se prikaže naslednja slika.




Ko je test elektrokirurškega instrumenta uspešen, se prikaže naslednja slika:

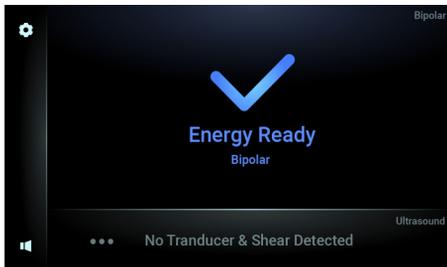

Pri povezovanju z naprednim bipolarnim instrumentom bo prikazan naslednji delovni zaslon.




Pri povezovanju z običajnim bipolarnim instrumentom bo prikazan naslednji delovni zaslon.

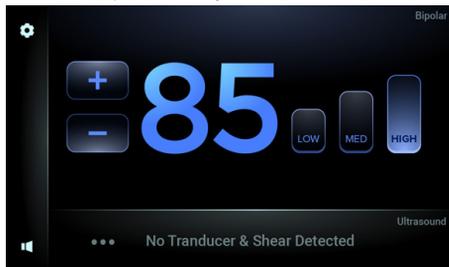


Uporaba elektrokirurškega instrumenta in Ultrazvočni Škarje

Upoštevajte, da ko je Generator povezan z bipolarnim elektrokirurškim instrumentom in Ultrazvočni Škarje, sistem deluje v načinu deljenega zaslona za prikaz trenutnega stanja. Naprava, ki ima prednost, bo prva aktivirala energijo. To stanje razdeljenega zaslona je prikazano spodaj:

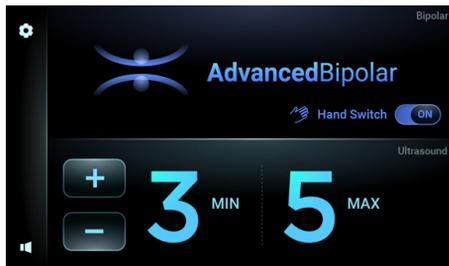

Sistemske nastavitve


Za dostop do sistemskih nastavitvev kliknite ikono nastavitvev v zgornjem levem kotu zaslona. Na voljo so naslednje možnosti sistemskih nastavitvev:




Jezik : s klikom na element Jezik se prikaže zaslon za izbiro jezika:




Uporabniška konfiguracija : s klikom na element Uporabniška konfiguracija se prikaže zaslon za uporabniško konfiguracijo:




Sistemske nastavitve : s klikom na element Sistemske nastavitve se prikaže zaslon s sistemskimi nastavitvami:

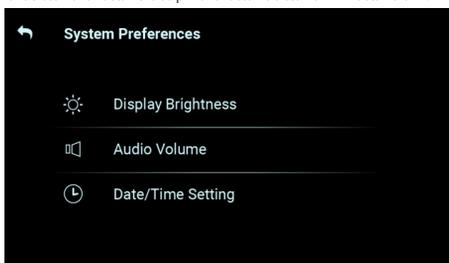

Informacije o sistemu : nežno kliknite na element Informacije o sistemu, da prikažete zaslon s podatki o sistemu:



Diagnostika : s klikom na element Diagnostika se prikaže diagnostični zaslon:



Za izhod iz sistemskih nastavitvev in vrnitev v stanje pripravljenosti sistema pritisnite ikono 'Return' v zgornjem levem kotu zaslona.

Zapiranje sistema

Za varno zaustavitev sistema sledite spodnjim korakom:

Pritisnite gumb za stanje pripravljenosti : poiščite gumb za stanje pripravljenosti na Generator in ga pritisnite, da začnete postopek zaustavitve.

Odklopite Transducer in Ultrazvočni Škarje : Previdno odklopite Transducer in Ultrazvočni Škarje iz sistema. Za pravilno ravnanje z napravama Transducer in Ultrazvočni Škarje glejte navodila za uporabo.

Čiščenje : Očistite Generator, nožno stikalo in Transducer v skladu z navedenimi postopki, opisanimi v poglavju "Vzdrževanje".

Odpravljanje težav

Generator vključuje različne opozorilne signale in kode napak za pomoč pri prepoznavanju in diagnosticiranju napak komponent. Pomembno je omeniti, da so ti signali in kode zasnovani tako, da podpirajo klinično presojo in opazovanje, namesto da bi jih nadomestili.

Zvočno opozorilo

Delovni status	Vrsta zvoka	Možen vzrok in ukrepanje
Status samopreverjanja	Normalen zvok	/
	Nenormalen zvok	Zaznana je bila napaka strojne opreme. Za pomoč pri popravilu se obrnite na proizvajalca.
	Največja raven zvoka	/
	Najmanjša raven zvoka	/
Uporaba ultrazvočnega instrumenta	Nenormalen zvok	Ultrazvočni Škarje je prišel v stik s čezmernim tkivom. Zmanjšajte stik s tkivom z Ultrazvočni Škarje. Če neprekinjen zvok ne izgine, previdno odstranite vsako tkivo, ki se lahko nabira okoli konca Ultrazvočni Škarje.
	NAPREDNI zvok	/
	SVOJ zvok	/
	Napreden bipolarni opozorilni ton	/
Aktiviranje elektrokirurškega instrumenta	Normalen bipolarni zvok	/
	Nenormalen zvok	Neuspešno rezanje: Če tkivo, s katerim se instrument dotika, ne izpolnjuje zahtev za rezanje, zmanjšajte količino tkiva, ki je v stiku z instrumentom. Če ton napake ne izgine, previdno očistite morebitno tkivo, ki se nabira na koncu instrumenta. Okvara strojne opreme: Ta napaka kaže na morebitno napako v vezju ali konektorju. V primeru kakršne koli okvare ali napake je priporočljivo, da se posvetujete s proizvajalcem ali poiščete podporo za ustrezna navodila in rešitev.


Kode napak

Energy Platform Generator je opremljen s celovitim sistemom za identifikacijo napak, ki ga sestavljajo opozorila in sistemske napake. Ko je zaznana napaka, Generator odda opozorilni ton, prikaže opozorilni signal na nadzorni plošči in prikaže ustrezno kodo napake na LCD zaslonu. Za rešitev težave sledite spodnjim korakom:

Tabela s kodami napak

Napačna koda	Ustrezno sporočilo o napaki
Opozorilo	Pravilno povežite Ultrazvočni Škarje s Transducer
Opozorilo	Prepričajte se, da so Čelisti med testiranjem odprti
Opozorilo	Ultrazvočni Škarje Zaznana napaka
Opozorilo	Preostali čas Transducer je nič
Opozorilo	Aktivirajte samo en gumb naenkrat
Opozorilo	Zmanjšajte silo, ki deluje na Ultrazvočni Škarje
Opozorilo	Gumba Ultrazvočni Škarje in nožnega stikala ni mogoče zapreti hkrati
Opozorilo	Gumb se je zataknil, preverite in nadaljujte
Opozorilo	Prilagodite Čelisti ali vpnite manj tkiva
Opozorilo	Odstranite napravo iz tkiva s
Sistemska napaka	Sistemska napaka
Sistemska napaka	Samopreverjanje ni uspelo

Če se med testiranjem na zaslonu pojavi napaka, izvedite naslednja dejanja:



- Prepričajte se, da je kabel Transducer popolnoma vstavljen v pravilno smer.
- Preverite, ali je bil Ultrazvočni Škarje pravilno zategnjen ali se je okoli konca Ultrazvočni Škarje nabralo kakršno koli tkivo. Prilagodite tesnost Ultrazvočni Škarje in previdno odstranite vsako nabiranje tkiva okoli ohišja Ultrazvočni Škarje. (Če se preskus začne pred operacijo, se prepričajte, da je Ultrazvočni Škarje obrnjen proti zraku. Če uporabljate Ultrazvočni Škarje, se prepričajte, da je vpenjalna čeljust odprta in ni v stiku z nobenimi predmeti.)

- Če težave ne odpravite, razmislite o zamenjavi Transducer ali Ultrazvočni Škarje.
 - Nadaljujte z načinom delovanja opreme.
- OPOMBA:** Transducer morda ne bo deloval pravilno, če njegova temperatura preseže določeno mejo. V takšnih primerih takoj uporabite drug Transducer za obnovitev ali sledite spodnjim korakom, da ugotovite vzrok napake in raziščete izbirne metode obnovitve:
- Pustite, da se Transducer ohlaja na sobni temperaturi najmanj 45 minut. Ta način hlajenja velja tudi, če se Transducer po dolgotrajnem delovanju pri visoki moči segreje.
 - Če pregrevanje Transducer ni očitno in težava ostaja nerešena, se za pomoč obrnite na proizvajalčevega predstavnika za vzdrževanje.
 - Razen varovalk v napravi Generator ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Za kakršno koli zamenjavo ali servisiranje se obrnite na servisno osebje, ki je usposobljeno in pooblaščen s strani Reach Surgical, Inc. ali vašega lokalnega predstavnika.
- Vzdrževanje in nadgradnja Generator mora izvajati izključno servisno osebje, ki ga je usposobil in pooblastilo podjetje Reach Surgical. Za preprečevanje morebitnih groženj je treba upoštevati preventivne ukrepe za kibernetko varnost. Naslednji incidenti predstavljajo tveganje za kibernetko varnost:
- Nepooblaščen dostop do izdelkov, ki niso povezani z napravo.
 - Vsaka nepooblaščenca omrežna komunikacija z napravo.
 - Nadgradnje vdrelane ali programske opreme, ki jih Reach Surgical ni odobril.
- V primeru katerega koli od zgornjih incidentov se obrnite na prodajnega predstavnika podjetja Reach Surgical, Inc. ali se obrnite neposredno na podjetje Reach Surgical, Inc. na ReachQuality@reachsurgical.com.

Vzdrževanje

Čiščenje in razkuževanje Generator in osnovnega bipolarnega energetskega konektorja

Čiščenje

Očistite zaslon LCD Generator in bipolarni konektor Basic v skladu z bolnišničnimi postopki in predpisi. Pred čiščenjem se prepričajte, da je glavno napajanje naprave Generator odklopljeno in da je napajalni kabel odstranjen iz izhodne enote.

POZORILLO: Postopke čiščenja morate skrbno upoštevati, da preprečite poškodbe Generator, povzročitev električnega udara ali nevarnost požara. Ne polivajte ali brizgajte tekočine po ali v Generator ali ga potaplajte v tekočino.

Za čiščenje sledite tem korakom:

- Pripravite detergent z nevtralnim pH ali detergent z nevtralnim encimom pH, kot je določil proizvajalec detergenta.
- S čisto, mehko krpo, namočeno z majhno količino čistilne raztopine, ročno obrišite vse površine, vključno z zaslonom Generator.
- Obrišite vse površine s čisto, mehko krpo, namočeno v toplo vodo iz pipe.
- Na koncu obrišite vse površine s čisto, mehko krpo, da zagotovite, da so suhe.

Dezinfekcija

- Če se Generator kontaminira s krvjo ali telesnimi tekočinami, ga je treba pred ponovno uporabo razkužiti. Naslednja kemična razkužila so bila potrjena za uporabo na Generator: 70 % izopropilni alkohol, 6 % natrijev hipoklorit, 10 % vodikov peroksid.
- Upoštevajte priporočila proizvajalca za pravilno uporabo, koncentracijo in kontaktni čas razkužil.
- Prepričajte se, da so razkužila konfigurirana in uporabljena v skladu z navodili proizvajalca.

Čiščenje nožnega stikala

Po vsaki uporabi očistite nožno stikalo in kabel po naslednjem postopku:

- Odklopite nožno stikalo iz Generator.
- Pripravite detergent z nevtralnim pH encimom po navodilih proizvajalca.
- Kabel varno povežite z nožnim stikalom in jih za 2 minuti potopite v čistilno raztopino.
- **POZORILLO:** Prepričajte se, da je kabel nožnega stikala, ki se uporablja za priključitev Generator, popolnoma suh, da preprečite nenamerno aktiviranje.
- Po potopitvi nožno stikalo in kabel ročno očistite s krtačo z mehкими ščetinami v čistilni raztopini.
- Nožno stikalo in kabel temeljito izpirajte s toplo vodo iz pipe vsaj 1 minuto.

POZOR: Med izpiranjem naj bosta kabel in nožno stikalo varno povezana.

- Obrišite vse površine s čisto, mehko krpo.
- **POZORILLO:** Za čiščenje nožnega stikala ne uporabljajte ultrazvočnega čistilnega stroja.

POZORILLO: Ne vklopite napajanja naprave Generator, preden priključite napajalni kabel za izmenični tok. Pred montažo se prepričajte, da so vsi priključki suhi.

Čiščenje in razkuževanje Transducer

Transducer se pošiljajo nesterilni in zahtevajo temeljito čiščenje in sterilizacijo pred vsako uporabo.

Čiščenje:

Transducerje temeljito očistite v skladu z naslednjimi koraki:

- Izperite Transducer z vijačno stranjo navzgor in ga očistite z mehko ščetinasto krtačo s prečiščeno vodo, dokler na površini ni madežev;
 - Transducer se lahko namoči v pH nevtralnem encimskem detergentu (Glavne sestavine: proteaza lipaza amilaza celuloza pektinaza in drugi biološki encimi, okoliu prijazna površinsko aktivna snov, sredstvo za preprečevanje rje in stabilizator) za obdobje do 10 minut in pri ustrezni temperaturi 15 °C ~ 65 °C. Razmerje med detergentom in prečiščeno vodo je 1: 400;
 - Transducer z vijačno stranjo navzgor 2 minuti izpirajte s prečiščeno vodo;
 - Spojni vijak, montažno površino Skalpela in priključek očistite z alkoholnim robčkom.
 - Transducer namočite v 75-odstotni medicinski alkohol ter ga 30-krat pridržite in pretresite;
 - Transducer z vijačno stranjo navzgor 2 minuti izpirajte s prečiščeno vodo.
- Opomba: Uporaba ultrazvočnih čistilnikov za Transducer ni priporočljiva.

Sušenje:

Temperatura sušenja: 50-70 °C, Čas sušenja: 30 min.

Sterilizacija Transducerja:

Po zgornjih korakih čiščenja in sušenja je treba Transducer sterilizirati na enega od spodaj navedenih načinov.

Sterilizacija s paro (121 °C)

- Pred sterilizacijo namestite ovojnico. Transducer je treba med sterilizacijo zaviti. Za sterilizacijo postavite Transducer v posodo za sterilizacijo z visoko temperaturo pare, s temperaturo 121 °C in trajanjem 30 min.
- Temperatura sušenja: 50-70 °C, Čas sušenja: 30 min.

Sterilizacija s paro (134 °C)

- Pred sterilizacijo namestite ovojnico. Transducer je treba med sterilizacijo zaviti. Za sterilizacijo postavite Transducer v posodo za sterilizacijo z visoko temperaturo pare, s temperaturo 134 °C in trajanjem 10 min.
- Temperatura sušenja: 50-70 °C, Čas sušenja: 30 min.

Varnostni in funkcionalni testi

Zagotovite izvajanje varnostnih in funkcionalnih testov za Transducer, Generator in nožno stikalo v skladu z bolnišničnimi postopki in predpisi. Za preskuse varnosti in delovanja drugih komponent, ki jih uporablja več pacientov, glejte navodila za uporabo, specifična za vsako komponento.

Varnostni test

Generator : Pooblaščen bolnišnični tehnik morajo opraviti preskus uhalnega toka.

Nožno stikalo : Preglejte stopalko, priključek kabla in kabel za morebitne razpoke ali poškodbe. Zamenjajte vse poškodovane komponente.

Druge komponente : Preverite vse ostale komponente, kot je navedeno v ustreznih navodilih za uporabo.

Funkcionalni test

Ultrazvočni način

- Pripravite celoten komplet PD Ultrazvočni Škarje in povežite Transducer po navodilih v poglavju II – Namestitev in delovanje opreme.
- Preverite, ali je mogoče vstopiti v delovno stanje. Različni Ultrazvočni Škarje imajo lahko različne vstopne vmesnike. Glejte 1. del, oddelek 3.2. poglavja za podrobna navodila.
- Potrdite prikaz MIN moči 3. stopnje in MAX 5. stopnje moči.
- Pritisnite gumba za povečanje in zmanjšanje moči, da zagotovite, da je mogoče MIN stopnjo moči nastaviti od ravni 1 do 5.
- Vklpite Generator in ga preklopite v ultrazvočni delovni način. Preverite pravilno povezavo Transducer in Ultrazvočni Škarje.
- Z odprto čeljustjo pritisnite gumb "MAX" na nožnem stikalu. Na LCD-zaslону mora biti prikazana najvišja raven moči "5" in oglasiti se mora aktivacijski ton.
- Z odprto čeljustjo pritisnite gumb "MIN" na nožnem stikalu. LCD zaslon bi moral prikazati MIN stopnjo moči in zaslišati se mora ton za aktiviranje.

OPOZORILO : Preden aktivirate sistem, zagotovite, da je čeljust stran od robčkov, drugih instrumentov ali drugih predmetov, da preprečite poškodbe uporabnika.

Bipolarni elektrokirurški način

- Povežite napredni bipolarni elektrokirurški instrument/osnovni bipolarni instrument v skladu z navodili.
- Preverite, ali lahko sistem vstopi v delovni vmesnik. Osnovni bipolarni način bi moral prikazati ikono 30 ravnih moči, napredni bipolarni način pa ikono "napredni bipolarni".
- Rahlo se dotaknite tipk za povečevanje in zmanjševanje moči v osnovnem bipolarnem načinu, da potrdite, da je mogoče raven moči prilagoditi med 1 in 95. Dotaknite se nizkih, srednjih in visokih vrstic za neposreden preklop med 15, 30 in 60.
- Izklopite Generator in počakajte 5 sekund. Nato vklopite napajanje Generator in počakajte 10 sekund. Preverite, ali osnovni bipolarni način prikazuje vmesnik s 30 nivoji moči, napredni bipolarni način pa vmesnik "napredni bipolarni". Preverite, ali je Generator aktiviran v skladu z vnaprej določenimi zahtevami.
- Povežite napredni in osnovni bipolarni elektrokirurški instrumenti in pritisnite enojno nožno stikalo. Preverite, ali na nadzorni plošči utripajo indikatorji ravnih moči, in poslušajte aktivacijski zvok.

OPOZORILO : Preden aktivirate sistem, je strogo prepovedano dovoliti kakršen koli stik naprave Ultrazvočni Škarje z robčki, drugimi instrumenti ali drugimi predmeti, da preprečite poškodbe uporabnika.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Povezano s sistemom

- Pred uporabo preberite navodila in upoštevajte bolnišnične smernice za klinično prakso ultrazvočne kirurgije, elektrokirurgije, ginekologije in laparoskopije.
- Minimalno invazivne naprave se lahko razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Če v ordinaciji hkrati uporabljamo minimalno invazivne instrumente in pripomočke različnih proizvajalcev, pred posegom preverimo združljivost instrumentov in pripomočkov ter preverimo, ali imajo pripomočki, vstavljeni v človeško telo, hrapavo površino, ostre robove ali štrline, ki lahko povzročijo nevarnosti za varnost.
- Ta naprava je namenjena samo za uporabo usposobljenih kirurgov z licenco. Ne uporabljajte elektrokirurških naprav, razen če ste bili ustrezno usposobljeni za njihovo uporabo za določene postopke, ki ga boste morali opraviti. Nestrokovna uporaba te naprave lahko povzroči nenamerno resno poškodbo bolnika, vključno s perforacijo črevesja ter nezavestno in nepopravljivo nekrozo tkiva.
- Ne odpirajte ohišja Generator brez dovoljenja, da se izognete morebitnim nevarnostim električnega udara. Kakršno koli popravilo in nadgradnjo instrumenta mora opraviti servis, ki ga je usposobil in pooblastila družba Reach Surgical, Inc. Tega instrumenta ne uporabljajte za noben drug namen kot za medicinsko kirurgijo.
- Temeljito razumevanje načel in tehnik, vključenih v laserske, elektrokirurške in ultrazvočne postopke, je bistvenega pomena za preprečitev nevarnosti šoka in opeklin za pacienta in medicinsko osebje ter poškodbe te naprave ali drugih medicinskih naprav. Električna izolacija ali ozemljitev ne smeta biti ogrožena. Elektrokirurških naprav ne potaplajte v tekočine, razen če to zahteva konstrukcija in nalepka ne navaja, da jih je treba potopiti.
- Varna in učinkovita ultrazvočna kirurgija in elektrokirurgija nista odvisni le od zasnovane opreme, ampak v veliki meri tudi od številnih dejavnikov, ki jih nadzoruje operater. Za izboljšanje varnosti in učinkovitosti preberite, razumejte in upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.
- Kot pri vseh virih energije (elektrokirurški, laserski ali ultrazvočni) je treba upoštevati rakotvorna in nalezljiva tveganja, ki jih lahko predstavljajo številni stranski produkti tkiva, kot so dim in aerosoli. Pri odprtih in endoskopskih posegih je treba upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe, kot so zaščitna očala, filtrirne maske in učinkovita oprema za odvajanje dima.
- Po odstranitvi naprave preverite hemostazo tkiva. Če hemostaza ni, je treba uporabiti ustrezne metode za doseganje hemostaze.
- Izdelki, ki jih proizvajajo ali distribuirajo podjetja, ki jih Reach Surgical, Inc. ni pooblastila, morda niso združljivi z napravo. Uporaba takih izdelkov lahko povzroči nepričakovane rezultate in lahko poškoduje uporabnika ali pacienta.
- Za zmanjšanje tveganja motenj morata biti naprava in ohišje priključena na neodvisen napajalni tokokrog.
- Oprema ni primerna za uporabo v prisotnosti vnetljive mešanice anestetika z zrakom ali s kisikom ali dušikovim oksidom. Možnost iskanja zaradi trčenja z drugimi kovinskimi napravami. Iskre lahko vnamejo vnetljive pline, kot so na primer plini iz polja.
- Delovati mora v zahtevanem območju delovne temperature okolja.
- Izhodna napetost vtičnice mora ustrezati zahtevam Generator (poglavje "Sistemijski tehnični pogoji"). Če napajalnik ni pravilno priključen, lahko poškoduje Generator in povzroči električni udar ali nevarnost požara.
- Ne uporabljajte podaljškov, da preprečite nevarnost požara.
- Aktivacijskega tona ne spreminjajte na neslišno raven. Osebe kirurške ekipe lahko opazi tone aktiviranja, medtem ko Generator dovaja energijo.
- Izkazalo se je, da je dim, ki nastaja med elektrokirurgijo, potencialno škodljiv za bolnike ali osebe kirurške ekipe. Predlagajte ustrezno prezačevanje s kirurškim odvodom dima ali na drug način.
- V napravi Ultrasonic Surgical Integrated Generator so nekatere komponente, ki se pošiljajo nesterilne (npr. Transducer). Pred začetkom namestitve sistema izdelek po potrebi sterilizirajte. Za navodila za čiščenje in sterilizacijo glejte vsako ustrezno navodilo.
- Da bi se izognili poškodbam uporabnikov ali pacientov, se mora Ultrazvočni Škarje izogibati drugim napravam, kirurškim zavesam, bolnikom ali drugim predmetom, preden pritisnete gumb za testiranje in med preverjanjem sistema. Varnostni ukrepi v primeru aerosola (v skladu z bolnišničnimi predpisi) se izvajajo pri pregledu sistema in testni metodi.
- Ne pritiskajte preveč na čeljust, da preprečite pretok ultrazvočne energije.
- Da preprečite poškodbe uporabnika, se mora rezilo pred aktiviranjem sistema izogibati stiku s tkivom, drugimi napravami ali drugimi predmeti.
- Če tekočino poškropite ali polijete po Generator ali vanj ali če Generator razlijete ali zlijete vanj, lahko poškodujete Generator in povzročite električni udar ali nevarnost požara.
- Iskanje in segrevanje, povezano s tehnikami zapiranja posod, sta lahko vir vžiga. Gaza in goba naj ostaneta vlažni. Elektrokirurške elektrode hranite proč od gorljivih materialov in okolij, bogatih s kisikom (O₂).
- Če je naprava Transducer znatno poškodovana ali če kateri koli del kaže znake poškodbe po vzdrževanju čiščenja in razkuževanja, jih zavrzite. Poškodovani deli so jasno označeni, da preprečite zlorabo pred nadaljnji ravnanjem.

- Odpadke za enkratno uporabo in elektronske odpadke je treba odstraniti v skladu z bolnišničnimi predpisi in jih ne smete poljubno odvreči, da preprečite onesnaževanje okolja.
- Izogibajte se uporabi Generator blizu druge opreme ali naloženi nanjo. Če je potrebna sosednja ali zložena uporaba, nadzorujte Generator in drugo opremo, da zagotovite pravilno delovanje.
- Naprava ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih servisiral operater. Za servis se obrnite na prodajnega zastopnika družbe Reach Surgical ali servisno oseboje.
- Pred uporabo preverite vse naprave, povezane s sistemom, in povezave. Preverite, ali naprava deluje, kot je bilo predvideno. Nepravilna povezava lahko povzroči iskrjenje, iskrjenje, okvaro naprave ali neželene kirurške rezultate.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, mora biti ta oprema priključena le na napajanje z zaščitno ozemljitvijo.
- Naj bo čim dlje med Generator in drugimi elektronskimi napravami (npr. monitoriji). Električnih žic ne prekrizajte in ne privezujte na elektronske naprave. Generator lahko povzroči motnje v drugih elektronskih napravah.
- Sistem je treba uporabljati previdno ob prisotnosti notranjih in zunanjih srčnih spodbujevalnikov. Motnje, ki jih povzročijo uporaba Elektrokirurški instrumenti, lahko povzročijo, da srčni spodbujevalnik preide v asinhrono stanje ali popolnoma prepreči njegovo delovanje. Če so naprave za elektrokirurgijo ali tesnenje tkiv namenjene uporabi pri bolnikih s srčnimi spodbujevalniki, se za dodatne informacije obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali bolnišnični kardiološki oddelek.
- Bodite previdni, če zlagate instrumente na vrh Generator ali postavljate Generator na vrh električnih instrumentov. To je nestabilna konfiguracija in ne zagotavlja ustreznega hlajenja.
- Če Generator odpove, lahko povzroči kirurško prekinitev. Na voljo mora biti rezervni sistem.
- Če to zahtevajo lokalni predpisi, je treba Generator povezati z ekvipotencialnim priključkom bolnišnice z izenačitvijo potencialov.
- Kadar se sistem in oprema za fiziološki nadzor uporabljata hkrati na istem pacientu, mora biti katera koli nadzorna elektroda nameščena čim dlje od instrumenta.
- V osnovnem bipolarnem načinu izberite najnižjo možno izhodno moč za želeni učinek.
- Okvara visokofrekvenčne kirurške opreme lahko povzroči nepričakovano povečanje izhodne moči.
- Generator in osnovni bipolarni elektrokirurški priključek lahko vdre voda ali delci. Pri uporabi in čiščenju se je potrebno izogibati vdoru vode ali trdnih delcev.
- Ko se sistem uporablja v kombinaciji z endoskopom, lahko poveča tok uhajanja na telesu bolnika. Med postopkom bodite pozorni.
- Obvestilo uporabniku in/ali pacientu, da je treba vsak resen incident, ki se je zgodil v zvezi z napravo, prijaviti Reach Surgical, Inc. prek Reachquality@reachsurgical.com. in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.

Povezava z instrumentom

Med kirurškimi posegi se je pomembno zavedati, da se lahko končni del instrumenta Ultrazvočni Škarje, Ultrazvočni Škarje blazinice in Os segreje, ko se na tkivo dlje časa uporablja ultrazvok ali bipolarni elektrokavter. Za zagotovitev varnosti je ključnega pomena, da se med postopkom izognete kakršnemu koli nenamernemu stiku teh komponent instrumenta s tkivom, kirurškimi zavesami, kirurškimi plašči ali drugimi nepovezanimi območji.

Poleg tega je pomembna previdnost pri nameščanju bipolarnega instrumenta. Natančneje, ne sme biti v bližini ali v stiku z vnetljivimi materiali, kot so gaza ali kirurške zaveske. Bipolarni instrumenti, uporabljeni v tem kontekstu, lahko med uporabo proizvajajo toploto, kar bi lahko povzročilo nevarnost požara. Ko bipolarnega elektrokirurškega aparata Generator ne uporabljate, ga pravilno shranite v zaščitni ovoj ali ga hranite na varni razdalji od pacienta, članov kirurške ekipe in vseh gorljivih materialov.

OPOMBA : Za dodatna opozorila in previdnostne ukrepe glejte ustrezna navodila za uporabo.

EMC informacije

Izdelek je opravljal preizkus elektromagnetne združljivosti, ki izpolnjuje omejitvene zahteve standarda IEC60601-1-2 za medicinsko opremo. Te omejitve zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v običajnih medicinskih napravah.

Sestava izdelka

Serijska številka	Ime dela	Št. modela/različice	Opombe
1	Elektrokirurški instrument	OP9	/
2	Transducer za ultrazvočno kirurško opremo	TRA6	Zdržljiva uporaba
3	Ultrazvočni Škarje Sistem za enkratno uporabo Ultrazvočni Škarje	CH14PD, CH23PD, CH36PD, CH45PD, SRB14, SRB23, SRB36, SRB45, SRE14, SRE23, SRE36, SRE45	Zdržljiva uporaba
4	Ultrazvočna visokofrekvenčna enota za enkratno uporabo Tesnilo za tkivo	OSA23, OSA37, OSA44	/
5	Ultrazvočno nožno stikalo	OP-FSD	/
6	Elektrokirurško nožno stikalo	OP-FSS	/
7	Bipolarni konektor za elektrokirurgijo	OP-BPC	/

Kabel izdelka

Serijska številka	Ime kabla	Dolžina (m)	Zaščiten
1	Kabel za nožno upravljanje	3	ja
2	Napajalni kabel	5	št
3	Bipolarni elektrokirurški kabel	3	št
4	Kabel Transducer	2.9	ja

EMC zmogljivost

Ta oprema je lahko izpostavljena radiofrekvenčnim motnjam, ki jih povzročata druga medicinska oprema in radijske komunikacije. Da bi preprečili takšne motnje, je bil ta izdelek testiran v skladu z IEC 60601-1-2 in izpolnjuje njegove zahteve. Vendar Reach Surgical, Inc. ne jamči, da ne bo nobenih motenj v posameznih okoljih namestitve.

Če se ugotovi, da je naprava motena (kar je mogoče ugotoviti v vklopom in izklopom naprave), mora uporabnik (ali vzdrževalno oseboje, ki ga odobri Reach Surgical, Inc.) poskusiti sprejeti ukrepe ali več naslednjih ukrepov za rešitev problem z motnjami:

Prilagodite smer ali položaj naprave, ki vpliva nanjo.

Povečajte razdaljo med to napravo in napravo pošiljateljico.

Za napajanje te opreme uporabite druge vire napajanja (namesto energije, ki vpliva na opremo).

Za druge predloge se posvetujte z dobaviteljem ali predstavnikom servisa.

Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli motnje, ki jih povzročijo naslednje situacije: uporabite druge povezovalne kable, ki niso priporočeni; spreminjati ali modificirati to opremo brez dovoljenja. Nepooblaščen spremembe ali modifikacije lahko povzročijo izgubo učinkovitosti opreme.

Vse vrste elektronske opreme lahko povzročijo elektromagnetne motnje drugi opremi prek zraka ali drugih kablov, povezanih z njo. V bližini te naprave ne uporabljajte naprav, ki lahko oddajajo RF signale, kot so mobilni telefoni, radijski sprejemniki ali izdelki za radijsko upravljanje, saj lahko to povzroči, da delovanje te naprave ne bo izpolnjevalo navedenih specifikacij. Ko so takšne naprave v bližini te naprave, jih izklopite. Zdravstveno oseboje, ki je odgovorno

za to opremo, bi moralo poučiti tehnikom, pacientom in drugemu osebje, ki je lahko v bližini te opreme, da v celoti izpolnjujejo zgornje zahteve. Da bi uporabnik v celoti dosegel navedeno učinkovitost EMC, mora izdelek pravilno namestiti v skladu s koraki, opisanimi v priročniku. Če imate težave, povezane z elektromagnetno združljivostjo, se obrnite na vzdrževalno osebje, ki ga je odobrilo podjetje Reach Surgical, Inc. Transducer (s kablom) in Ultrazvočni Škarje sta opredeljena kot uporabni del celotnega sistema.

Pravidnostni ukrepi za namestitve izdelka

Opremo je mogoče uporabljati v bolnišničnem okolju, vendar ne vključuje prostorov za radiofrekvenčno zaščito okoli aktivne radiofrekvenčne kirurške opreme ali tam, kjer je nameščena udarna oprema z magnetno resonanco, ker je intenziteta elektromagnetnih motenj na teh lokacijah visoka. Ločevalna razdalja in vpliv opreme za fiksno radijsko komunikacijo: jakost magnetnega polja, ki jo ustvarjajo fiksni oddajniki, kot so bazne postaje brezžičnih (celičnih/brezžičnih) telefonov, kopenski mobilni radijski sprejemniki, amaterski radijski sprejemniki, radijske oddaje AM in FM ter TV oddaje Generators , itd., teoretično ni mogoče natančno izmeriti. Za oceno elektromagnetnega okolja, ki ga ustvarjajo fiksni RF oddajniki, je treba razmisлити o merjenju elektromagnetnega polja. Če izmerjena vrednost jakosti magnetnega polja na lokaciji naprave presega ustrezno radiofrekvenčno raven, določeno v "Izjavi o preprečevanju motenj", je treba napravo pregledati, da se zagotovi, da lahko normalno deluje. Če se odkrije neobičajni pogoji delovanja, je treba razmisлити o dodatnih meritvah, na primer o preusmeritvi ali premešitvi opreme ali uporabi protiradiofrekvenčne sobe.

- 1) Uporabite napajalni kabel, ki ga je priskrbel ali določil Reach Surgical, Inc. Izdelke, uporabljen z napajalnim vtičem, je treba priključiti v fiksno električno vtičnico z zaščitno ozemljitvijo. Za priključitev napajalnega vtiča ne uporabljajte nobene vrste adapterja ali priključka .
- 2) Napravo hranite čim dlje stran od drugih elektronskih naprav.
- 3) Sledite korakom za povezavo naprave.

Splošne opombe

(1) Specifikacija kabla.

Uporaba kablov, ki jih zagotovi Reach Surgical, Inc, ne bo poškodovala učinkovitosti EMC tega izdelka. Če uporabljate nedoločene kable, se lahko EMC zmogljivost te opreme znatno zmanjša.

(2) Varnostni ukrepi za nepooblaščen spremembe

Uporabnik ne sme spreminjati tega izdelka, sicer se lahko EMC učinkovitost tega izdelka zmanjša.

Modifikacija izdelka vključuje naslednje spremembe:

- a. Kabel (dolžina, material in ožičenje itd.).
- b. Namestitvev/postavitvev opreme.
- c. Konfiguracija/komponente opreme.
- d. Zaščitni deli opreme (deli za odpiranje/zapiranje in pritrditev pokrova).

(3) Med delovanjem opreme morajo biti vsi zaščitni pokrovi zaprti.

Ta izdelek naj bi se uporabljal v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju, kupec in uporabnik tega izdelka pa morata zagotoviti, da se uporablja v tem elektromagnetnem okolju.

Essential Performance

1. Za napredno visokofrekvenčno radijsko izhodno energijo mora sistem zagotoviti, da odstopanje nazivne izhodne moči ne presega 20 % standardne vrednosti.

2. Za osnovno visokofrekvenčno radijsko izhodno energijo mora sistem zagotoviti, da odstopanje nazivne izhodne moči ne presega 20 % standardne vrednosti.

Smernice in izjava PROIZVAJALCA - ELEKTROMAGNETNE EMISIJE		
Naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je določeno kot sledi.		
Stranka ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.		
Prekus emisij	Skladnost	Elektromagnetno okolje – napotki
RF emisije CISPR 11	Skupina1	Naprava uporablja RF energijo samo za svoje notranje delovanje. Zato so njegove radiofrekvenčne emisije zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale motenj v bližnji elektronski opremi.
RF emisije	Razred A	Zaradi značilnosti EMISIJ te opreme je primerna za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah
Harmonični tok IEC 61000-3-2	Razred A	
Spremembe napetosti/Nihanja napetosti/utripanje IEC 61000-3-3	Ustreza	

Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost

Naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je določeno kot sledi.

Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju

Test IMUNOSTI	IEC 60601 testni nivo	Stopnja skladnosti	Elektromagnetno okolje – napotki
elektrostatična praznjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV zrak	± 8 kV kontakt ± 2,4,8 ,15kV zrak	Tla naj bodo lesena, betonska ali keramična. Če so tla prekrita s sintetičnim materialom, Relativna vlažnost mora biti najmanj 30 %.
Hiter električni prehod/ izbruh IEC 61000-4-4	± 2 kV za napajalne vode ± 1 kV za vhodne/izhodne linije	± 2 kV za napajalne vode ± 1 kV za vhodne/izhodne linije	Kakovost električnega omrežja mora ustrezati tipičnemu komercialnemu ali bolnišničnemu okolju.
Napetost IEC 61000-4-5	± 1 kV linija(-e) do linije(-ov) ± 2 kV vodi(-i) do zemlje	± 1 kV linija(-e) do linije(-ov) ± 2 kV vodi(i) do zemlje	Kakovost električnega omrežja mora ustrezati tipičnemu komercialnemu ali bolnišničnemu okolju.
Napetostni padci, kratki prekinitive na vhodnih napajalnih linijah IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cikla pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 315° 0 % UT; 1 cikel in 70 % UT; 25/30 ciklov Enofazni: pri 0° 0 % UT; 250/300 ciklov	0 % UT; 0,5 cikla Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 315° 0 % UT; 1 cikel in 70 % UT; 25/30 ciklov Enofazni: pri 0° 0 % UT; 250/300 ciklov	Kakovost električnega omrežja mora ustrezati tipičnemu komercialnemu ali bolnišničnemu okolju. Če uporabnik ultrazvočne kirurgije Oprema zahteva neprekinjeno delovanje med prekinitivami električnega omrežja, zato je priporočljivo, da ultrazvočni kirurški Oprema se napaja iz brezprekinitvenega napajanja ali baterije.
Frekvenca napajanja (50/60 Hz) Magnetno polje IEC 61000-4-8	30 A/min	30 A/min	Magnetno močnostna frekvenca Polja morajo biti na ravni značilnosti. Na tipični lokaciji v tipičnem poslovnem ali bolnišničnem okolju.

Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost			
Naprava je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, ki je določeno kot sledi. Stranka ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju			
IMUNOST test	Test IEC 60601 ravni	Skladnost ravni	Elektromagnetno okolje - vodenje
Izveden RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz 6 V v pasovih ISM med 0,15 MHz in 80 MHz	3V	Prenosne in mobilne RF komunikacije Oprema se ne sme uporabljati bližje kateremu koli delu naprave, vključno s kabli, kot je priporočena razdalja, izračunana iz enačbe za frekvenco oddajnika. Priporočena ločilna razdalja $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$
Sevana RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,7 GHz 80 % AM pri 1 kHz	3V/m	$d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$ 80MHz do 800MHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$ 800MHz do 2,7GHz kjer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika in d je priporočena razdalja v metrih (m). Poljske jakosti fiksnih RF oddajnikov, kot je bilo ugotovljeno z elektromagnetnim pregledom lokacije 3, bi morale biti nižje od ravnih skladnosti v vsakem frekvenčnem območju. Motnje lahko nastanejo v bližini opreme, označene z naslednjim simbolom:  VRATA OHIŠJA ME OPREME in ME SISTEMOV se preskusijo, kot je določeno v tabeli 9 standarda IEC 60601-1-2, z uporabo preskusnih metod, določenih v standardu IEC 61000-4-3.

Priporočene ločilne razdalje med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo ter napravami.
Ultrazvočna oprema za kirurgijo je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so sevine RF motnje nadzorovane. Stranka ali uporabnik naprave lahko pomaga pri preprečevanju elektromagnetnih motenj tako, da vzdržuje minimalno razdaljo med prenosno in mobilno RF komunikacijsko opremo (oddajniki) in Napravo, kot je priporočeno kot sledi, v skladu z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.

Največja nazivna izhodna moč oddajnika (w)	Ločevalna razdalja glede na frekvenco oddajnika /m		
	150 kHz do 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz do 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,36999	0,36999	0,73681
1	1.17	1.17	2.33
10	3,69986	3,69986	7,36811
100	11.7	11.7	23.3

OPOMBA : Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnega sevanja vplivata absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.

Tehnični pogoji

Komponente, potrebne za delovanje sistema: Elektrokirurški instrument , Transducer, Ultrazvočno nožno stikalo, Elektrokirurško nožno stikalo, Ultrazvočni Škarje ali Elektrokirurški ročniki , Bipolarni instrument za elektrokirurgijo z bipolarnim priključkom.


Glejte opis izdelka za to komponento.

Stopnja zaščite pred električnim udarom	Ultrazvok:  Uporabni del tipa CF; Uporabni del tipa CF za bipolarno elektrokirurško defibrilacijo 
Stopnja zaščite pred električnim udarom	razred I
Generator do škodljivih infuzij	Normalna oprema
Stopnja zaščite pred škodljivim vdorom vode	Nožno stikalo: IP68
Kategorija upravljanja	Razred IIb
Zahteve za parametre ultrazvočnega načina:	
Vhodna moč	Napajalna napetost: 100-240V Napajalna frekvenca: 50Hz/60Hz Vhodna moč: 400VA
Zahteve za parametre ultrazvočnega načina:	
Frekvenca vzbujanja	54 kHz - 57 kHz
Primarna vibracija konice	25 μm ~ 110 μm
Ultrazvočni Škarje glavna akustična izhodna površina konice izdelka:	1,53-2,75 mm2
Sekundarna zamrežena akustika pri Ultrazvočni Škarje Tip izhodno območje:	19,32-35,88 mm2
Izvedeni izhodni zvok pri Ultrazvočni Škarje konici pri referenčni konici Primarna amplitudna moč	< 30 W
Vrsta krmljenja frekvence sistema	Neodvisno od obremenitve se frekvenca vzbujanja avtomatsko stalno nastavlja.
Indeks rezerve moči	Ne manj kot 2,5
Zahteve za elektrokirurške parametre:	
Delovna frekvenca	400 kHz ± 5%

Največja izhodna napetost	≤ 250V
Napredni bipolarni način Največji izhodni tok	≤ 5,5 A
Osnovni bipolarni način Največji izhodni tok	≤ 2,2 A
Največja izhodna napetost od vrha do vrha	≤ 500 Vpk
Peak Factor	1,6 ± 0,4
Nazivna moč	Radiofrekvenčni napredni bipolarni: 270 W Radijska frekvenca Basic bipolar: 95W
Nazivna obremenitev	Radiofrekvenčni napredni bipolarni: 30Ω Radijska frekvenca Osnovni bipolarni: 200Ω

Pogoji delovnega okolja	Temperatura: 10 °C do 30 °C Relativna vlažnost: ≤ 70% Razpon atmosferskega tlaka: 800 hPa do 1060 hPa
Pogoji prevoza in skladiščenja	Temperatura: -30 °C do +55 °C (Generator, nožno stikalo, adapter) Temperatura: -10 °C do +55 °C (Ultrazvočni Škarje) Vlažnost: ≤ 80% Razpon atmosferskega tlaka: 800 hPa do 1060 hPa
Datum izdelave	Datum izdelave je mogoče določiti s serijsko številko na hrbtni plošči Generator.
Napajalni kabel	Skladnost s certifikacijskimi zahtevami CCC Trenutna moč: 10A
Stopnja vztrajnosti	Določeno z ročnikom Transducer in uporabljenim Ultrazvočni Škarje. Za informacije o stopnji vztrajnosti glejte veljavno Ultrazvočni Škarje in Transducer Navodila za ročnik ali 7. poglavje – Opozorila in previdnostni ukrepi.
Varovalka	ϕ5 * 20 T8AH250V
Teža (brez embalaže)	Generator: nominalna teža 8 kg
Skupna prostornina	OP9 Generator: (dolžina * širina * višina): 34 cm-34 cm-16 cm
Dispozicija	Nekatere notranje komponente Generator, nožno stikalo in kabel nožnega stikala vsebujejo svinec. Po domače Zahteve in predpisi za odstranjevanje. Baterije zavržite v skladu z ustreznimi postopki za odlaganje odpadkov.
Razvrstitev AP/APG	Ni oprema AP/APG.
Življenjska doba:	Življenjska doba: 7 let
Različica izdaje programske opreme	V01.01


Bipolarna izhodna valovna oblika krivulja moči in obremenitve

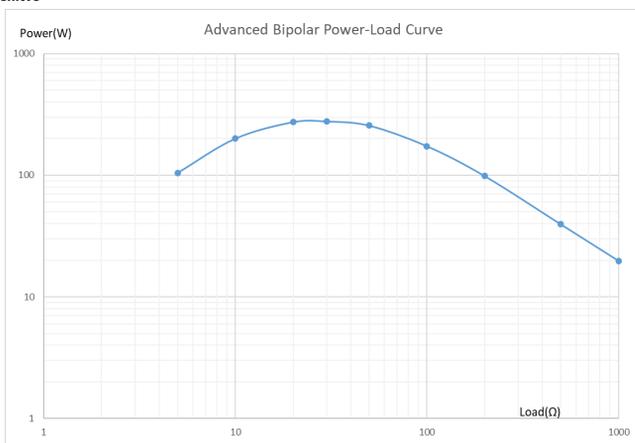

OMEJITEV KRIVULJE MOČI Max Izhodna moč : 270 [W]			
Obremenitev (Ω)	Spodnja meja	Nazivna	Zgornja meja
5	83.6	104.5	125.4
10	159,84	199.8	239,76
20	216	270	324
30	216	270	324
50	204,64	255.8	306,96
100	138,72	173.4	208.08
200	78,88	98.6	118.32
500	31.6	39.5	47.4
1000	15.84	19.8	23.76

Nazivna krivulja moči 270 vatov izhodne moči pri nazivni obremenitvi v skladu z mejo toka/napetosti merilnika krivulje moči. Krivulja moči predstavlja ovojnico, ki se spreminja glede na pogoje delovanja.


Osnovna bipolarna krivulja polne moči in obremenitve

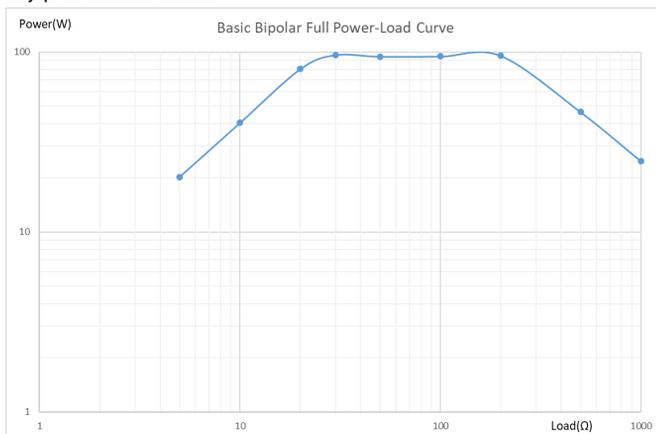

Omejitev polne krivulje moči [W]: največja moč 95 vatov

Obremenitev (Ω)	Spodnja meja	Nazivna	Zgornja meja
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	64.48	80.6	96.72
30	76	95	114
50	75.52	94.4	113.28
100	75.68	94.6	113.52
200	76	95	114
500	37.12	46.4	55.68
1000	19.76	24.7	29.64


Osnovna bipolarna izhodna krivulja polovična moč- obremenitev

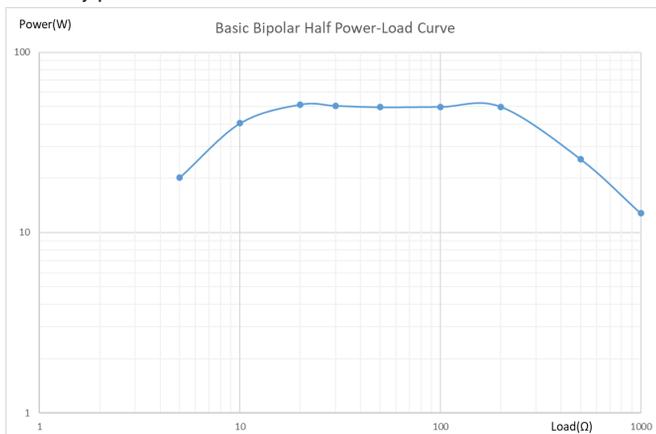

Omejitev polovične krivulje moči [W]: največja moč 50 vatov

Obremenitev (Ω)	Spodnja meja	Nazivna	Zgornja meja
5	16.16	20.2	24.24
10	32.32	40.4	48.48
20	40	50	60
30	40	50	60
50	39.68	49.6	59.52
100	39.84	49.8	59.76
200	39.92	49.9	59.88
500	20.48	25.6	30.72
1000	10.24	12.8	15.36

Izhodna moč v primerjavi z nastavitvami moči za moč v običajnem bipolarnem načinu

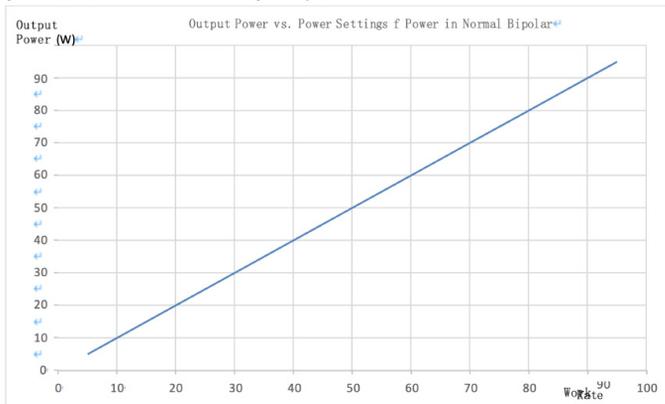

Izhodna moč v primerjavi z nastavitvami vrednostjo moči za normalno bipolarno napetost [W]; Obremenitev: 200W			
Nastavljena moč (W)	Spodnja meja izhodne moči (W)	Nazivna moč (W)	Zgornja meja izhodne moči (W)
5	1	5	10
10	5	10	15
15	10	15	20
20	15	20	25
30	24	30	36
45	36	45	54
60	48	60	72
75	60	75	90
95	76	95	114

Servis in garancija

Reach Surgical, Inc. jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi ob normalni uporabi in preventivnem vzdrževanju v garancijskem obdobju, ki je navedeno spodaj. Obveznost podjetja Reach Surgical v skladu s to garancijo je omejena na popravilo ali zamenjavo, po lastni izbiri, katerega koli okvarjenega izdelka ali dela, ki je bil vrnjen podjetju Reach Surgical, Inc. ali njegovemu pooblaščenemu distributerju v veljavnem garancijskem obdobju in je bilo ugotovljeno, da je okvarjen podjetju Reach Surgical. zadovoljstvo. Ta garancija ne velja za izdelke ali dele, ki so bili:

- Negativno vpliva zaradi uporabe z nepooblaščenimi napravami, ki jih proizvajajo ali distribuirajo osebe, ki jih Reach Surgical, Inc. ni pooblastilo.
- Popravljeno ali spremenjeno zunaj Reach Surgical's tovarne, če to vpliva na stabilnost ali zanesljivost naprave, kot je določil Reach Surgical.
- Predmet nepravilne uporabe, malomarnosti ali nesreče.
- Uporablja se na način, ki ni v skladu z zasnovo, parametri uporabe, navodili in smernicami za izdelek ali z industrijsko sprejetimi funkcionalnimi, operativnimi ali okoljskimi standardi za podobne izdelke.

Garancijski roki

Osnovni bipolarni energetski konektor (OP-BPC): 1 leto za komponente in delo.

Generator (OP9): 1 leto za komponente in delo.

Nožno stikalo/napajalni kabel: 1 leto za komponente in delo.

Ta garancija je izključno pravno sredstvo za prvotnega kupca in nadomešča vsa druga jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z jamstvi o prodaji in primernosti za določen namen. Reach Surgical, Inc. ni odgovoren za nobeno posebno, naključno ali posledično škodo, vključno s škodo, ki je posledica izgube uporabe, dobička, poslovanja ali dobrega imena, razen kot izrecno določa veljavna zakonodaja.

Reach Surgical, Inc. ne pooblašča nobene osebe za prevzem kakršne koli dodatne odgovornosti v zvezi s prodajo ali uporabo svojih izdelkov. Ni garancij, ki bi preseglele tukaj navedene pogoje.

Reach Surgical, Inc. si pridržuje pravico do sprememb svojih izdelkov, ne da bi pri tem prevzel kakršno koli obveznost retroaktivne uporabe teh sprememb na predhodno prodanih ali izdelanih izdelkih.

Symbols

	<p>BG Уникален идентификатор на устройството CS Jedinečný identifikátor zařízení DE Eindeutige Gerätekennung EL Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής ES Identificador único del dispositivo ET Unikaalne seadme identifikaator FR Identificateur unique du dispositif HR Jedinstveni identifikator uređaja HU Egyedi eszközazonosító</p>	<p>IT Identificatore unico del dispositivo LT Unikalus įrenginio identifikatorius LV Unikāls ierīces identifikators NL Unieke apparaatidentificatiecode PL Unikalny identyfikator urządzenia PT Unieke apparaatidentificatiecode RO Identificatorul unic al dispozitivului SK Jedinečný identifikátor zariadenia SL Edinstveni identifikator naprave</p>
	<p>BG Вижте ръководството за употреба CS Viz návod k použití DE Siehe Gebrauchsinformation EL Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/ φυλλάδιο οδηγιών ES Consultar el manual de instrucciones/manual ET Vt kasutusjuhend FR Se reporter au manuel/notice d'utilisation HR Pogledajte upute za uporabu HU Olvassa a használati útmutató!</p>	<p>IT Consultare le istruzioni del Manuale d'Uso LT Žr. Instrukcijos vadovą NL Skat. instructieju rokasgrāmatu LV Raadpleeg de gebruiksaanwijzing PL Patrz instrukcja obsługi PT Consulte o manual/folheto de instruções RO Consultați manualul de instrucțiuni SK Pozrite referenčný manual SL Oglejte si navodila za uporabo</p>
	<p>BG Тип CF Приложена част CS Typ CF Aplikovaná část DE Anwendungsteil vom Typ CF EL Εφαρμοσμένο εξάρτημα τύπου CF ES Componente aplicado de tipo CF ET Tüüp CF Rakendatud osa FR Partie appliquée de type CF HR Primijenjeni dio tipa CF HU CF típusú Alkalmazott rész IT PARTE APPLICATA TIPO CF conforme ai requisiti IEC60601-1 per fornire maggiore protezione contro il rischio di scossa elettrica rispetto a quella offerta da PARTI APPLICATE DI TIPO CF</p>	<p>LT Tipas CF Taikoma dalis LV CF veida lietišķā daļa NL Type CF Toegepast onderdeel PL Typ CF Zastosowana część PT Tipo de peça aplicada CF RO Tip CF Partea aplicată SK Typ CF Aplikovaná časť SL Uporabljeni del tipa CF</p>
	<p>BG Рециклируеми CS Recyklovatelný DE Recyclebar EL Ανακυκλώσιμο ES Reciclable ET Korudkasutatav FR Recyclable HR Recikliran HU Újrahasznosítható</p>	<p>IT Riciclabile LT Perdirbama LV Pārstrādājams NL Recyclebaar PL Nadające się do recyklingu PT Reciclável RO Reciclabil SK Recyklovateľný SL Možno reciklirati</p>
	<p>BG Електрическо и електронно оборудване, разделно събиране CS Elektrická a elektronická zařízení, oddělený sběr DE Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften EL Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χωριστή συλλογή ES Eliminación adecuada del equipo de conformidad con las normas locales ET Elektri- ja elektroonikaseadmed, eraldi kogumine FR Éliminer l'équipement correctement conformément aux réglementations locales HR Električna i elektronička oprema, odvojeno prikupljanje HU Gyűjtse szelektíven az elektromos és az elektronikus berendezéseket! IT Raccolta separata dispositivi elettrici ed elettronici LT Elektros ir elektroninė įranga, atskiras surinkimas LV Elektriskās un elektroniskās iekārtas, atsevišķa savākšana NL Elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden inzameling PL Sprzęt elektryczny i elektroniczny, selektywna zbiórka PT Descarte apropriado do equipamento de acordo com as regulações locais RO Echipamente electrice și electronice, colectare separată SK Elektrické a elektronické zariadenia, separovaný zber SL Električna in elektronska oprema, ločeno zbiranje</p>	<p>ES Standby LT Budėjimo režimas LV Gaidīšanas režīms NL Stand-by PL Czekaj PT Em espera RO Standby SK Zálaha SL V stanju pripravljenosti</p>
	<p>BG В готовност CS Pohotovostní režim DE Standby EL Αναμονή IT Standby ET Ooterežiim FR Veille HR Pričekaj HU Készenlét</p>	<p>ES Standby LT Budėjimo režimas LV Gaidīšanas režīms NL Stand-by PL Czekaj PT Em espera RO Standby SK Zálaha SL V stanju pripravljenosti</p>
	<p>BG Течен кристален екран CS Obrazovka z tekutých krystalů DE Flüssigkristall-Bildschirm EL Οθόνη υγρών κρυστάλλων ES Pantalla de cristal líquido ET Vedelkristallkuvar FR Écran à cristaux liquides SL Zaslon s tekućimi kristalima HU Folyadékkristályos képernyő</p>	<p>IT Display a cristalli liquidi LT Skystųjų kristalų ekranas LV Šķidrno kristālu ekrāns NL LCD- scherm PL Wyświetlacz ciekłokrystaliczny PT Ecrã de cristais líquidos RO Ecran LCD CS Obrazovka z tekutých krystalů SL Zaslon s tekoćimi kristali</p>

	<p>BG Цокъл на трансдуктора CS Zásuvka snímače DE Steckdose für Transduktor EL Υποδοχή μορφοτροπέα ES Transductor de toma ET Muunduri pesa FR Prise de transducteur HR Utičnica pretvarača HU Átalakító aljzat</p>	<p>IT Presa del trasduttore LT Keitiklio lizdas LV Pārveidotāja ligzda NL Transducer stopcontact PL Gniazdo przetwornika PT Tomada transdutor RO Soclu transductor SK Zásuvka prevodníka SL Vtičnica pretvornika</p>
	<p>BG Потенциално изравняване CS Vyrovnaní potenciálu DE Potentialausgleich EL Πιθανή εξισορρόπηση ES Ecuación de potencial ET Potentsiaal Võrdustamine FR Egalisation potentielle HR Izjednačavanje potencijala HU Potenciális kiegyenlítés</p>	<p>IT Equalizzazione potenziale LT Potencialų išlyginimas LV Potenciāla izlīdzināšana NL Potentiaal vereffening PL Wyrównanie potencjałów PT Equalização Potencial RO Egalizare potențială SK Vyrovnanie potenciálov SL Izenačevanje potenciala</p>
	<p>BG Ключ за прекъсване CS Zásuvka nožního spínače DE Steckdose für Fußschalter EL Υποδοχή ποδοδιακόπτη ES Interruptor de pie ET Jalalüliti pesa FR Prise interrupteur à pied HR Utičnica za nožni prekidač HU Lábkapcsoló aljzat</p>	<p>IT Presa con interruttore a pedale LT Kojinio jungiklio lizdas LV Kāju slēdža ligzda NL Voetschakelaar aansluiting PL Gniazdo przełącznika nożnego PT Soquete do pedal RO Priză de întrerupător de picior SK Zásuvka nožného spínača SL Vtičnica nožnega stikala</p>
	<p>BG Упълномощен представител в Европейската общност CS Autorizovaný zástupce v Evropském společenství DE Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft EL Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ES Representante autorizado en la Comunidad Europea ET Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses FR Mandataire Européen HR Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici HU Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben</p>	<p>IT Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea LT Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje LV Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā NL Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie PL Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej PT Representante autorizado na União Europeia RO Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană SK Autorizovaný zástupca pre Európske spoločenstvo SL Pooblaščen zastopnik za Evropsko skupnost</p>
	<p>BG Да не се използва, ако опаковката е повредена. CS Nepoužívejte, pokud je balení poškozené. DE Nicht verwenden, falls die Verpackung beschädigt ist. EL Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία εμφανίζει ρήξη. ES No utilizar si el envase está dañado. ET Mitte kasutada, kui pakend on kahjustunud. FR Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé HR Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno. HU Ne használja, ha a csomagolás fel van bontva vagy sérült.</p>	<p>IT Non usare se la confezione è danneggiata. LT Nenaudoti, jei pakuočių pažeista. NL Neizmantojiet, ja iepakojums ir bojāts. NL Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. PT Não utilizar se a embalagem estiver danificada RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. SK Nepoužívať, ak je balenie poškodené. SL Če je ovojnina poškodovana, ne uporabljajte.</p>
	<p>BG Производител CS Výrobce DE Hersteller EL Κατασκευαστής ES Fabricante ET Tootja FR Fabricant HR Proizvođač HU Gyártó</p>	<p>IT Fabbricante LT Gamintojas LV Ražotājs NL Fabrikant PL Producent PT Fabricante RO Producător SK Výrobca SL Proizvajalec</p>
	<p>BG Дата на производство CS Datum výroby DE Herstellungsdatum EL Ημερομηνία κατασκευής ES Fecha de manufactura ET Tootmiskuupäev FR Date de fabrication HR Datum proizvodnje HU Gyártás ideje</p>	<p>IT Data di Produzione LT Pagaminimo data LV Ražošanas datums NL Fabricagedatum PL Data produkcji PT Data de fabricação RO Data fabricației SK Dátum výroby SL Datum proizvodnje</p>
	<p>BG Серийен номер CS Sériové číslo DE Seriennummer EL Σειριακός αριθμός ES Número de serie ET Seeria number FR Numéro de série HR Serijski broj HU Sorszám</p>	<p>IT Numero di serie LT Sėrijas numurs LV Serijos numeris NL Seriennummer PL Numer seryjny PT Número de série RO Număr de serie SK Sériové číslo SL Serijska številka</p>
	<p>BG Код на партида CS Číslo šarže DE Chargenbezeichnung EL Κωδικός παρτίδας ES Código de lote ET Partitiühis FR Numéro de lot HR Šifra serije HU Gyártási tételszám</p>	<p>IT Codice lotto LT Partijos kodas LV Partijas kods NL Partijcode PL Kod partii PT Código do lote RO Cod lot SK Číslo šarže SL Oznaka serije</p>

	<p>BG Използвай до дата CSPoužitelné do DE Verw. Bis EL Ημερομηνία λή ESUtilizar antes de ETKasutamise lõpptähtaeg FR Date limite d'utilisation HR Rok uporabe HU Felhasználhatósági dátum</p>	<p>IT Data di scadenza LT Tinka naudoti iki LVDerīguma termiņš NL Houdbaarheidsdatum PLData ważności PT Data de validade RO A se utiliza înainte de data SK Dátum spotreby SLRok uporabe</p>
	<p>BG Крекхо, боравете с него внимателно CSKřehké, manipulujte s ním opatrně DE Zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln ELΕυθραστο, χειριστείτε με προσοχή ESFrágil, manipule con cuidado ETHabras, käsitsege ettevaatlikult FR Fragile, manipuler avec soin HR Krhka, rukujte s pažnjom HU Törékeny, óvatosan kezelje</p>	<p>IT Fragile, maneggiare con cura LT Trauslis, jārikojas uzmanigi LVTrapus, elkitēs atsargai NL Breekbaar, voorzichtig behandelen PLKruchy, należy obchodzić się z nim ostrożnie PT Frágil, manuseie com cuidado RO Fragil, manevrați cu grijă SK Krehké, zaobchádzajte s ním opatrne SLKrhko, ravnajte previdno</p>
	<p>BG Да се държи на сухо място CSUdržujte v suchu DE Vor Nässe schützen ELΝα διατηρείται στεγνό ESGuardar en un lugar seco ETHoida kuivana FR A conserver au sec HR Držite na suhom mjestu HU Tartsa szárazon</p>	<p>IT Mantenere asciutto LT Laikyti sausai LVSargāt no mitruma NL Droog houden PLChronić przed wilgocią PT Manter seco RO A se păstra la loc uscat SK Uchovávať v suchu SLHranite na suhem</p>
	<p>BG Пазете далеч от слънчева светлина CSChraňte před slunečním zářením DE Vom Sonnenlicht fernhalten ELΜακριά από το ηλιακό φως ESMantener alejado de la luz solar ETHoida eemal päikesevalgusest FR Tenir à l'écart de la lumière du soleil HR Držite se podalje od sunčeve svjetlosti HU Tartsa távol a napfénytől</p>	<p>IT Tenere lontano dalla luce del sole LT Saugokite nuo saulės spindulių LVSargāt no saules gaismas NL Uit de buurt van zonlicht houden PLChronić przed światłem słonecznym PT Manter afastado da luz solar RO Păstrați departe de lumina soarelui SK Uchovávať mimo dosahu slnečného svetla SLHranite stran od sončne svetlobe</p>
	<p>BG Народе CSNahoru DE Bis ELΠάνω ESHacia arriba ETÜles FR Haut HR Gore HU Fel</p>	<p>IT Alto LT viršų LVUz augšu NL Op PLDo góry PT Este lado para cima RO Sus SK Nahor SLNavzgor</p>
	<p>BG Каталоген номер CSKatalogové číslo DE Best.-Nr. ELΑριθμός καταλόγου ESNúmero del catálogo ETKatalooginumber FR Référence du produit HR Kataloški broj HU Katalógusszám</p>	<p>IT Numero di catalogo LT Numeris kataloge LVKataloga numurs NL Catalogusnummer PLNumer katalogowy PT Número do catálogo RO Număr de catalog SK Katalógové číslo SLKataloška številka</p>
	<p>BG Температурна граница CSTeplotní limit DE Temperaturbereich ELΠεριορισμός θερμοκρασίας ESLímite de temperatura ETTemperatuuri piirväärtus FR Limites de température HR Ograničenje temperature HU Hőmérsékleti határérték</p>	<p>IT Limite di temperatura LT Temperatūros riba LVTemperatūras robeža NL Temperatuurlimiet PLLimit temperatury PT Limites de temperatura RO Limite de temperatură SK Teplotní limit SLOmejitev temperature</p>
	<p>BG Ограничение на влажността CSOmezení vlhkosti DE Luftfeuchte ELΠεριορισμός υγρασίας ESLímites de humedad ETNiiskuspääring FR Limites d'humidité HR Ograničenja vlažnosti HU Páratartalom-korlátozás</p>	<p>IT Limiti di umidità LT Santykinės drėgmės apribojimas LVMitruma ierobežojums NL Vochtigheidslimiet PLOgraniczenie wilgotności PT Limites de humidade RO Limite de umiditate SK Obmedzenie vlhkosti SLOmejitev vlažnosti</p>
	<p>BG Държава на производителя CSZemě výrobce DE Land des Herstellers ELΧώρα του κατασκευαστή ESPaís del fabricante ETTootja riik FR Pays du fabricant HR Zemlja proizvođača HU Gyártó országa</p>	<p>IT Paese del produttore LT Gamintojo šalis LVRažotāja valsts NL Land van fabrikant PLKraj producenta PT País do Fabricante RO Țara producătorului SK Krajina výrobcu SLDržava proizvajalca</p>

	<p>BG Медицински уред CS Lékařský nástroj DE Medizinprodukt EL Ιατρική συσκευή ES Dispositivo sanitario ET Meditsiiniseade FR Dispositif médical HR Medicinski proizvod HU Orvostechnikai eszköz</p>	<p>IT Dispositivo medico LT Medicinos prietaisai LV Medicīniskā ierīce NL Medisch apparaat PL Wyrób medyczny PT Dispositivo médico RO Dispozitiv medical SK Zdravotnícka pomôcka SL Medicinski pripomoček</p>
	<p>EN Consult instructions for use or consult electronic instructions for use BG Направете справка в инструкциите за употреба или електронните инструкции за употреба CS Prostudujte si tištěný nebo elektronický návod k použití DE Gebrauchsanweisung oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten EL Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης ES Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones electrónicas de uso ET Vt kasutusjuhendit või elektroonilist kasutusjuhendit FR Consulter la notice d'utilisation ou la notice d'utilisation électronique HR Pogledajte upute za uporabu ili pogledajte internetsku stranicu s elektroničkim uputama za uporabu HU Olvassa el a használati utasítást vagy az elektronikus használati utasítást IT Consultare le istruzioni per l'uso cartacee o elettroniche LT Vadovaukitės naudojimo instrukcija arba elektronine naudojimo instrukcija LV Skatiet lietošanas pamācību vai elektronisko lietošanas pamācību NL Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de elektronische gebruiksaanwijzing PL Należy zapoznać się z instrukcją używania lub elektroniczną wersją instrukcji używania PT Consultar as instruções de utilização ou as instruções de utilização eletrónicas RO Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile de utilizare în format electronic SK Prečítajte si pokyny na používanie alebo si pozrite elektronické pokyny na používanie SL Glejte navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo</p>	
<p>www.int.reachsurgical.com/support</p>		



Reach Surgical.Inc.
120 Xinxing Road, West Zone, TEDA, 300462 Tianjin, China



MDSS GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



Issue date: 2024-08-15